PEOPLE HAVE PRIORITY

User Manual

Dem 10

Demineralizer
Demineralisierer
Demineralisateur
Demineralizzatore
Desmineralizador
Avjoniseringsapparat

Dem 10 - 201 10 REV. 3

DEMINERALIZER
User Manual

English

DEMINERALISATEUR
Manuel d’utilisation

Deutsch

DEMINERALISATOR
Bedienungsanleitung

Français

DEMINERALIZZATORE
Manuale Utente

Italiano

DESMINERALISADOR
Manual Usuario

Español

AVJONISERINGSAPPARAT
Bruksanvisning

Svenska

English

Dem 10

DEMINERALIZER

USER MANUAL

Dear User,

We would like to thank you for purchasing our demineralizer ***Dem 10.***

The manufacturer remains at you disposal should you require any further information about the device.

We are pleased to provide information concerning the use of this equipment herewith. We remind you that in order to use the demineralizer correctly, it is necessary to read this manual carefully. All our products comply with the current safety norms and do not involve any risk for the operator when used according to the instructions provided.

Whilst wishing you every success in your work, please note that the reproduction of this manual is illegal and that, owing to continuous research and technological development, the equipment specifications could change without prior notice.

W&H STERILIZATION S.r.l.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 3

GENERAL RECOMMENDATIONS 3
RESIN CARTRIDGES – SECURITY PRECAUTIONS 4
INFORMATION ON WARRANTY 5

PACKAGE CONTENTS 6

GENERAL NOTES ON DELIVERY 6
PACKAGE SIZE AND WEIGHT 6
DELIVERY CONTENT 7

INSTALLATION AND USE 8

SYMBOLS ON THE NAMEPLATE 8
MOUNTING OF THE RESIN CARTRIDGES 9
INSTALLATION 9
REPLACEMENT OF THE RESIN CARTRIDGES 11
PRECAUTIONS TO AVOID WATER CONTAMINATION 11
OPERATION OF THE DEMINERALIZER 12

MAINTENANCE 13

EXTERNAL CLEANING 13
MAINTENANCE OF THE WATER BLOCK® SAFETY VALVE 13
REGULAR CHECK OF THE WATER BLOCK® AND ONE-WAY VALVES 13
SPARE PART LIST 14

TECHNICAL INFORMATION 15

MAINTENANCE ISTRUCTIONS FOR THE SAFETY VALVE (WATER BLOCK®) 16

INTRODUCTION

This manual provides instructions for:

- Correct installation
- Safe and efficient operation of the equipment
- Continuous and scheduled maintenance.

※ The sizes mentioned in this manual are subject to change without notice.

※ Drawings and any other documents delivered with the equipment belong to the manufacturer, who reserves all the rights; they cannot be made available to third parties.

※ The reproduction of text or images used in this manual, either in total or in part, is illegal.

GENERAL RECOMMENDATIONS

- The equipment should be used in compliance with the procedures described in the manual and never for purposes other than those detailed in the manual.
- The user is responsible for installing, operating and servicing the equipment in accordance with the instructions listed in this manual.
- Only use genuine manufacturer resin cartridges especially for this product.
- **Do not drink** the water produced by Dem 10.
- **Do not block or crush** the inlet or outlet pipes of the equipment or the sterilizer.
- If the equipment is not operated according to the instructions in this manual or is not properly maintained, the manufacturer cannot be held responsible for any fault, damage or malfunctioning of the equipment.
- When used in conjunction with a sterilizer, replace resin cartridges immediately once the water conductivity value exceeds 15-20 μS (warning message appears on most sterilizers) to avoid serious damage to the sterilizer.

Intended use: This manual is an integral part of the product and must be kept close to the equipment for easy and quick reference. The equipment is to be used only for the purpose for which it is designed.

Dem 10: Device designed for the demineralization of drinking water and manual supply to steam sterilizers.

RESIN CARTRIDGES – SECURITY PRECAUTIONS

Contact Hazards	
Eye contact	Irritation of the eyes (R36).
Skin contact	Slight irritation of the skin.
First Aid procedures	
Skin contact	Take off any contaminated clothes. Remove the resin beads and flush the contaminated area with water.
Eye contact	Flush immediately with large amounts of water and remove the resin beads.
Precautions in case material is spilled	
People precautions	Keep people away from the area of spillage. Resin beads on the floor may cause floor to be slippery. Take care not to slip.
Cleaning methods	Sweep the floor and transfer resin beads to a plastic container for collection or disposal according to the appropriate guidelines.
Notes for disposal	
The used product is a special non hazardous form of waste. The product must be disposed of in accordance with current local, regional and national regulations. The CER number for saturated or used ion-exchange resins used for the production of drinking or service water is: **19 09 05**.	

INFORMATION ON THE WARRANTY

The manufacturer grants warranty on your product, if used in accordance with the instructions described in this manual, for a period of **12 months** for mechanical and electrical components.

The warranty starts from the date of delivery to the customer, which must be proven by returning the warranty form duly filled in and signed.

In case of dispute, the date on the delivery note relating to the equipment serial number will be valid. The warranty does not cover defects or damage caused by:

- Incorrect installation
- Inadequate maintenance
- Tampering or unauthorized modifications
- Incorrect use of the equipment
- Non-compliance with the instructions included in this manual

The replacement of equipment or the extension of the warranty period because of breakdown is excluded.

Repair under warranty is carried out at judgment of the manufacturer and does not include packing and shipment costs.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**
FR	**1 An de Garantie**
DE	**1 Jahr Garantie**
IT	**1 Anno di Garanzia**

GB	Purchase date:	FR	Date de vente:
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:

GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:

GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:

PACKAGE CONTENTS

GENERAL NOTES ON DELIVERY

Upon delivery of the equipment, check the condition of the package and keep it in case of future needs.

Open the package and check that:
- the contents correspond to the delivery note
- there is no evidence of any damage.

In the event of damage or missing items, inform the carrier and the supplier immediately.

PACKAGE SIZE AND WEIGHT

Gross weight: 6.5 kg

Dimensions (mm)

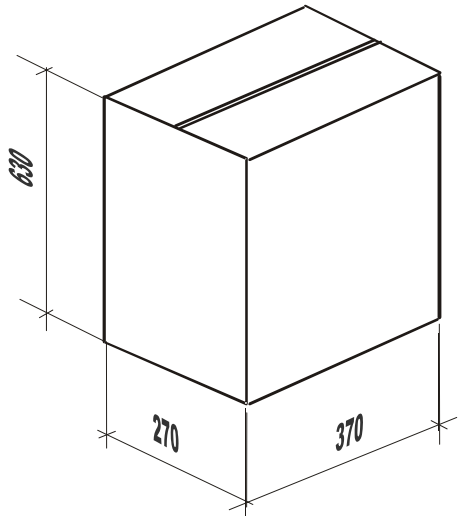

DELIVERY CONTENT

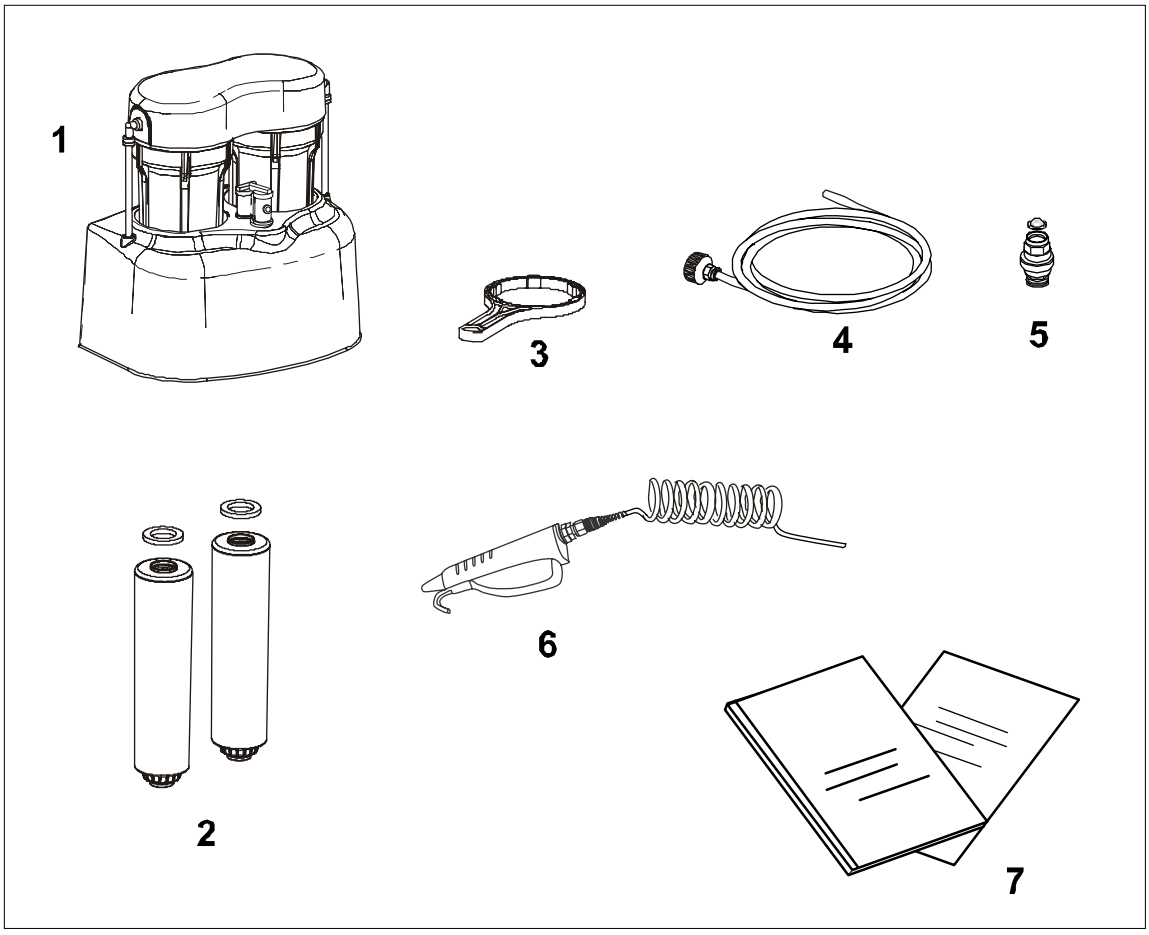

Figure 1

Item	Description
1.	Demineralizer (heads + cartridge holders + O-rings + centering rings)
2.	2 resin cartridges + 2 sealing rings
3.	Special key to replace cartridges
4.	Water inlet tube (4m, Ø 6x4 mm) with water tap fitting
5.	Water Block® valve (including filter and setting key)
6.	Spiral tube with Water gun
7.	Warranty certificate and user manual

INSTALLATION AND USE

SYMBOLS ON THE NAMEPLATE

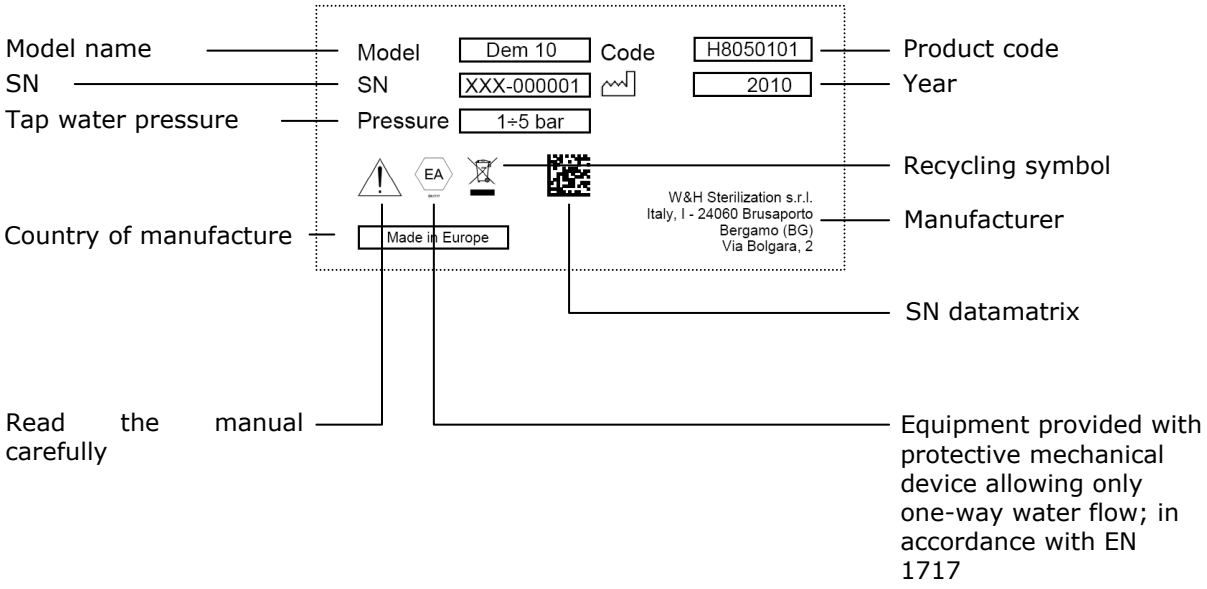

MOUNTING OF THE RESIN CARTRIDGES

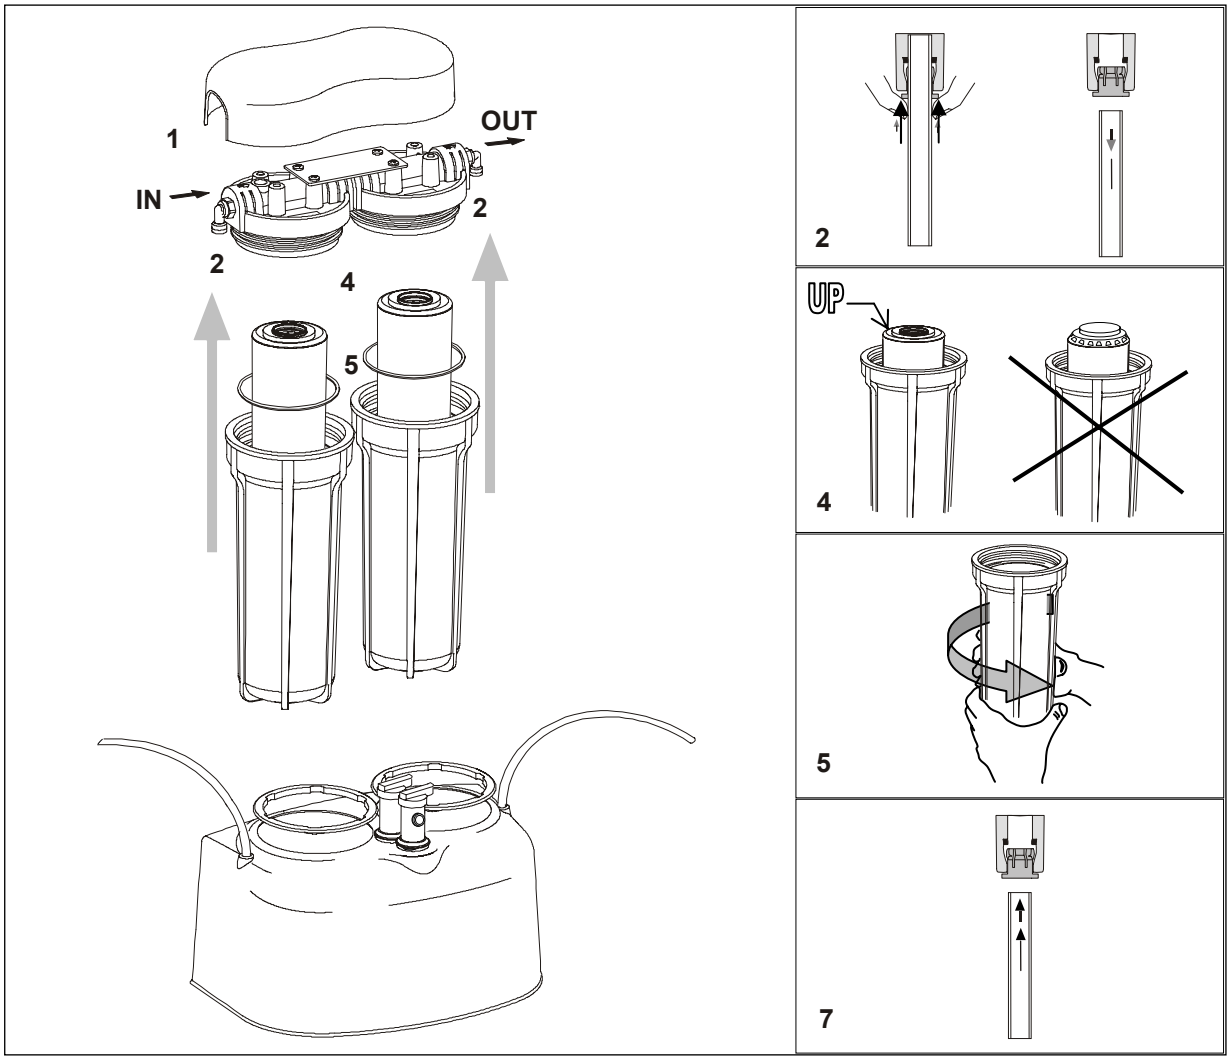

Figure 2

1. Remove the filter head cover.
2. Remove the tubes from the two quick connectors (IN/OUT) on the unit head and lift the entire cartridge assembly from the demineralizer base.
3. Unscrew the two resin cartridge holders (by hand or with the use of the special key).
4. Remove the cartridges from their bag and place them into the holders (with the cone-shaped side facing downwards and the word "UP" at the top).
5. Place the o-rings in the groove of the resin cartridge holders and tighten holders by hand (use only moderate force if you use the special key).
6. Place the cartridge assembly back into the demineralizer base and fix it into place with the use of the positioning rings.
7. Reconnect the tubes to the IN and OUT connectors (make sure that the IN connector is on the left hand side).
8. Attach the filter head cover.

INSTALLATION

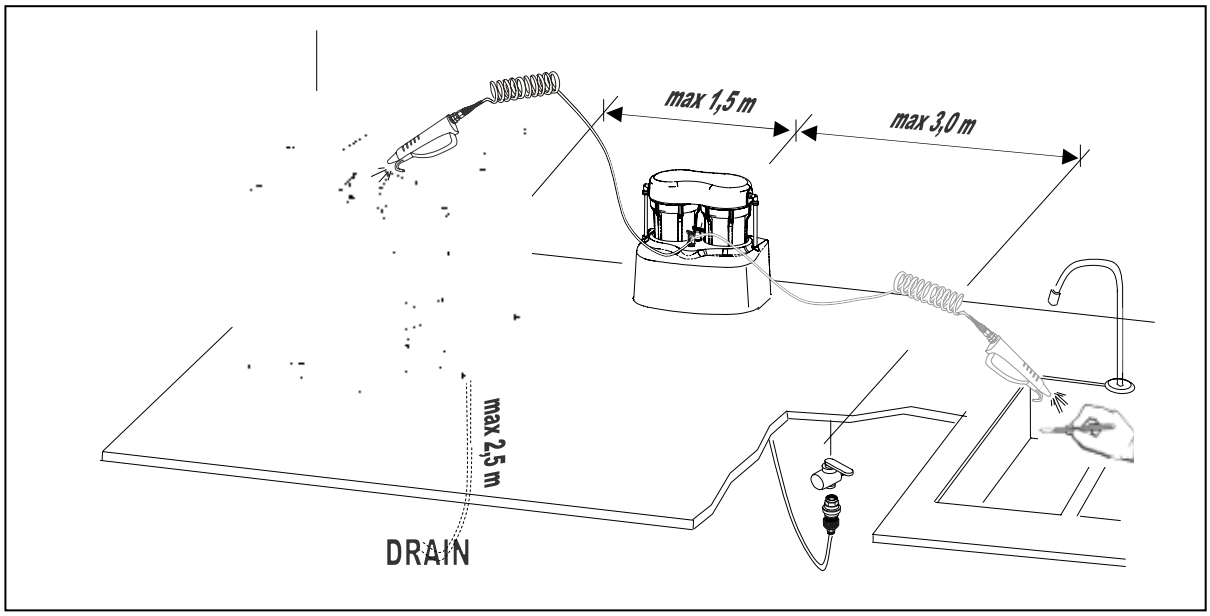

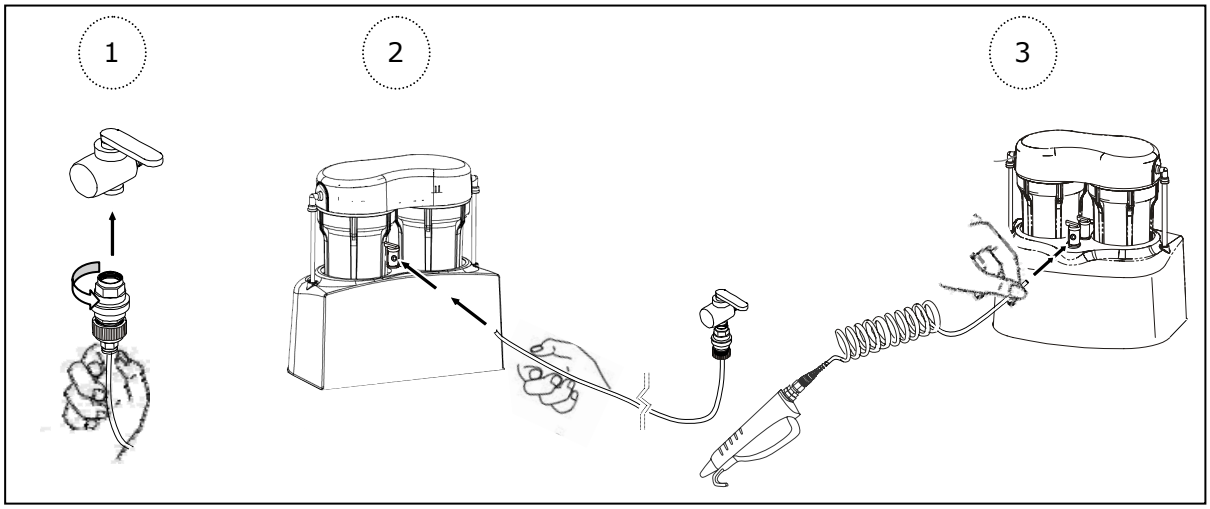

1. Mount the security valve (Water Block®) on the water inlet connection.

2. Connect the water inlet tube (no.4) to the water inlet fitting and the Dem 10 tap.

3. Connect the spiral tube to the front connection in the Dem 10.

WARNING
Use only original spare parts.
The Water Block® valve is fitted with a special one-way valve that prevents water from flowing back and potentially polluting the main waterline.
For this reason the Water Block valve should be mounted vertically.

WARNING
Check that all the tubes are connected correctly.
Before connecting the tubes, check that they are correctly cut at 90° with no uncut parts.

REPLACEMENT OF THE RESIN CARTRIDGES

When used with a sterilizer, replace the resin cartridges when the water conductivity reaches a value of 15 µS. Most sterilizers generate a display message once the water quality drops below a certain threshold.

1. Close the inlet tap.
2. Release the internal water pressure with the water gun (check that the spiral tube's connecting tap is open during this operation).
3. Follow the steps as described in chapter "*Mounting of the resin cartridges".*
4. Open the water supply tap.

PRECAUTIONS TO AVOID WATER CONTAMINATION

ATTENTION
In accordance with the EN1717, in order to avoid water quality degradation and bacterial growth due to a tailback of water in the tubes, the entire system must be drained before leaving it unused for a longer period of time.

OPERATION OF THE DEMINERALIZER

Once installed and fitted correctly, the demineralizer is able to supply demineralized water immediately. This water is ready to be used or to manually fill the sterilizer's tank (see the sterilizer user manual).

ATTENTION

The demineralizer is equipped with a Water Block® valve that cuts off the water flow after a pre-adjusted volume (5 liters) in order to prevent a large spillage of water in case of a broken tube. When you take water from the demineralizer with the use of the spray gun and the volume goes beyond 5 liters, the Water Block® valve will cut off the water supply. To reset the Water Block® valve see chapter "Maintenance instructions for the safety valve".
To avoid a water cutoff, release the water gun once every 30 seconds if quantities of more than 5 liters are taken from the demineralizer.

WARNING

The Water Block serves as an anti-flooding device. Blocking only takes place if there is considerable leakage (such as a cut in the tube between the Water Block and the demineralizer). Blocking does not take place if there is a small leak in the product's hydraulic system.

WARNING

It is recommended that the connection tap between the spray gun's spiral tube and the Dem 10 be closed if the gun is not being used.

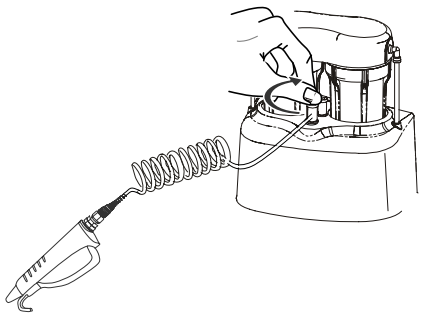

The quantity of demineralized water produced per set of resin cartridges depends on the quality and hardness of the city water in your area. Refer to the table below for further details:

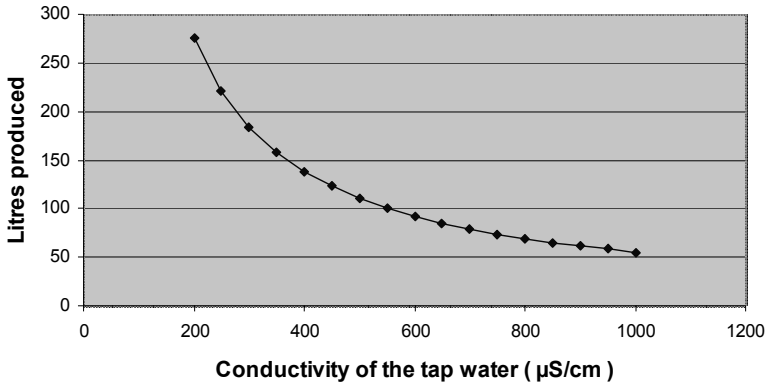

MAINTENANCE

EXTERNAL CLEANING

Clean with a damp cloth using non-abrasive and non-corrosive detergents (neutral pH value).

MAINTENANCE OF THE WATER BLOCK® SAFETY VALVE

The inlet filter of the Water Block® valve should be cleaned on a regular basis, depending on the city water quality and how often the demineralizer is used, as described in the document enclosed with this manual.

REGULAR CHECK OF THE WATER BLOCK® AND ONE-WAY VALVES

ATTENTION

To ensure compliance with the EN1717, have the Water Block® and the one-way valve checked at least once a year; if a sterilizer is attached to the system, this could be done during the scheduled maintenance visits for the sterilizer.

SPARE PART LIST

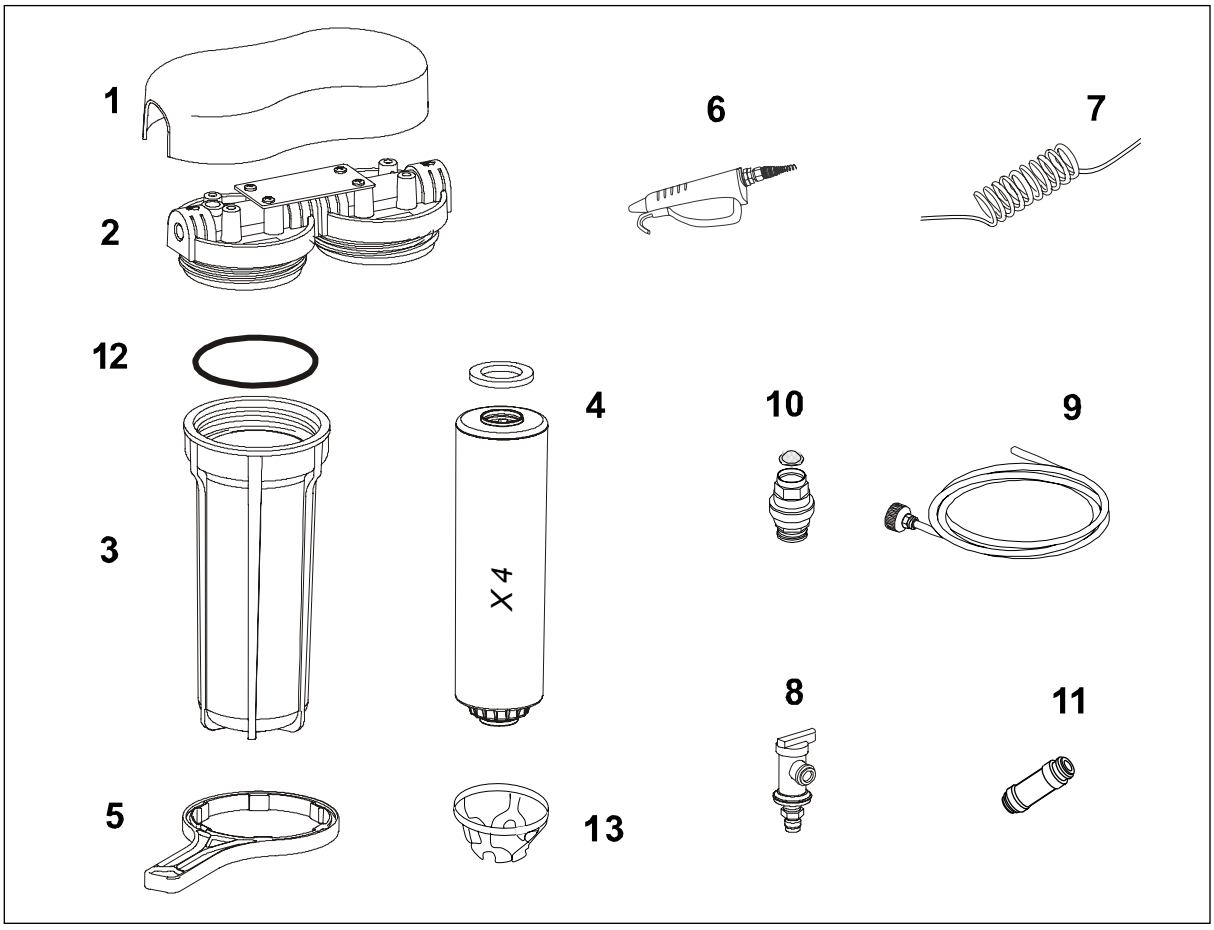

Nr.	Description	PN
1	FILTER HEAD COVER	A812109X
2	FILTER HEAD	A812104X
3	CARTRIDGE HOLDER	A812103X
4	RESIN CARTRIDGE KIT (4 CARTRIDGES + 4 SEALING RINGS + 4 O-RINGS)	A812100X
5	SPECIAL KEY FOR CARTRIDGE HOLDER	A812101X
6	WATER GUN	A812106X
7	SPIRAL TUBE	A812105X
8	TAP	A812107X
9	WATER TUBE (4 m, Ø 6X4mm) WITH WATER TAP FITTING	A812102X
10	SECURITY VALVE (WATER BLOCK®) WITH FILTER AND ADJUSTING KEY	A812005X
11	ONE WAY VALVE	A812108X
12	O-RING	A813014X
13	CENTERING RING	A813006X

TECHNICAL INFORMATION

Operating temperature	+5°C to +30°C
Storage temperature	+5°C to +35°C avoid direct sunlight and all sources of heat
Size (WxDxH)	305x190x320 mm
Weight (without cartridges)	2.8 kg
Weight of two cartridges	1.5 kg
Tap water pressure range	1 – 5 bar
Burst pressure	30 bar Max (435 Psi)
Amount of demineralized water produced with one set of cartridges with a conductivity value lower than 15÷20 µS [1]	110÷130 liters

[1] *tested at: T=25°C; tap water quality 450 µS; water pressure 3 bar*

MAINTENANCE ISTRUCTIONS FOR THE SAFETY VALVE (WATER BLOCK®)

WATER BLOCK (WB) SAFETY VALVE
Indispensable device for washing machines, dishwashers and demineralizers as, under the conditions defined in the technical features herewith described, it prevents a flow of water greater than the one for which it has been set by the adjustment pointer. This avoids continuous leaking. The Water Block also has a special non-return valve (antipollution). The device should be installed vertically *(see fig. 2)* and following the instructions carefully.

TECHNICAL FEATURES

- Burst pressure: 500 N/cm²
- Max. static pressure: 100 N/cm²
- Max. controllable volume: about 50 lt.
- Min. operating capacity: 2 lt/min.
- Max. operating capacity: 30 lt/min
- Max. water temperature: 70° C

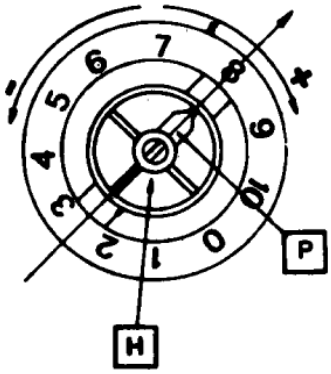

Fig. 1

USER INSTRUCTIONS
WATER BLOCK should be installed between the tap and the supply hose of the demineralizer *(fig. 2)*. Using the enclosed plastic key, turn pointer 'P' *(fig. 1)* anticlockwise to the required setting (example, position 1,5).

CAUTION:
For use on other fixtures, set the pointer to a position suitable for that particular application, considering that each number on the scale corresponds to a controlled volume of approx. 4-6 litres.
In case of installation on fixtures which foresee dispensing of drinking water for alimentary use it is advisable to let flow at least 10 litres of water inside the device before the connection, so as remove eventual impurities collected during storage.

INSTALLATION

1. Manually screw the WB to the tap having suitable thread (3/4" gas), inserting the filter 'E' with its convex side facing upwards *(fig. 2)*. The WB will not operate properly if the filter is not installed correctly. If the WB is tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the housing 'A'.
2. Screw the supply hose 'C' to the lower end of the WB. If the supply hose is equipped with a filter, the latter must be substituted by a flat rubber washer 'F'. If the said hose has to be tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the WB housing 'B' so as to hold it firmly while performing this operation.
   If a failure occurs causing a continuous water leak, the WB will shut off when the volume of water flowing through equals the amount to which it was previously set with the pointer 'P'.
   To reset the Water Block again after it has shut off, turn the tap off and carry out the necessary repair work. Remove the supply hose 'C' from the Water Block and press the coloured plunger 'H' which is located inside the lower housing of the device itself *(fig. 1)*. It may be difficult to press this plunger if there is high pressure at the inlet side of the WB. In this case, loosen the device from the tap: the plunger 'H' can then be pressed with ease. Repeat the operation as described in the section headed 'Installation'.

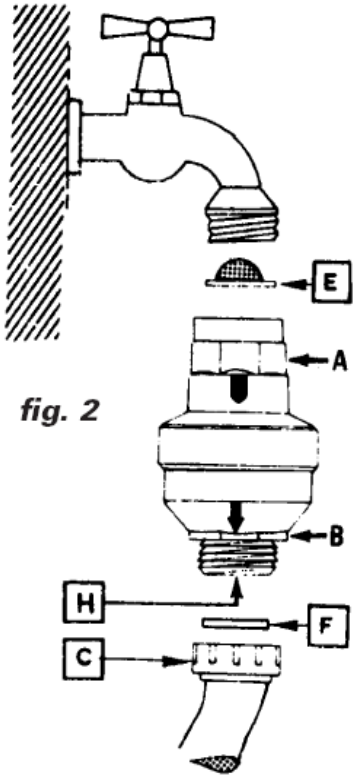

fig. 2

CAUTION:
To avoid any possible damage that may be caused by water freezing inside the WB after its installation, the ambient temperature should never be below 2° C. We decline all responsibility deriving from the incorrect use of the WB or from its use for applications and/or solutions not expressly foreseen by the above instructions.

MAINTENANCE:
Depending on the conditions and frequency of usage of the water block, it is recommended to clean out the inlet filter 'E' periodically and to replace the seal 'F'. We reserve the right to modify any features without prior notice.

Dem 10

DEMINERALISIERER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

Sehr geehrte/r Frau/Herr Doktor,

*Sie haben den **Dem 10** Demineralisierer gekauft – herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!*

*Der Hersteller steht für Fragen betreffend **Dem 10 Demineralisierer** jederzeit gerne zur Verfügung.*

Ebenso möchten wir betonen, dass es für eine korrekte Benutzung des Demineralisierers Dem 10 unbedingt notwendig ist, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Unsere Produkte erfüllen die generell gültigen Vorschriften über Sicherheit und sie stellen keine Gefahr für den Benutzer dar, wenn sie gemäß den angeführten Anweisungen benutzt werden.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Verwendung und weisen Sie darauf hin, dass die Reproduktion dieser Bedienungsanleitung verboten ist. Wir behalten uns technische Änderungen vor.

W&H STERILIZATION S.r.l.

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG 3

GENERELLE EMPFEHLUNGEN 3
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 4
HINWEISE ZUR GARANTIE 5
GENERELLE HINWEISE ZUR LIEFERUNG 6
GRÖSSE UND GEWICHT DER VERPACKUNG 6
LIEFERUMFANG 7

INSTALLATION UND GEBRAUCH 8

BEDEUTUNG DER SYMBOLE DES TYPENSCHILDES 8
MONTAGE DER HARZPATRONEN 9
INSTALLATION 9
WECHSELN DER HARZPATRONEN 11
VORBEUGENDE MASSNAHMEN BEI LÄNGEREN STANDZEITEN 11
BETRIEB DES DEMINERALISIERERS 12

INSTANDHALTUNG 13

EXTERNE REINIGUNG 13
INSTANDHALTUNG DES SICHERHEITSVENTILS (WB) 13
REGELMÄßIGE KONTROLLE DER ANTI-RÜCKFLUSS-VORRICHTUNGEN 13
ERSATZTEILE 14

TECHNISCHE DATEN 15

SICHERHEITSVENTIL (WATER BLOCK®) BEDIENUNGSANLEITUNG 16

EINLEITUNG

Dieses Handbuch gibt Ihnen Informationen und Anweisungen über:

- die sichere und effiziente Benutzung des Dem 10 Demineralisierers
- die kontinuierliche und regelmäßige Wartung.
- die korrekte Installation

※ Alle Größen, die im Handbuch spezifiziert werden, sind unverbindlich.

※ Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Zeichnungen und Dokumente gehören dem Hersteller der sich alle Rechte vorbehält. Sie dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.

※ Der Nachdruck von Text oder Abbildungen aus dieser Bedienungsanleitung ist verboten.

GENERELLE EMPFEHLUNGEN

- Der Dem 10 Demineralisierer ist ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Zweckbestimmung einzusetzen.
- Der Benutzer ist für die korrekte Installation, die richtige Benutzung und die regelmäßige Wartung des Apparats verantwortlich.
- Benutzen Sie nur original Harzpatronen.
- Das vom Dem 10 Demineralisierer produzierte Wasser ist **nicht als Trinkwasser geeignet.**
- **Achten Sie darauf die Zu- und Abwasserschläuche bei der Montage und während des Betriebes nicht zu beschädigen.**
- Bei Nichtbeachtung der Installations-, Bedienungs- und Wartungsbeschreibungen wie aufgeführt in dieser Bedienungsanleitung, erlischt jeglicher Garantie- und Regressanspruch.
- Wird der Dem 10 Demineralisierer zum Befüllen von Sterilisatoren verwendet, sollten umgehend die Harzpatronen getauscht werden sobald die Wasserqualität den Wert von 15-20µS/cm übersteigt, da ansonsten die Sterilisatoren schwer beschädigt werden können.

Diese Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Produktes und soll in der Nähe des Apparats aufbewahrt werden, um einfach und schnell als Referenz zur Verfügung zu stehen.

Dem 10: Gerät für das Demineralisieren von Leitungswasser und die manuelle Wasserzufuhr an Sterilisatoren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Gefahren durch Kontakt der Harze	
Augenkontakt	Reizung der Augen (R36).
Hautkontakt	Leichte Reizung der Haut.

Erste Hilfe - Maßnahmen	
Augenkontakt	Mit sauberem Wasser ausspülen und dabei vorsichtig die Harzkristalle entfernen.
Hautkontakt	Verschmutzte Bekleidung ausziehen. Harzkristalle entfernen, und die betroffene Stelle mit sauberem Wasser ausspülen.

Vorsichtsmaßnahmen bei auslaufendem Wasser oder verschütteten Harzkristallen	
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	Um Unfälle (Sturz) bei ausgelaufenem Wasser oder Harzkristallen zu vermeiden, sollte die Stelle vorsichtig gereinigt werden, da erhöhte Rutschgefahr durch das Wasser bzw. die Harzkristalle besteht.
Reinigung	Den Boden aufwischen und die vom Wasser getränkten Harzkristalle in einem Behälter für eine eventuelle Wiederverwendung aufbewahren, oder entsorgen.

Bemerkungen für die Entsorgung der Harze (Harzpatronen)

Gebrauchte Harzpatronen sind ein nicht gefährlicher Sondermüll.

Sie müssen nach den lokalen, regionalen und staatlichen Vorschriften entsorgt werden.

Die CER Nummer für durchnässte oder gebrauchte Ionenaustauschharze, die für die Produktion von Trink – oder demineralisiertem Wasser bestimmt sind, lautet: **19 09 05**.

HINWEISE ZUR GARANTIE

Der Hersteller gewährt für dieses Gerät eine Garantie von **12 Monaten** auf mechanische und elektronische Teile, wenn die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen befolgt werden.

Die Garantie beginnt mit dem Auslieferungsdatum an den Kunden und durch die Rückgabe der ausgefüllten Garantiekarte.

Im Falle eines Streitfalles, ist das Datum auf dem Lieferschein für das betreffende Gerät gültig.
Der Hersteller kann keine Garantie gewähren bei:

- fehlerhafter Installation
- unangemessener Wartung
- Manipulation oder nicht autorisierten Änderungen
- unkorrekter Benutzung des Dem 10
- Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen

Ein Austausch des Dem 10 während der Garantiezeit sowie eine Verlängerung der Garantie sind ausgeschlossen.

Die Reparatur unter Garantie wird nach Beurteilung des Herstellers durchgeführt und schließt die Verpackungs- und Transportkosten nicht ein.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE	W&H
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA	

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**			
FR	**1 An de Garantie**			
DE	**1 Jahr Garantie**			
IT	**1 Anno di Garanzia**			
GB	Purchase date:	FR	Date de vente:	
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:	
GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:	
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:	
GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:	
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:	

LIEFERUNG

GENERELLE HINWEISE ZUR LIEFERUNG

Kontrollieren Sie bitte beim Eingang des Produktes die Verpackung auf Unversehrtheit und bewahren Sie diese für eventuelle Versendungen auf.

Öffnen Sie die Verpackung und kontrollieren Sie, dass
- die Lieferung dem Begleitschein entspricht;
- es keine offensichtlichen Beschädigungen gibt.

Wenn die Lieferung beschädigt ist oder Teile fehlen, informieren Sie unmittelbar Ihren Spediteur, Ihr Dentaldepot oder den Hersteller.

GRÖSSE UND GEWICHT DER VERPACKUNG

Bruttogewicht: 6.5 kg
Größen in mm

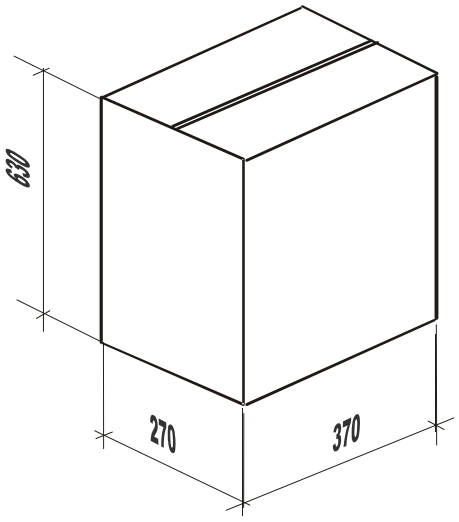

LIEFERUMFANG

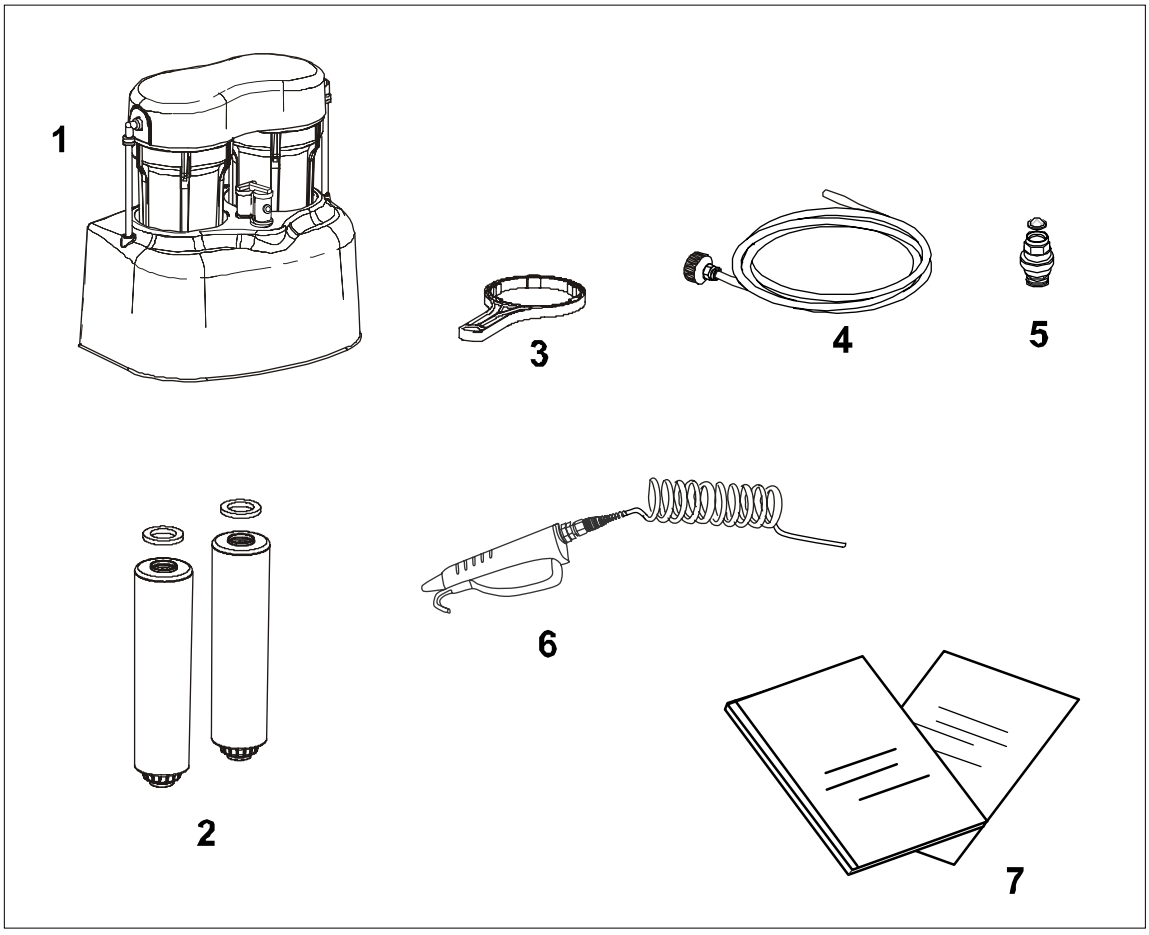

Abbildung 1

Nr.	Beschreibung
1.	Demineralisierer (Kopfabdeckung, Patronenhalter, O-Ring, Zentrierring)
2.	2 Stück Harzpatronen + Dichtungsringe
3.	Schlüssel für das Auswechseln der Harzpatronen
4.	Wasserschlauch (4m, Ø 6x4 mm) mit Hahnansatz
5.	Sicherheitsventil (Water Block) mit Filter und Stellschlüssel
6.	Spiralschlauch mit Sprühpistole
7.	Garantieschein und Bedienungsanleitung

INSTALLATION UND GEBRAUCH

BEDEUTUNG DER SYMBOLE DES TYPENSCHILDES

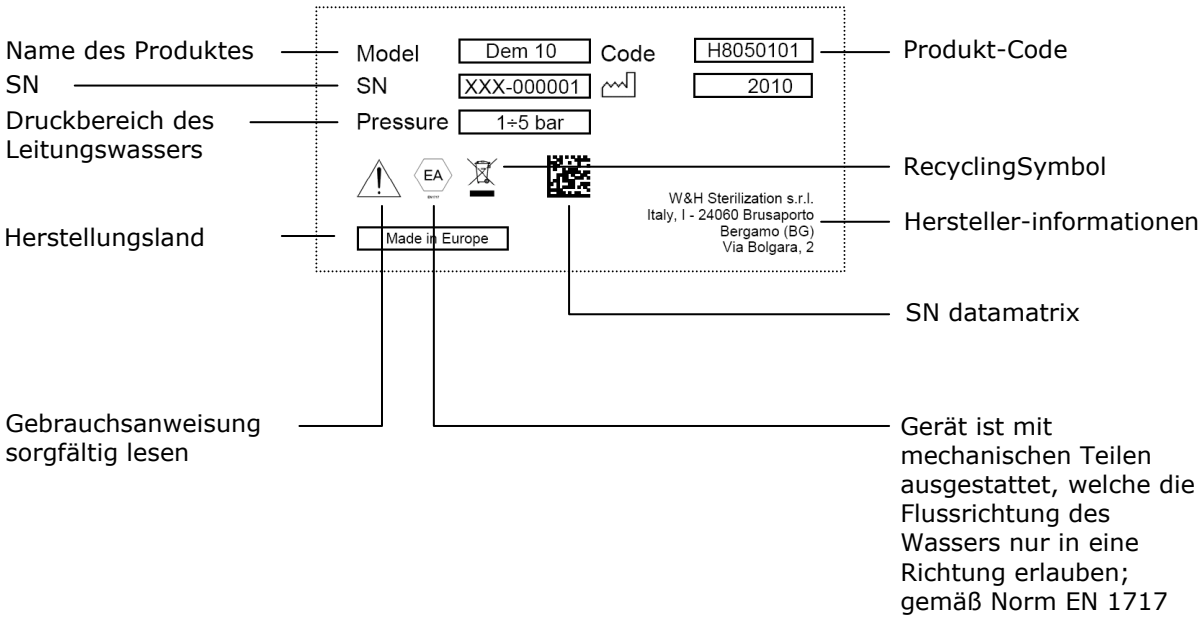

MONTAGE DER HARZPATRONEN

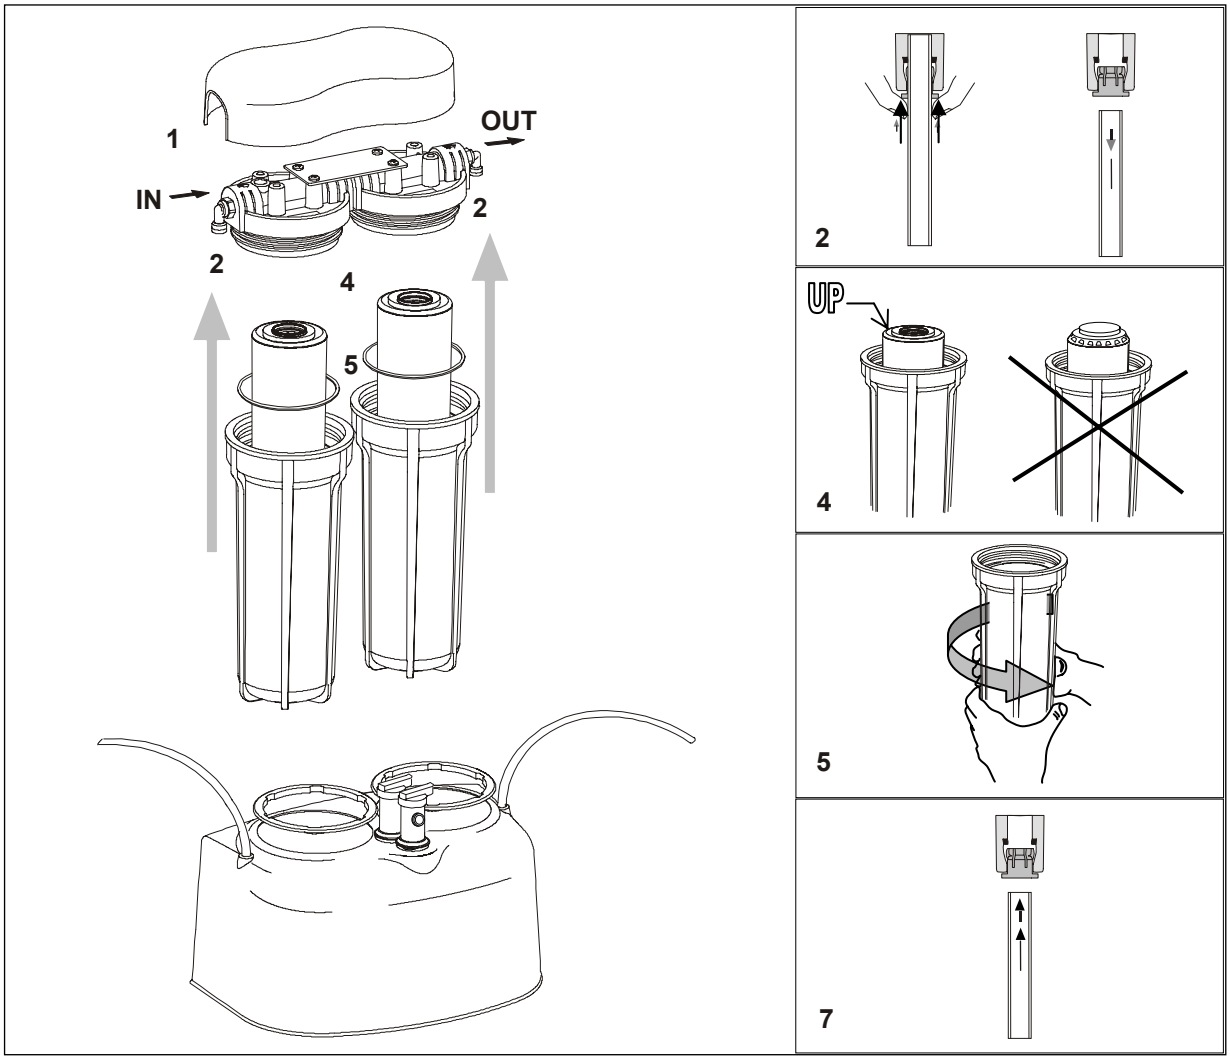

Abbildung 2

1. Entfernen Sie die Kopfabdeckung.
2. Entfernen Sie die beiden Wasserschläuche vom Einheitenkopf (IN/OUT) und heben Sie die ganze Kopfbaugruppe nach oben ab.
3. Schrauben Sie die beiden Patronenhalter mit der Hand oder mit Hilfe des Spezialschlüssels ab.
4. Entfernen Sie die Plastikverpackung der Harzpatronen und geben Sie die neuen Harzpatronen mit der konischen Seite nach unten in die Patronenhalter, mit der Aufschrift "UP" nach oben.
5. Setzen Sie die Dichtungsringe in die dafür vorgesehenen Nuten im oberen Bereich der Patronenhalter und schrauben Sie die Halter mit der Hand wieder fest.
6. Schieben Sie die beiden Positionierringe and den Patronenhaltern hoch und setzen Sie die Kopfbaugruppe wieder in die Einheitenbasis ein.
7. Schließen Sie nun die beiden Wasserschläuche wieder an (Achtung: IN Verbindung links; OUT Verbindung rechts).
8. Geben Sie die Kopfabdeckung wieder auf das Gerät.

INSTALLATION

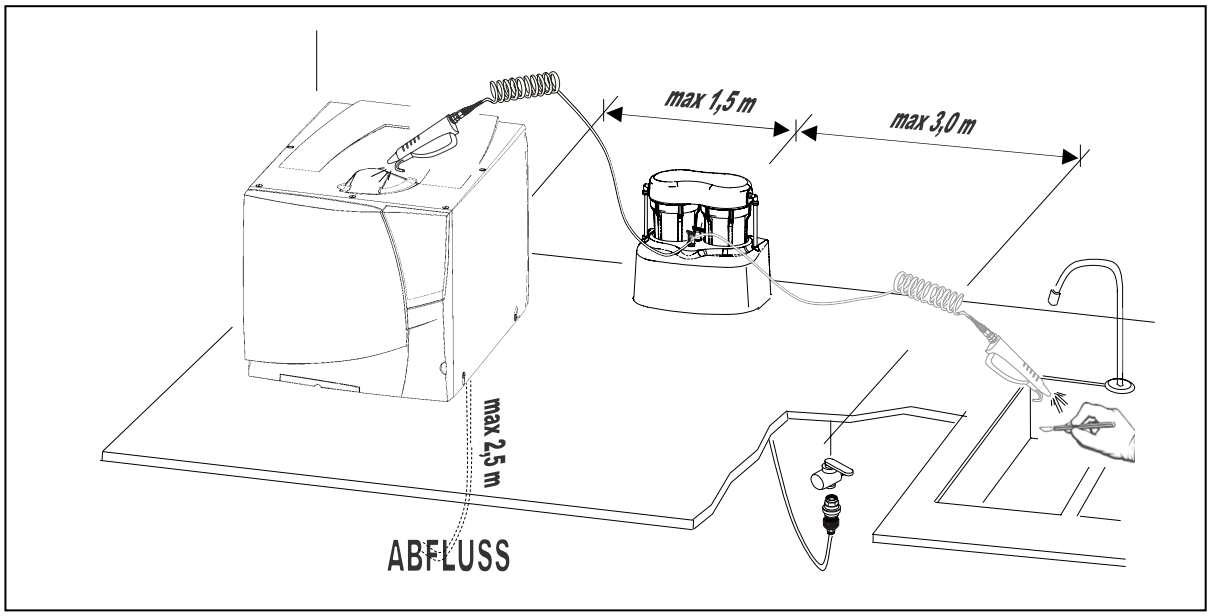

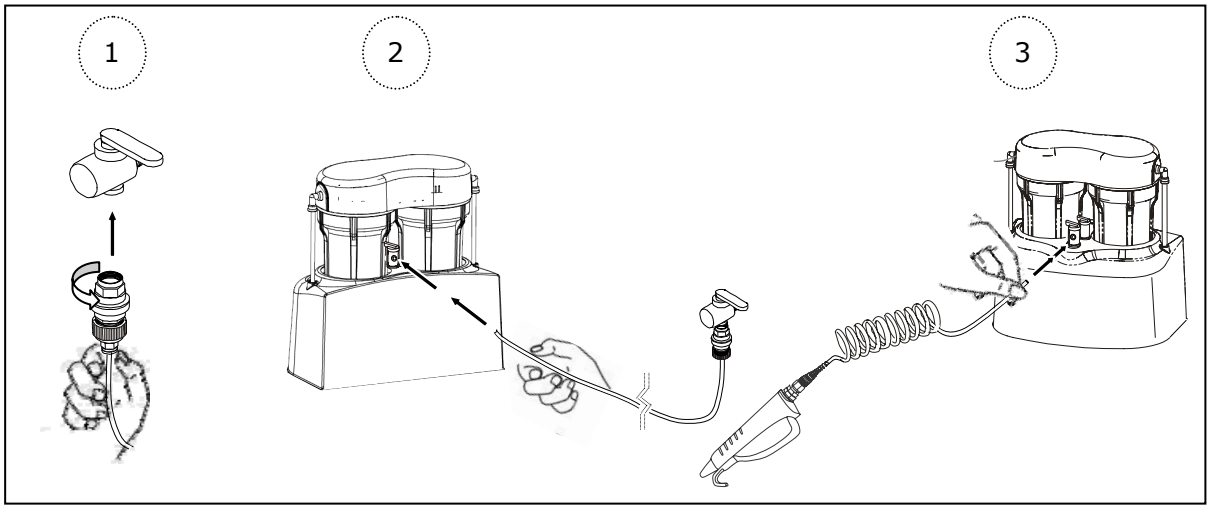

1. Fixieren Sie das Sicherheitsventil (Water Block®) am Wasserhahn.
2. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und dem Dem 10 Hahn.
3. Befestigen Sie den Spiralschlauch an der Vorderseite des Dem 10.

ACHTUNG
Benutzen Sie ausschließlich Originalersatzteile.
Das Sicherheitsventil (Water Block®) ist mit einem Einwegventil ausgestattet, welches den Rückfluss von Flüssigkeiten in das Wasserversorgungsnetz und somit auch eine mögliche Verunreinigung verhindert. **Zu diesem Zweck muss das Sicherheitsventil senkrecht eingebaut werden.**

ACHTUNG
Darauf achten, dass alle Schläuche gut angeschlossen sind. Bevor die Schläuche angeschlossen werden, stets darauf achten dass sie schön rechtwinkelig abgeschnitten (gekürzt) werden.

WECHSELN DER HARZPATRONEN

Falls Sie das demineralisierte Wasser für einen Sterilisator verwenden, sollten Sie die Harzpatronen umgehend austauschen, sobald die Wasserqualität einen Wert (Wasserleitfähigkeit) von 15-20 µS erreicht hat.

1. Schließen Sie den Wasserhahn
2. Den Druck im System durch Betätigen der Sprühpistole entlasten (Wasserhahn am LisaDem10 öffnen).
3. Führen Sie alle Schritte durch wie erwähnt im Kapitel "Montage der Harzpatronen".
4. Der Wasserhahn kann wieder geöffnet werden

VORBEUGENDE MASSNAHMEN BEI LÄNGEREN STANDZEITEN

ACHTUNG
Nach den Anforderungen der europäischen Norm EN 1717 (§ 4.6), sollte das im System verbleibende Wasser entleert werden, falls es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird um eine Vermehrung der Bakterien durch stehendes Wasser in den Schläuchen und im Demineralisierer zu vermeiden.

BETRIEB DES DEMINERALISIERERS

Nach der ordnungsgemäßen Installation des Demineralisierers, kann dieser sofort demineralisiertes Wasser liefern. Das demineralisierte Wasser kann sofort für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden.

ACHTUNG
Der Demineralisierer ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet (Water Block®), welches den Wasserfluss nach einer voreingestellten Wassermenge (5 Liter) unterbricht, um bei einer Leckage ein Auslaufen von großen Wassermengen zu verhindern. Falls Sie demineralisiertes Wasser mit der Sprühpistole entnehmen und die Wassermenge über 5 Liter hinausgeht, wird das Ventil den Wasserfluß unterbrechen. Im Kapitel „Sicherheitsventil Bedienungsanleitung" finden Sie eine genaue Beschreibung was zu tun ist um das Ventil wieder zu öffnen. Um ein Blockieren das Wasserflusses bei Entnahme von mehr als 5 Litern Wasser mit der Sprühpistole zu vermeiden, empfehlen wir den Abzug der Pistole alle 30 Sekunden kurz loszulassen.

ACHTUNG
Das Sicherheitsventil unterbricht den Wasserfluß nur bei größeren Ausflussmengen und nicht bei kleinen Leckagen im Hydrauliksystem des Demineralisierers.

ACHTUNG
Es wird empfohlen die Zuleitung zur Sprühpistole zu schließen wenn diese nicht benützt wird.

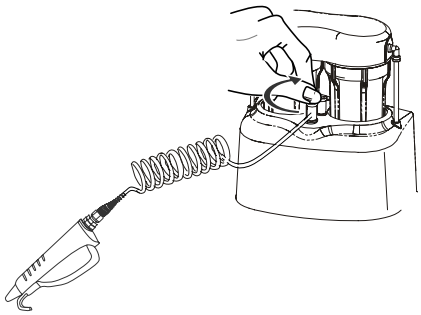

Die Menge des produzierten Wassers pro Patrone hängt von der Qualität und der Härte des Leitungswassers ab (siehe Diagramm unten).

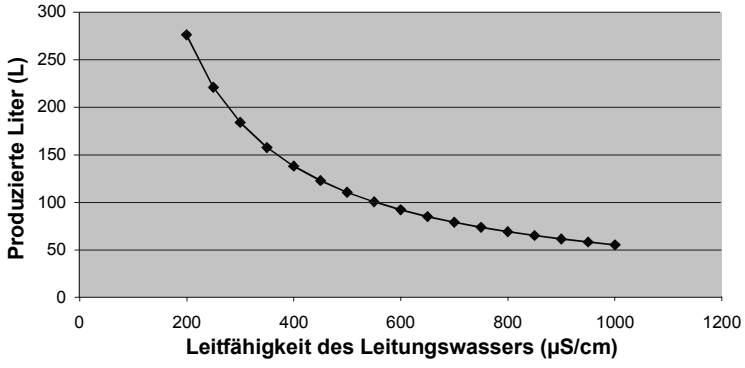

INSTANDHALTUNG

EXTERNE REINIGUNG

Reinigen Sie den Kopf des Demineralisators mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert).

INSTANDHALTUNG DES SICHERHEITSVENTILS (WB)

Der Einlassfilter des Water Blocks® sollte regelmäßig gereinigt werden, abhängig von der Wasserqualität und der Häufigkeit der Nutzung des Demineralisierers, wie in dieser Gerbrauchsanweisung beschrieben.

REGELMÄßIGE KONTROLLE DER ANTI-RÜCKFLUSS-VORRICHTUNGEN

ACHTUNG
Kontrollieren Sie die Anti-Rückflußvorrichtungen (Water Block und das Einwegventil) einmal jährlich und / oder bei einem Servicebesuch eines Technikers.

ERSATZTEILE

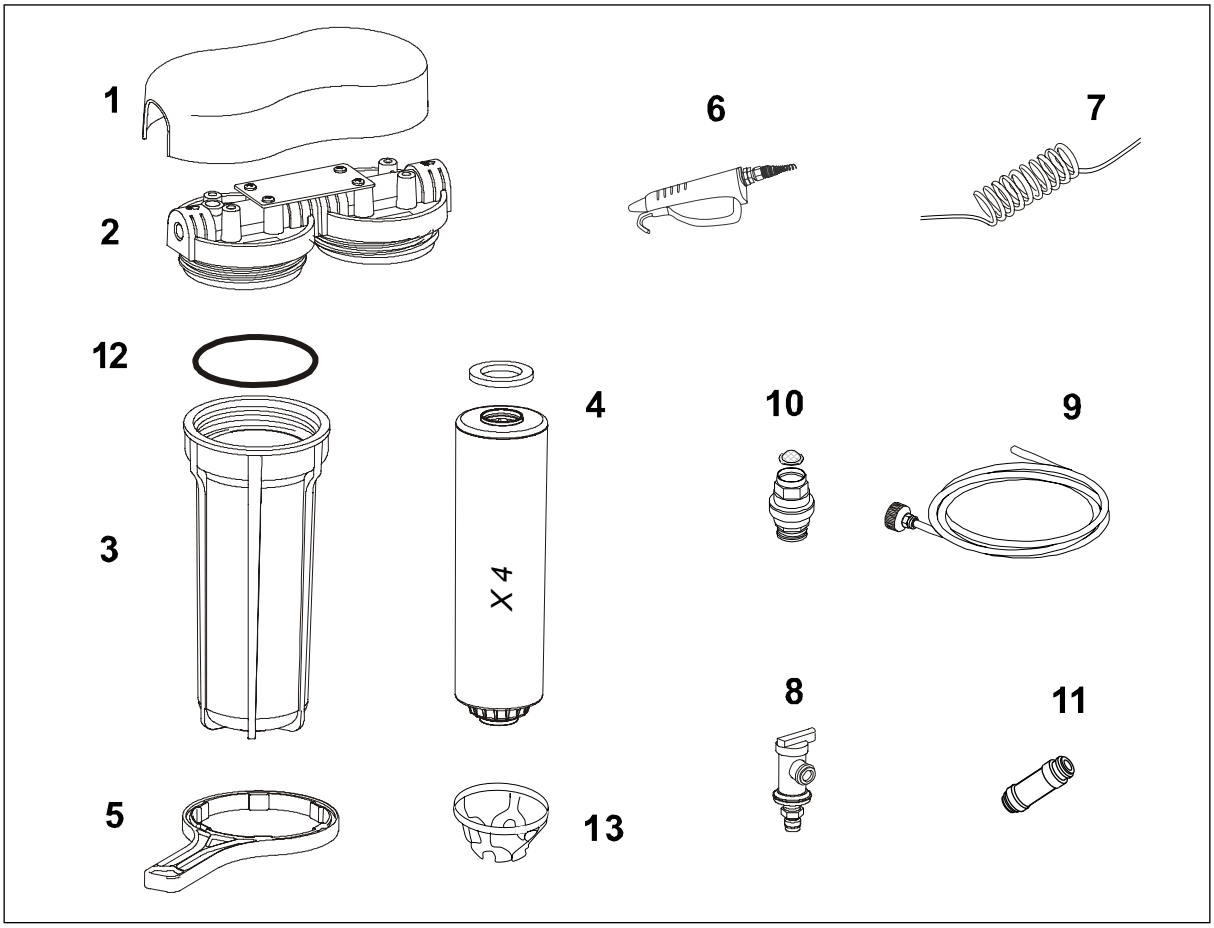

Nr.	Beschreibung	Best.Nr.
1	KOPFABDECKUNG	A812109X
2	FILTERKOPF	A812104X
3	PATRONENHALTER	A812103X
4	PATRONENSATZ (4 HARZPATRONEN + 4 DICHTUNGSRINGE + 4 O-RINGE)	A812100X
5	SPEZIALSCHLÜSSEL FÜR PATRONENHALTER)	A812101X
6	SPRÜHPISTOLE	A812106X
7	SPIRALSCHLAUCH	A812105X
8	WASSERHAHN	A812107X
9	WASSERSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN (4 m, Ø 6x4mm)	A812102X
10	SICHERHEITSVENTIL (WATER BLOCK®) MIT FILTER UND SPEZIALSCHLÜSSEL	A812005X
11	EINWEGVENTIL	A812108X
12	O-RING	A813014X
13	ZENTRIERRING	A813006X

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	+5°C bis +30°C
Einlagerungstemperatur	+5°C to +35°C vor direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen schützen
Abmaße (LxTxH)	305x190x320 mm (LxTxH)
Gewicht (ohne Patronen)	2,8 kg
Gewicht von 2 Patronen	1,5 kg
Minimal - Maximaldruck des Wassernetzes	1 - 5 bar
Max. belastbarer Druck bevor das Gerät zerstört wird	30 bar Max (435 Psi)
Von einem Set Patronen produziertes demineralisiertes Wasser mit einer Leitfähigkeit unter 15÷20 µS [1]	110÷130 Liter

[1] *Getestet bei: T=25°C, Leitungswasserqualität 450 µS; Wasserdruck 3 bar*

SICHERHEITSVENTIL (WATER BLOCK®)
BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSVENTIL WATER BLOCK (WB)
Unentbehrliches Zubehör für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, da unter den *in den technischen Eigenschaften im olgenden beschriebenen Bedingungen* das Durchlaufen von größeren Wassermengen als auf dem Anzeiger eingestellt urde vermieden werden, wodurch ständiges Überlaufen verhindert wird. Das Gerät verfügt außerdem über ein spezielles Rückschlagventil (schützt vor Wasserverschmutzung). Zu einer optimalen Funktionsweise wird geraten, die Montage in vertikaler Position durchzuführen, wie auf *Abb. 2* dargestellt, wobei *diefolgenden Angaben sorgfältig eingehalten werden müssen.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- Platzdruck: 500 N/cm²
- max. statischer Druck: 100 N/cm²
- max. kontrollierte
- Wasserdurchflußmenge: 50 l ca.
- min. Durchflußmenge: 2 l/min.
- max. Durchflußmenge: 30 l/min.
- max. Wassertemperatur: 70° C

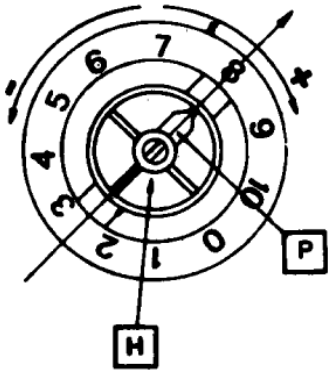

Fig. 1

MONTAGEANLEITUNG
Der WATER BLOCK wird zwischen den Wasserhahn und dem Zulaufschlauch des Hausgerätes *(Abb. 2)* montiert. *Unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Schlüssels wird der Anzeiger P im entgegengesetzten Uhrzeigersinn so lange gedreht bis die gewünschte Position erreicht wird. Bei Haushalts-Waschmaschinen wird der Anzeiger P auf die Nr. 8 voreingestellt (Abb. 1), während beiAnwendung auf Geschirrspülmaschinen der Anzeiger P auf die Nr. 1.5 gestellt wird (Abb. 1).*

ACHTUNG:
Bei Einsatz auf anderen Geräten wird der Anzeiger auf die der Anwendung entsprechend geeigneten Position geregelt, wobei zu beachten ist, daß jede Zahlenangabe auf der Skala einem kontrollierten Volumen von 4 bis 6
Litern Wasser entspricht. Bei Installation auf Getränkeautomaten und Trinkwasserspender wird zur Entfernung von etwaiger im Bauteil bei der Lagerrung angesammelten Verschmutzungen empfohlen, das Netzwasser mindesten 10 Minuten lang durch das Gerät laufen zu lassen.

EINBAU
1. Den WATER BLOCK manuell am Wasserhahn (3/4" Gas) anschrauben, *wobei das Sieb E mit der Wölbung nach oben wie auf Abb. 2 dargestellt eingelegt wird.* Eine falsche Montage des Siebs verhindert eine korrekte Funktionsweise des WATER BLOCKS. Im Falle von An- und Abschrauben mit Werkzeugen muß das entsprechende Achteck A benutzt werden.

2. Der Wasserzulaufschlauch C wird an der unteren Seite des WATER BLOCKS angeschraubt. Wenn der Wasserzulaufschlauch ein Sieb beinhaltet, *muß dieses vorher entfernt und durch eine Flachdichtung F ersetzt werden.* Im Falle von An- und Abschrauben mit Werkzeugen muß das entsprechende Sechseck B zur Blockierung des WATER BLOCKS während des Arbeitsgangs benutzt werden. Im Falle eines Defekts der ein ständiges Wasserleck hervorruft *schließt der WATER BLOCK im Anschluß den Durchfluß der Wassermenge* die vorher auf dem Anzeiger P eingestellt wurde. *Zur Wiederherstellung der Funktion* des WATER BLOCKS nach Auslösung des Blockiersystems wird der Wasserhahn geschlossen und der Defekt behoben. Dann wird der Wasserzulaufschlauch C vom WATER BLOCK abgeschraubt und der Stift H gedrückt, der sich auf der Unterseite des Gerätes *(Abb. 1)* befindet. Wenn der Wassereingangsdruck hoch ist kann es passieren, daß der Knopf schwer zu drücken ist. In diesem Fall wird der WATER BLOCK leicht vom Wasserhahn abgeschraubt. Der Knopf H kann ganz leicht eingedrückt werden. Daraufhin werden *die Arbeitsgänge unter dem Kapitel Einbau* wiederholt.

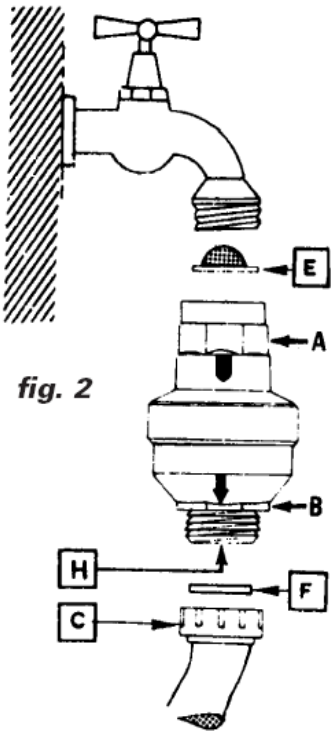

fig. 2

HINWEISE:
um möglichen Beschädigungen durch Gefrierung des Wasser im WATER BLOCK nach der Installierung vorzubeugen, darf die Umgebungstemperatur nie unter 2° C sinken. Wir lehnen jegliche Verantwortung / Haftung für unsachgemäße, falsche oder im folgendem nicht ausdrücklich aufgeführte Anwendung des Gerätes ab.

WARTUNG:
Auf der grundlage der bedingungen und der benutzungshäufigkeit wird empfohlen von zeit zu zeit das eingangssieb E zu reinigen und die dichtung F auszuwechseln. wir behalten uns vor, die technischen eigenschaften ohne voranmeldung zu ändern.

Dem 10

DEMINERALISATEUR

MANUEL D'UTILISATION

Cher Docteur,

Nous voulons avant tout vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée en achetant notre appareil ***Dem 10.***

Le fabricant est à votre entière disposition pour vous fournir toute information complémentaire concernant votre équipement.

Nous vous informons qu'il est nécessaire au préalable, de lire attentivement ce mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil.
Tous nos produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et ne présentent aucun risque pour l'utilisateur s'ils sont utilisés conformément aux instructions fournies.

Nous vous rappelons également que la reproduction de ce manuel est formellement interdite et que, étant constamment à la recherche d'améliorations, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de l'appareil sans préavis.

W&H STERILIZATION S.r.l.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 3
RESINES – MESURES DE SÉCURITÉ 4
INFORMATION SUR LA GARANTIE 5

VERIFICATION A LA LIVRAISON 6

RECOMMANDATIONS 6
DIMENSIONS ET POIDS DU COLIS 6
LISTE DES COMPOSANTS 7

INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL 8

SIGNIFICATION DES SYMBOLES ET DONNÉES DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE 8
MISE EN PLACE DES CARTOUCHES DE RESINE 9
INSTALLATION 10
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RESINE 11
MESURE DE PREVENTION EN CAS D'ARRET PROLONGE 11
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 12

ENTRETIEN 13

NETTOYAGE EXTERNE 13
ENTRETIEN DE LA VANNE DE SECURITE WATER BLOCK® 13
CONTROLE PERIODIQUE DES SYSTEMES ANTI-REFLUX 13
PIÈCES DE RECHANGE 14

INFORMATIONS TECHNIQUES 15

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE LA VANNE DE SECURITE (WATER BLOCK®)16

INTRODUCTION

Ce mode d'emploi fournit les informations nécessaires afin de vous garantir :

- une installation correcte
- une utilisation sûre et optimale de l'équipement
- un entretien régulier et efficace.

※ Les schémas et tous les autres documents fournis avec l'équipement appartiennent au fabricant qui se réserve tous les droits et ne peuvent être mis à la disposition de tiers.

※ La reproduction en tout ou partie du texte et des illustrations est interdite.

※ Dimensions non contractuelles

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- L'équipement doit être utilisé conformément aux recommandations de ce manuel et jamais pour d'autres utilisations non indiquées dans le manuel.
- L'utilisateur est responsable de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien régulier de l'appareil décrits dans le manuel.
- Utiliser exclusivement les cartouches de résine originales
- **Ne pas boire** l'eau produite par le Dem 10.
- **Ne pas obstruer ni écraser** le tuyau d'alimentation en eau courante.
- Si l'équipement n'est pas utilisé correctement ou si l'entretien n'est pas effectué, le fabriquant ne peut être tenu pour responsable des disfonctionnements et détériorations de l'appareil.
- Si l'équipement est utilisé avec stérilisateur, lorsque la conductibilité de l'eau dépasse 15-20 μS, le remplacement des cartouches de résine est indispensable. Dans le cas contraire le stérilisateur en serait endommagé.

Utilisation appropriée : Le présent manuel fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité de l'équipement pour consultation.

Dem 10: Appareil conçu pour la déminéralisation de l'eau courante et le remplissage manuel du stérilisateur.

RESINES – MESURES DE SECURITE

Effets et mesures en cas de contact	
Contact avec les yeux	Irritation des yeux (R36).
Contact avec la peau	Légère irritation de la peau.
Mesures d'urgence	
Contact avec les yeux	Rincer abondamment à l'eau courante et retirer les particules de résine.
Contact avec la peau	Retirer les vêtements contaminés. Retirer les particules de résine et rincer abondamment la partie contaminée à l'eau courante.
Mesures en cas de fuite ou dispersion du produit	
Précautions pour les personnes	Eloigner les personnes du produit. Le sol humide et imprégné de particules de résine rend le sol glissant. Attention au risque de chutes.
Nettoyage	Eponger et collecter le produit dans un container en plastique pour être récupéré ou jeté aux ordures conformément aux mesures en vigueur.
Notes concernant les déchets	
Les résines usées ne sont pas spécialement dangereuses. Le produit doit être mis aux ordures / recyclé conformément aux mesures locales, régionales ou nationales en vigueur. Le numéro CER pour des résines à échange d'ions, saturées ou usées pour la production d'eau potable ou de service est : **19 09 05**.	

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Le fabricant garantit les composants mécaniques de ses produits pendant une période de 12 mois, s'ils sont utilisés conformément aux instructions de ce manuel.

La garantie prend effet à compter de la date de livraison chez le client, attestée par le renvoi du coupon de garantie dûment rempli et signé.

En cas de litige, seule la date indiquée sur le bon de livraison indiquant le numéro de série de l'appareil, sera valide. La garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés par :

- une installation incorrecte
- un entretien inadapté
- toute modification de l'appareil non autorisée
- une utilisation inappropriée de l'équipement
- le non respect des instructions de ce manuel

Le remplacement de l'équipement ou une prolongation de la garantie pour cause de pannes sont exclus.
Toute réparation sous garantie est effectuée sous appréciation du fabricant et n'inclue pas les coûts liés à l'emballage et l'expédition du produit.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**			
FR	**1 An de Garantie**			
DE	**1 Jahr Garantie**			
IT	**1 Anno di Garanzia**			
GB	Purchase date:	FR	Date de vente:	
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:	
GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:	
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:	
GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:	
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:	

VERIFICATION A LA LIVRAISON

RECOMMANDATIONS

Dès réception, contrôler l'état de l'emballage et le conserver pour d'éventuelles expéditions.

Ouvrir l'emballage et vérifier que :
- la fourniture correspond bien au bon de livraison
- il n'y ait aucun dommage apparent.

En cas de dommages ou de pièce(s) manquante(s), informer immédiatement et en détail le transporteur, le dépôt dentaire ou l'importateur.

DIMENSIONS ET POIDS DU COLIS

Poids total : 6.5 kg
Les dimensions sont en mm

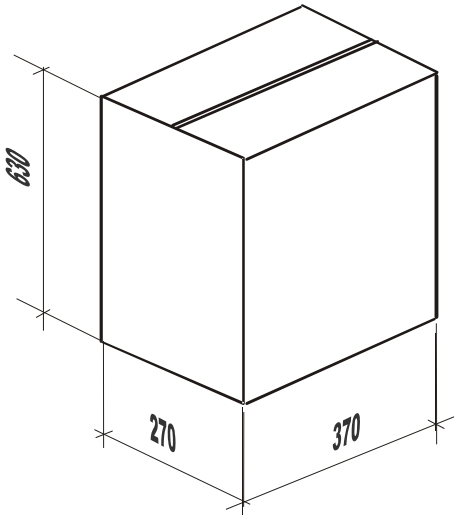

LISTE DES COMPOSANTS

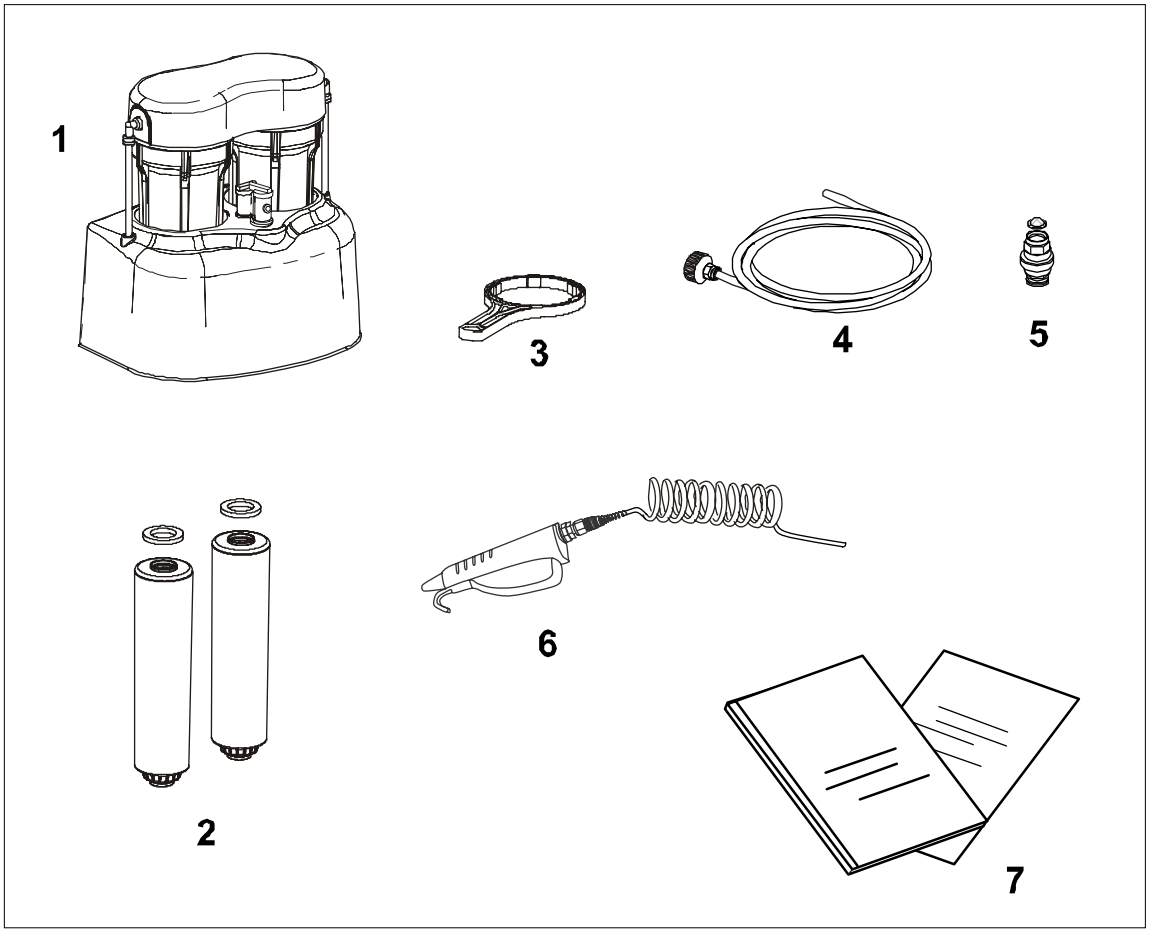

Figure 1

Description

1 Dem 10 (têtes + support cartouches + joints d'étanchéité+ anneaux de centrage)
2. Jeu de cartouches de résine + joints d'étanchéité
3. Clé de serrage
4. Tuyau d'alimentation en eau courante (4m, Ø 6x4 mm) avec raccord
5. Vanne de sécurité Water Block® (avec filtre et clé de réglage)
6. Tuyau à spirales et pistolet de distribution
7. Carte de garantie et mode d'emploi.

INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL

SIGNIFICATION DES SYMBOLES ET DONNÉES DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

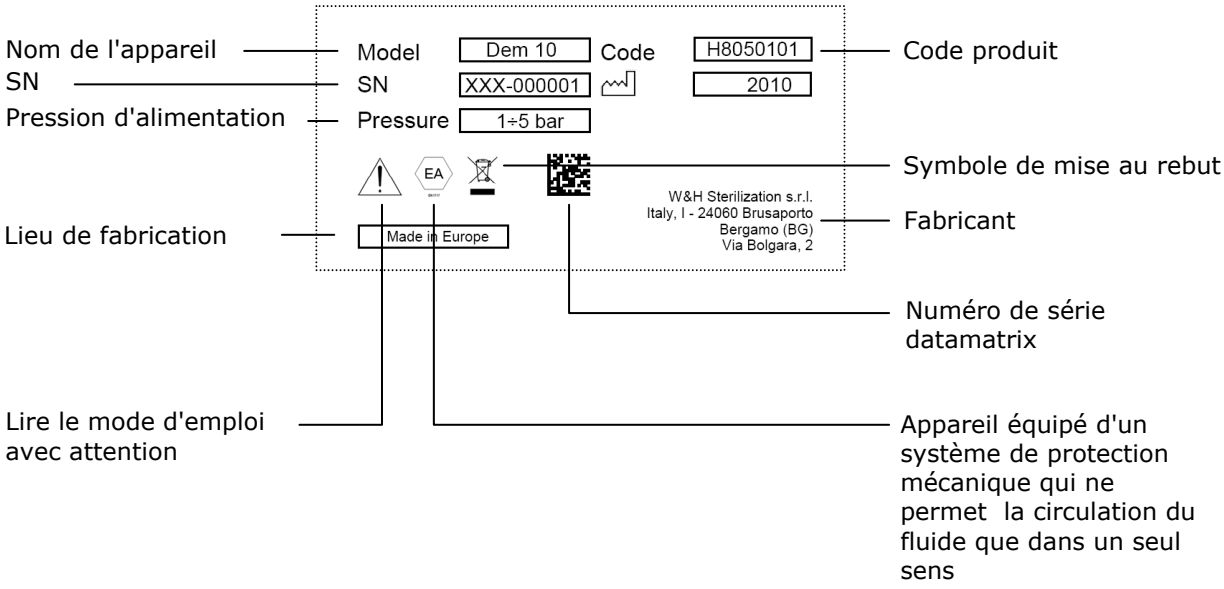

MISE EN PLACE DES CARTOUCHES DE RESINE

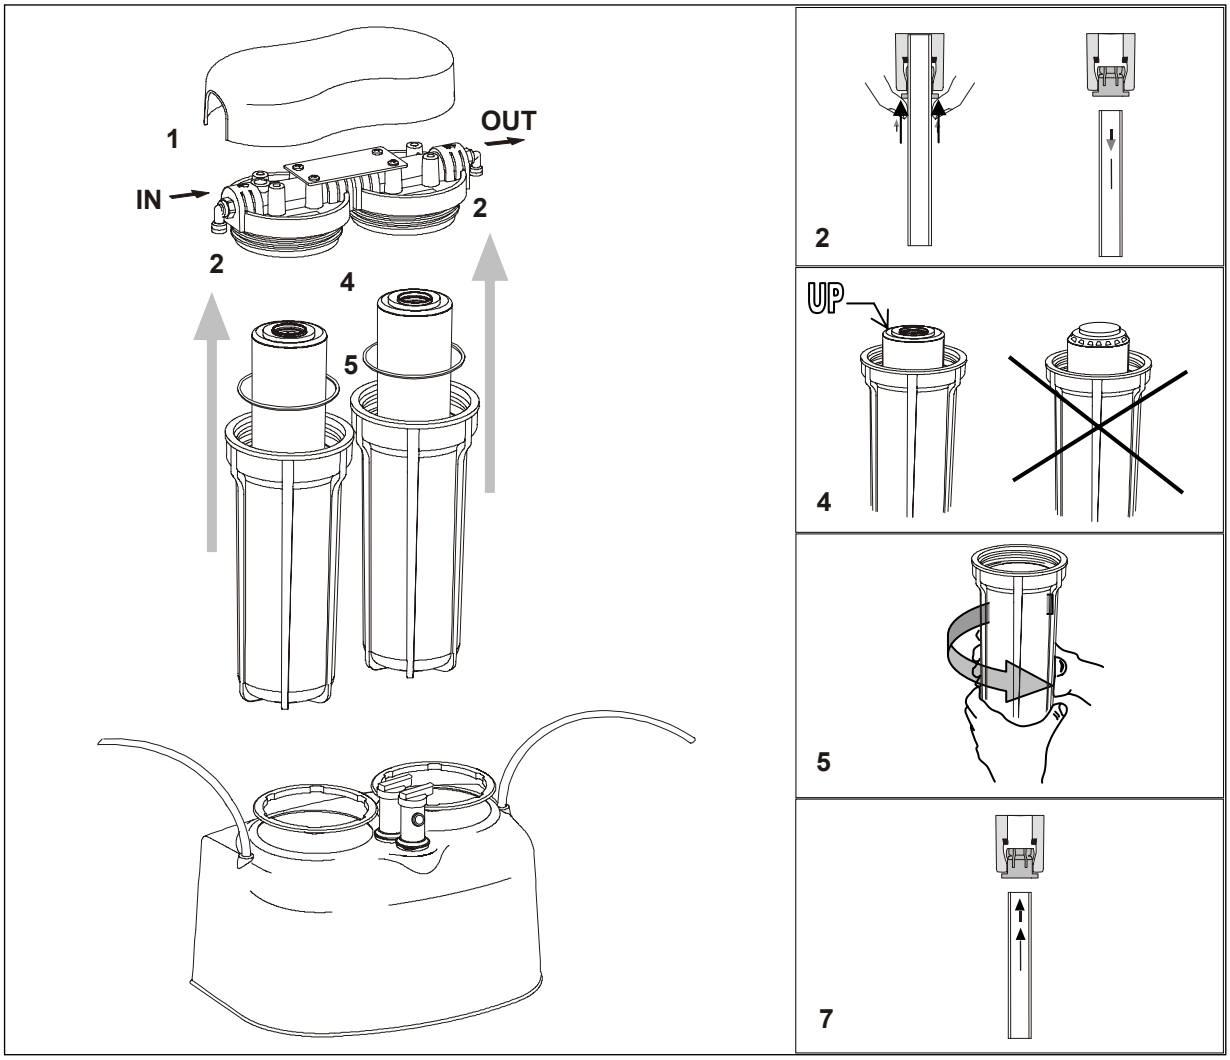

Figure 2

1. Retirer le couvercle.
2. Déconnecter les tuyaux des raccords rapides (ENTREE/SORTIE) et extraire l'ensemble supports cartouches.
3. Dévisser les supports cartouches (à l'aide de la clé si nécessaire), retirer les cartouches usées.
4. Déballer les cartouches neuves et les insérer dans les supports (partie conique vers le bas et l'indication "UP" vers le haut).
5. Positionner les joints toriques sur l'extrémité des supports cartouches, visser et serrer les supports manuellement. En cas d'utilisation de la clé : serrer modérément.
6. Insérer et positionner l'ensemble supports cartouches dans le socle à l'aide des anneaux de centrage.
7. Connecter les tuyaux d'entrée (gauche) et de sortie (droite) aux têtes.
8. Remettre le couvercle.

INSTALLATION

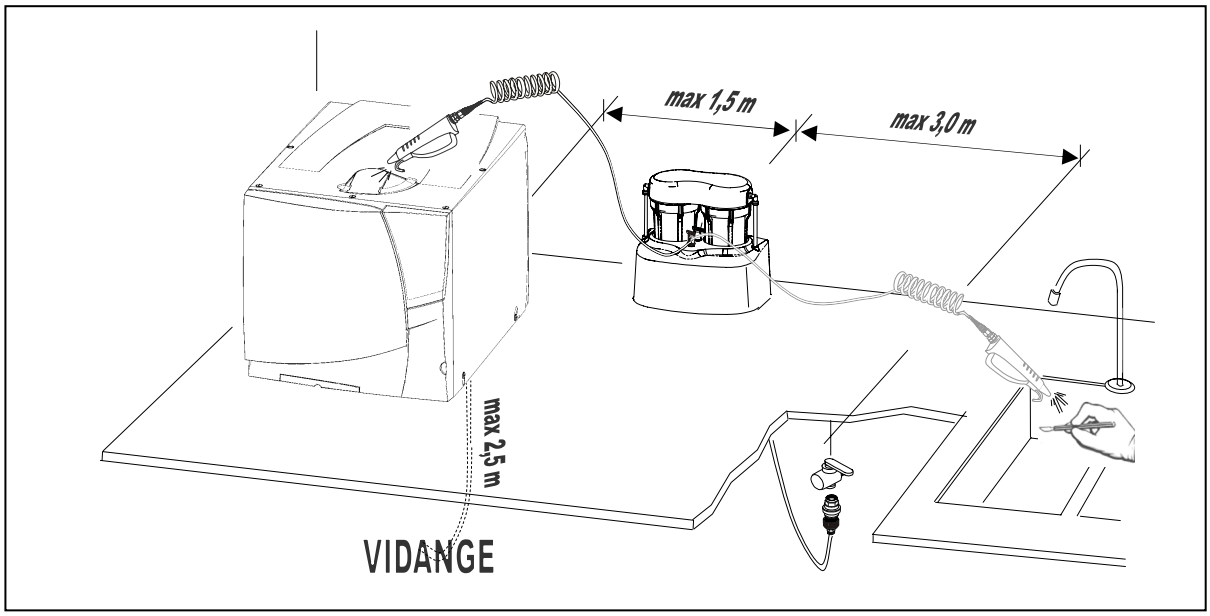

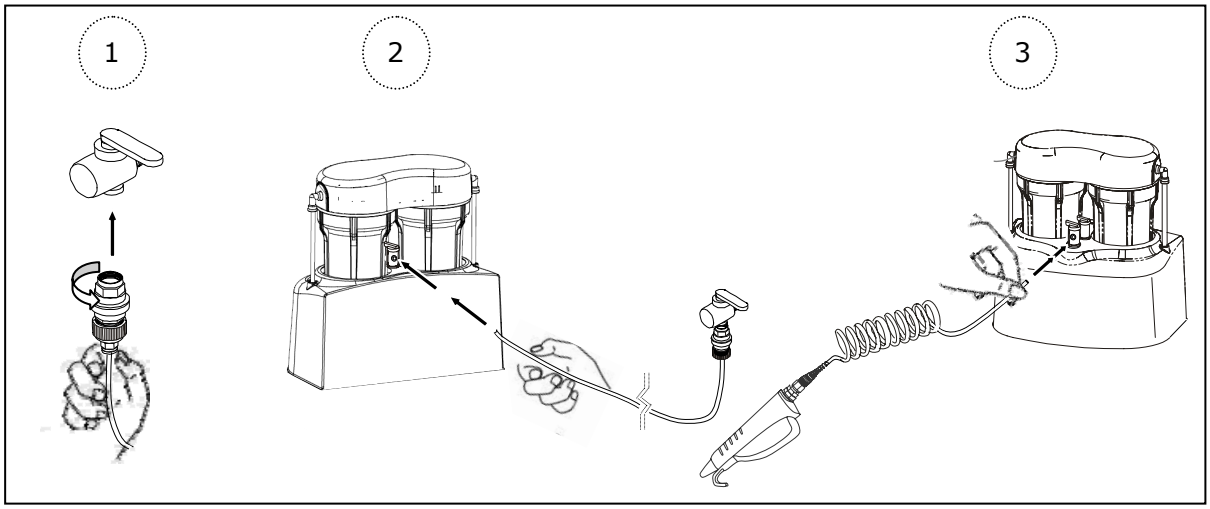

1. Visser le système de sécurité Water Block® sur le raccord d'arrivée d'eau courante.

2. Connecter le tuyau d'alimentation en eau courante (4) au raccord d'arrivée d'eau courante et à l'entrée du Dem 10.

3. Connecter le tuyau à spirales au robinet d'arrêt en façade du Dem10.

ATTENTION
Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.
La vanne de sécurité Water Block® est équipée d'un clapet anti-retour spécial qui empêche le reflux de liquide dans le réseau et par conséquent la pollution de l'eau courante. **Le système Water Block® doit impérativement être monté verticalement**.

ATTENTION
Contrôler que tous les tuyaux soient connectés correctement. Avant de connecter les tuyaux, contrôler qu'ils soient coupés à 90° sans bavures.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RESINE

Si l'équipement est utilisé avec stérilisateur, remplacer le jeu de cartouches de résine lorsqu'un message indiquant que la conductibilité de l'eau dépasse une valeur de 15-20 µS est affiché sur l'écran du stérilisateur ou bien si la valeur est lue directement sur le testeur Prim.

1. Fermer le robinet d'alimentation d'eau courante.
2. Eliminer la pression résiduelle de l'appareil en appuyant sur le pistolet distributeur (faites attention que le robinet du tuyau à spirales soit ouvert pendant cette opération).
3. Suivre les instructions décrites dans le chapitre précédent :
   " MISE EN PLACE DES CARTOUCHES DE RESINE"
4. Rouvrir le robinet d'alimentation d'eau courante.

MESURE DE PREVENTION EN CAS D'ARRET PROLONGE

ATTENTION
Conformément aux recommandations de la norme EN1717, en cas d'arrêt prolongé de l'appareil (plus de 10 jours), il est recommandé de purger complètement le circuit hydraulique. Ceci évitera la croissance bactérienne dans l'appareil Dem 10 et dans les réservoirs du stérilisateur en raison de la stagnation de l'eau.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir été correctement installé, l'appareil est prêt à fournir, par remplissage manuel, l'eau nécessaire au fonctionnement du stérilisateur (voir mode d'emploi du stérilisateur).

ATTENTION
En mettant en fonction le levier de commande du pistolet, avec aucun relâche, l'appareil fourni environ 5 litres d'eau déminéralisée dans un période qui est variable en fonction du pression de l'eau courante.
Ensuite on peut vérifier l'intervention du Water Block.
Pour éviter cette intervention on conseille de ne pas tenir le levier du pistolet toujours en action mais le laisser légèrement tout les 30 minutes.
Pour rétablir l'appareil en cas ou le Water Block entre en fonction faire référence à la section : Instruction de maintenance de la vanne de sécurité. (WATER BLOCK)

ATTENTION
Le système de sécurité Water Block® a pour fonction de bloquer l'arrivée d'eau en cas de débit anormalement élevé (rupture nette et accidentelle du tuyau d'alimentation du déminéralisateur) évitant ainsi l'inondation du local. Pour cette raison, le système n'interviendra pas en cas de petites fuites sur le circuit hydraulique.

ATTENTION
Nous recommandons de fermer le robinet connecteur entre le tuyau à spirales et le Dem 10 si le pistolet n'est pas utilisé.

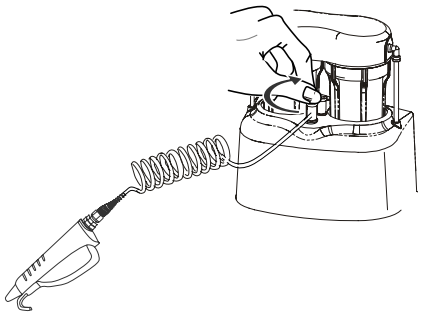

La quantité d'eau produite par jeu de cartouches de résine dépend directement de la qualité et de la dureté de l'eau courante. Se référer au tableau suivant :

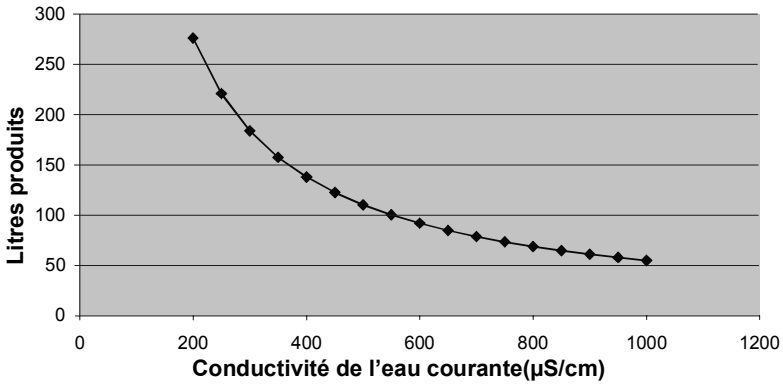

ENTRETIEN

NETTOYAGE EXTERNE

Nettoyer les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon humide et un détergent non abrasif et non corrosif (pH neutre).

ENTRETIEN DE LA VANNE DE SECURITE WATER BLOCK®

En fonction de la qualité de l'eau courante et de la fréquence d'utilisation de l'appareil, nous recommandons de nettoyer à intervalles réguliers le filtre à l'entrée de la vanne (voir périodicité dans le document fournit avec ce manuel).

CONTROLE PERIODIQUE DES SYSTEMES ANTI-REFLUX

ATTENTION

Il est nécessaire de faire contrôler les systèmes anti-reflux (Water block® et clapet anti-retour) au moins une fois par an ou à l'occasion d'une intervention sur le stérilisateur par un technicien qualifié selon les prescriptions du manuel technique du Dem10.

PIÈCES DE RECHANGE

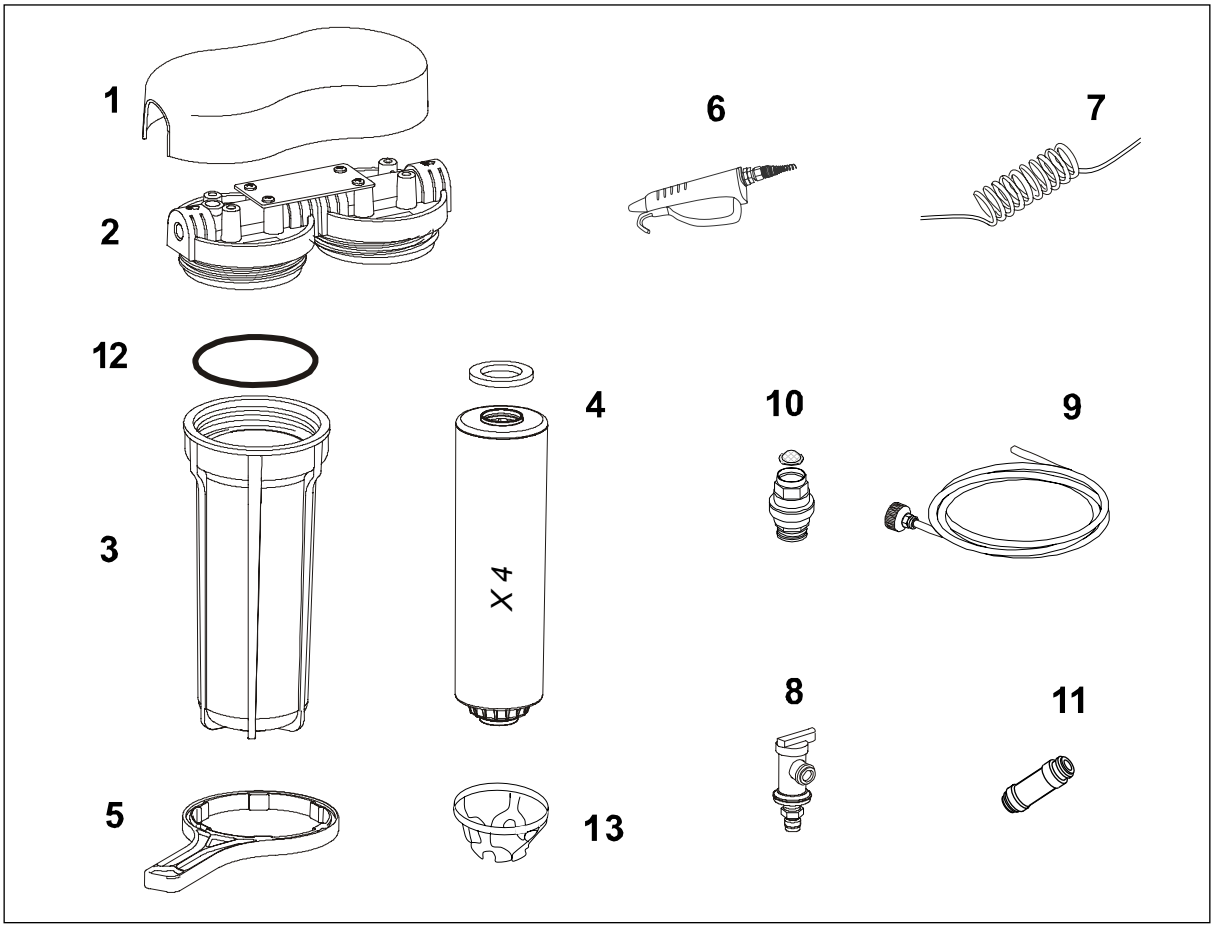

Nr.	Description	Code
1	COUVERCLE	A812109X
2	TÊTES DE CARTOUCHES	A812104X
3	SUPPORT CARTOUCHE	A812103X
4	CARTOUCHES DE RESINE + JOINTS D'ETANCHEITE	A812100X
5	CLE DE SERRAGE	A812101X
6	PISTOLET DISTRIBUTEUR	A812106X
7	TUYAU À SPIRALES	A812105X
8	ROBINET SORTIE D'EAU	A812107X
9	TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU COURANTE (4M, Ø 6X4MM) avec raccord	A812102X
10	SYSTEME DE SECURITE WATER BLOCK ® (+ FILTRE ET CLE DE REGLAGE)	A812005X
11	CLAPET ANTI-RETOUR + RACCORD ROBINET SORTIE D'EAU	A812108X
12	JOINT TORIQUE	A813014X
13	ANNEAU DE CENTRAGE	A813006X

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température d'utilisation	+5°C à +30°C
Température de stockage	+5°C à +35°C Conserver à l'abri du soleil et autres sources de chaleur.
Dimensions (LxPxH)	305x190x320 mm (LxPxH)
Poids (sans cartouche)	2,8 kg
Poids des cartouches	1,5 Kg
Pression hydraulique minimale / maximale	1 - 5 bar
Pression de rupture	30 bar Max (435 Psi)
Quantité d'eau déminéralisée produite par jeu de cartouches de conductibilité inférieure à 15 - 20 µS [1]	110-130 litres

[1] *Condition de test: T=25°C, eau courante en entrée à 450 µS et pression hydraulique de 3 bar)*

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE LA VANNE DE SECURITE (WATER BLOCK®)

VANNE DE SECURITE WATER BLOCK (WB)

Dispositif indispensable pour machines à laver, lave-vaisselle, déminéralisateurs, etc. car si le débit d'eau est supérieur à celui réglé sur l'indicateur (rupture de tuyau), il bloque le passage de l'eau. Il est doté également d'un clapet anti-retour (anti-pollution). Pour un fonctionnement optimal, le dispositif doit être monté en position verticale, conformément à la *fig.2*, en suivant soigneusement la notice de montage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression de rupture: 500 N/cm²
- Pression statique maximal: 100 N/cm²
- Volume maximum contrôlé: 50 l environ.
- Débit minimum de fonctionnement:2 l/min.
- Débit maximum de fonctionnement:30 l/min
- Température maximal de l'eau: 70° C

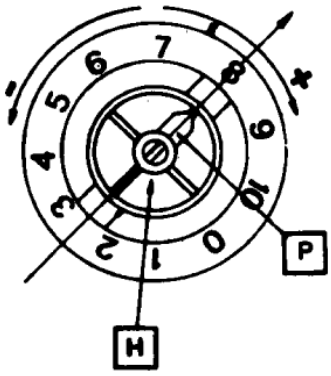

Fig. 1

INSTRUCTIONS

Le WATER BLOCK doit être monté entre le robinet d'arrivée d'eau courante et le tuyau d'alimentation du déminéralisateur *(fig. 2)*. Vérifier la position de l'indicateur P qui doit être réglé sur le **repère 1,5**. Si nécessaire et à l'aide de la clé fournie, tourner l'indicateur P dans le sens anti-horaire jusqu'à trouver la position exacte.

ATTENTION:

Pour l'emploi sur des appareils différents, tourner l'indicateur dans la position la plus appropriée en tenant compte du fait que chaque numéro de l'échelle correspond à un volume de 4 à 6 litres. En cas d'installation sur des appareils prévus puor une distribution d'eau potable à l'usage alimentaire, il est conseillé, afin d'éliminer les éventuelles impuretés accumulées durant le stockage, de faire passer au moins 10 litres d'eau du réseau à l'intérieur du dispositif avant le raccordement.

MONTAGE

1. Visser manuellement le WB sur le robinet (filetage 3/4" gaz), en prenant soin d'insérer le filtre E avec la partie bombée orientée vers le haut (fig. 2). Le montage incorrect du filtre empêcherait le bon fonctionnement du WB. En cas de serrage avec un outil, prendre appui sur la partie octogonale A.

2. Visser le tuyau d'alimentation C sur la partie inférieure du WB. Si le tuyau est doté d'un filtre, ce dernier doit être enlevé et remplacé par un joint plat en caoutchouc F. En cas de serrage avec un outil, prendre appui sur la partie hexagonale B pour éviter la rotation du WB pendant l'opération. Si le débit d'eau est supérieur à celui préréglé sur l'indicateur P (fuite), le WB bloque le passage de l'eau. Pour réactiver son fonctionnement, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau, trouver la source du problème, dévisser le tuyau d'alimentation C du WB et appuyer sur le bouton H situé à côté de l'indicateur *(fig. 1)*. En cas de pression élevée, cette opération peut s'avérer difficile. Dans ce cas dévisser légèrement le WB du robinet ce qui facilitera le réarmement du bouton H. Répéter ensuite les opérations indiquées dans le paragraphe "Montage".

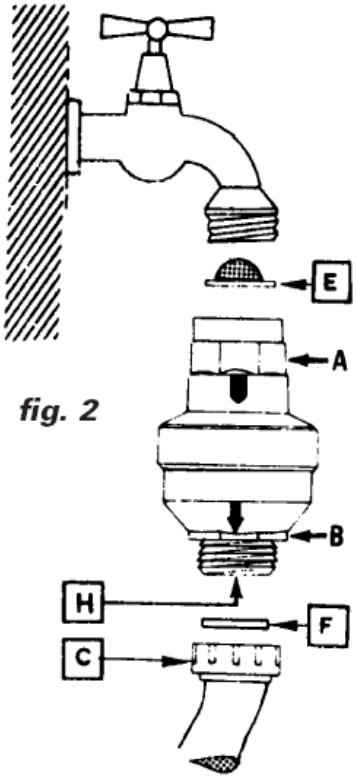

fig. 2

REMARQUE:

Pour prévenir d'éventuels dommages causés par le gel de l'eau présente dans le WB après installation, la température ambiante d'utilisation ne doit jamais être inférieure à 2° C. Nous déclinons toute responsabilité liée à une utilisation incorrecte du WB et pour des applications non prévues dans ces instructions.

ENTRETIEN:

Selon les conditions et la fréquence d'utilisation, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre d'entrée E et de remplacer le joint F. Nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Dem 10

DEMINERALIZZATORE

MANUALE UTENTE

Egregio Dottore,

è nostra intenzione, innanzitutto, ringraziarLa per la fiducia che ci ha accordato acquistando il nostro demineralizzatore ***Dem 10****.*

La informiamo che il produttore rimane a sua completa disposizione per fornire notizie e delucidazioni in merito a tutto quanto concerne questo apparato.

Le ricordiamo altresì che, per un corretto uso del demineralizzatore, è strettamente necessario che questo manuale venga letto attentamente prima di utilizzare l'apparato. Infatti, i nostri prodotti rispondono alle norme generali vigenti relative alla sicurezza e non presentano pericolo per l'operatore, se utilizzati secondo le istruzioni prescritte.

Nell'augurarLe un proficuo lavoro, Le ricordiamo che è vietata la riproduzione di questo manuale e che, a seguito della continua ricerca e sviluppo tecnologici, le caratteristiche tecniche dell'apparato potrebbero essere modificate senza preavviso.

W&H STERILIZATION S.r.l.

INDICE

INTRODUZIONE 3

RACCOMANDAZIONI GENERALI 3
RESINE - PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 4
INDICAZIONI SULLA GARANZIA 5

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 6

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA 6
DIMENSIONI E PESO DELL'IMBALLO 6
CONTENUTO DELL'IMBALLO 7

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL DEMINERALIZZATORE 8

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E DEI DATI RIPORTATI SULLA TARGHETTA 8
MONTAGGIO DELLE CARTUCCE RESINE 9
INSTALLAZIONE 10
SOSTITUZIONE CARTUCCIA RESINE 11
PRECAUZIONI PER EVITARE IL RISTAGNO DELL'ACQUA 11
FUNZIONAMENTO DEL DEMINERALIZZATORE 12

MANUTENZIONE 13

PULIZIA ESTERNA 13
MANUTENZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA (WATER BLOCK®) 13
CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTIRIFLUSSO 13
PARTI DI RICAMBIO 14

CARATTERISTICHE TECNICHE 15

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE VALVOLA DI SICUREZZA (WATER BLOCK®) ... 16

INTRODUZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di fornire istruzioni per:
- la corretta installazione;
- l'utilizzo sicuro ed efficiente dell'apparato;
- la continua e regolare manutenzione.

※ Tutte le dimensioni indicate nel manuale non sono vincolanti.

※ I disegni e qualsiasi altro documento contenuti in questo manuale sono di proprietà del produttore, che se ne riserva tutti i diritti e non possono essere messi a disposizione di terzi.

※ È vietata la riproduzione anche parziale del testo o delle illustrazioni.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

- L'apparato deve essere usato in ottemperanza alle procedure contenute nel manuale e mai per scopi diversi da quelli in esso previsti.
- L'utente è responsabile per quanto concerne l'installazione, il corretto funzionamento e utilizzo e la regolare manutenzione dell'apparato secondo le istruzioni riportate in questo manuale.
- Utilizzare solo cartucce specifiche per questo prodotto.
- **Non bere** l'acqua prodotta da Dem 10.
- **Non otturare o schiacciare** i tubi dell'acqua in ingresso e in uscita dall'apparato.
- Qualora l'apparato non fosse fatto funzionare in modo corretto oppure non venga effettuata una adeguata manutenzione, il fabbricante non può essere considerato responsabile di eventuali guasti, rotture, o del cattivo funzionamento dell'apparato stesso.
- Quando in abbinamento con una sterilizzatrice, al superamento del valore di conducibilità di 15-20 μS, sostituire immediatamente le cartucce delle resine. In caso contrario la sterilizzatrice potrebbe danneggiarsi.

Destinazione d'uso: Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato presso l'apparato per una facile e rapida consultazione. Il Dem 10 è da destinarsi solo all'impiego per il quale è stato concepito.

Dem 10: Apparato concepito per la demineralizzazione dell'acqua potabile della rete idrica e per l'alimentazione manuale degli sterilizzatori a vapore.

RESINE - PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Pericolo per contatto	
Contatto con gli occhi	Irritante per gli occhi (R36).
Contatto con la pelle	Leggermente irritante per la pelle.
Interventi di primo soccorso	
Contatto con la pelle	Togliersi di dosso gli strumenti contaminati. Rimuovere le particelle e lavare la zona interessata con acqua.
Contatto gli occhi	Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e rimuovere tutte le particelle.
Provvedimenti in caso di dispersione accidentale	
Precauzioni per le persone	Tenere lontano le persone. Rende sdrucciolevole il pavimento: fare attenzione per evitare cadute.
Metodi di bonifica	Raccogliere il prodotto e trasferirlo in adeguati imballi di materiale plastico per il suo recupero o smaltimento, secondo quanto indicato.
Note per lo smaltimento	
Il prodotto usato è un rifiuto speciale non pericoloso. Il prodotto deve essere smaltito nel rispetto della normativa vigente, sia essa locale, regionale o nazionale. Il numero CER per le resine a scambio ionico sature od esauste usate per la preparazione di acqua potabile od acqua per uso industriale è: **19 09 05**.	

INDICAZIONI SULLA GARANZIA

Il produttore garantisce la qualità dei propri apparati se utilizzati in accordo con le istruzioni fornite in questo manuale, per un periodo di **12 mesi** per le parti meccaniche.
La garanzia ha inizio dalla data di consegna dell'apparato al cliente, comprovata dalla restituzione del tagliando di garanzia debitamente compilato e firmato.

In caso di contestazione, verrà ritenuta valida la data indicata sul Documento di trasporto che riporta il numero di matricola dell'apparato. La garanzia non copre difetti o danni derivanti da:

- Installazione inadeguata
- Manutenzione impropria
- Manomissioni e modifiche non autorizzate
- Uso scorretto dell'apparato
- Non rispetto delle indicazioni fornite in questo manuale

È esclusa la sostituzione dell'apparato ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.
La riparazione in garanzia viene effettuata ad insindacabile giudizio del produttore e non comprende le spese di imballaggio e trasporto.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE	W&H
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA	

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**
FR	**1 An de Garantie**
DE	**1 Jahr Garantie**
IT	**1 Anno di Garanzia**

GB	Purchase date:	FR	Date de vente:
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:

GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:

GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:

COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

Al ricevimento del prodotto controllare che l'imballo sia integro (conservarlo per eventuali spedizioni).

Aprire l'imballo e controllare che:
- la fornitura corrisponda al documento di accompagnamento;
- non vi siano danni evidenti.

In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato lo spedizioniere, il deposito dentale o il trademark.

DIMENSIONI E PESO DELL'IMBALLO

Peso lordo: 6.5 Kg

Dimensioni in mm:

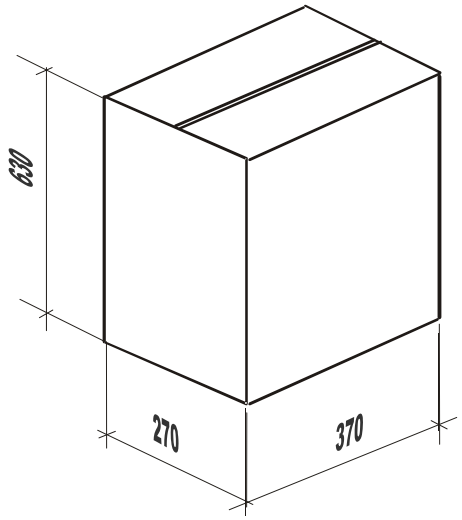

CONTENUTO DELL'IMBALLO

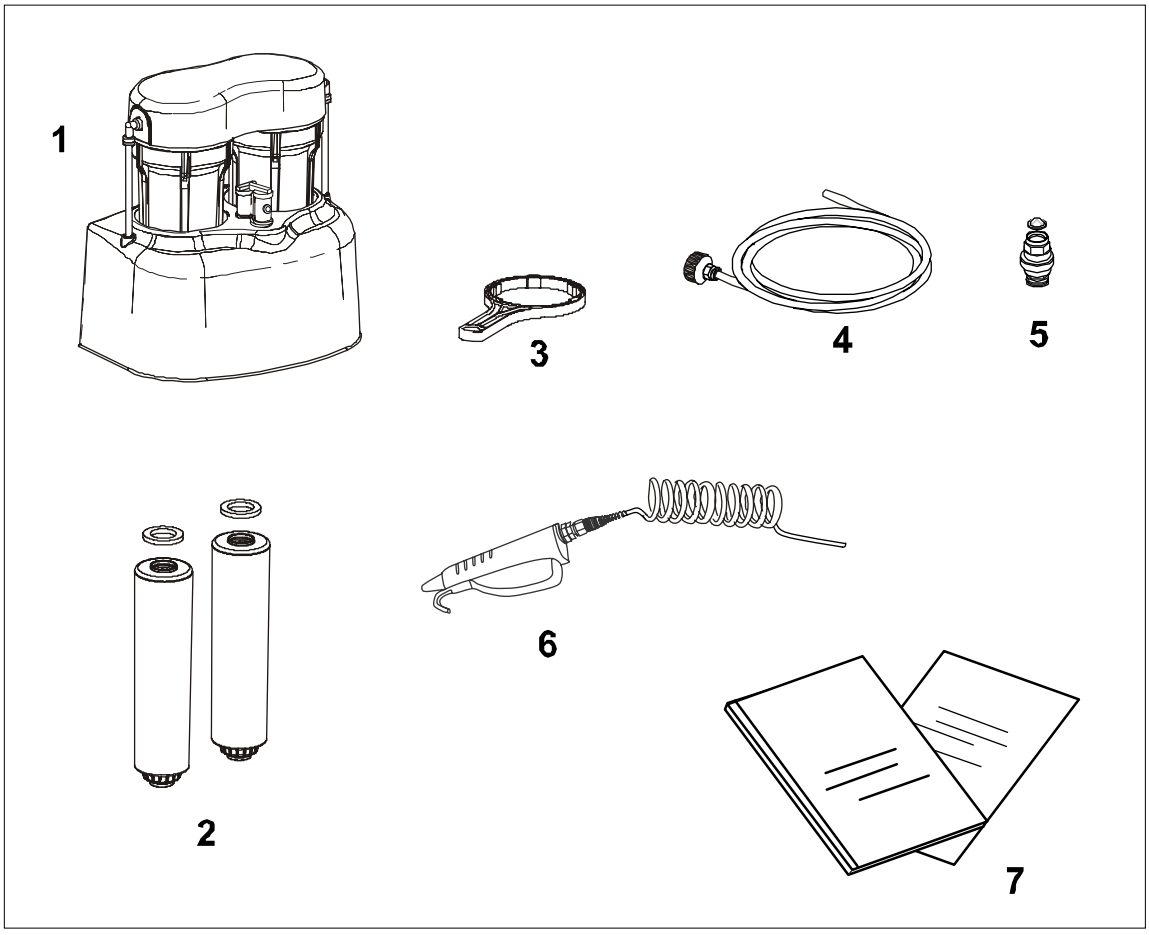

Figura 1

Voce	Descrizione
1.	Apparato demineralizzatore (teste + porta cartucce + O-ring + anelli di centraggio)
2.	N. 2 cartucce resine + guarnizione
3.	Chiave per sostituzione cartuccia resine
4.	Tubo rete idrica con attacco per rubinetto e raccordi per collegamento (4 m, Ø 6x4mm)
5.	Valvola sicurezza (Water Block®) con filtro e chiave di regolazione
6.	Tubo spiralato con pistola
7.	Certificato di garanzia e Manuale utente

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL DEMINERALIZZATORE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E DEI DATI RIPORTATI SULLA TARGHETTA

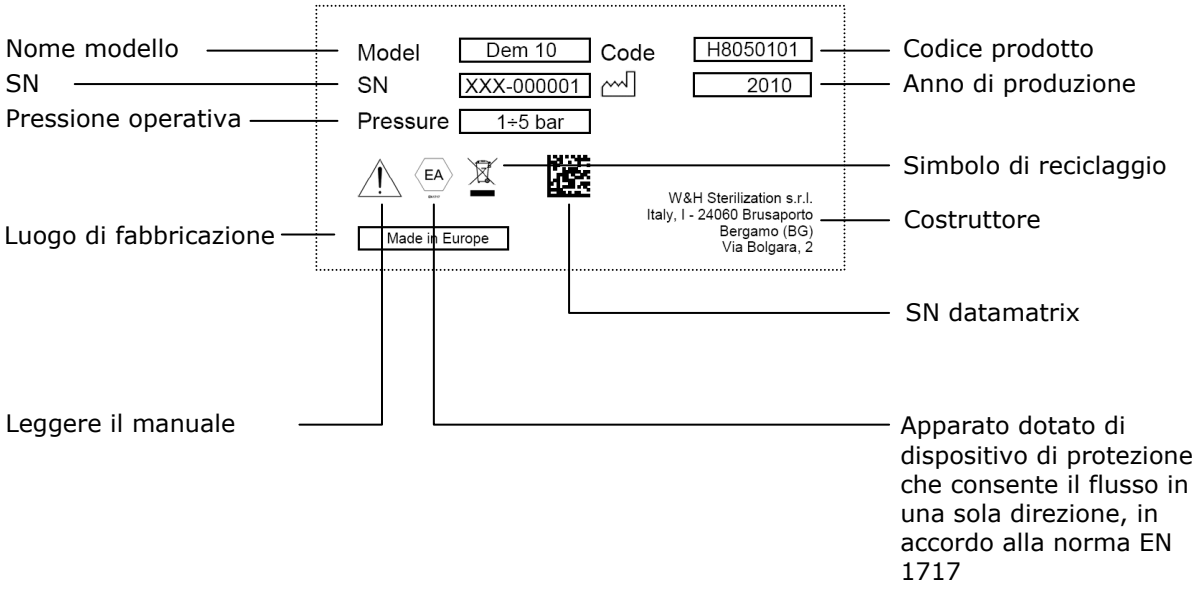

MONTAGGIO DELLE CARTUCCE RESINE

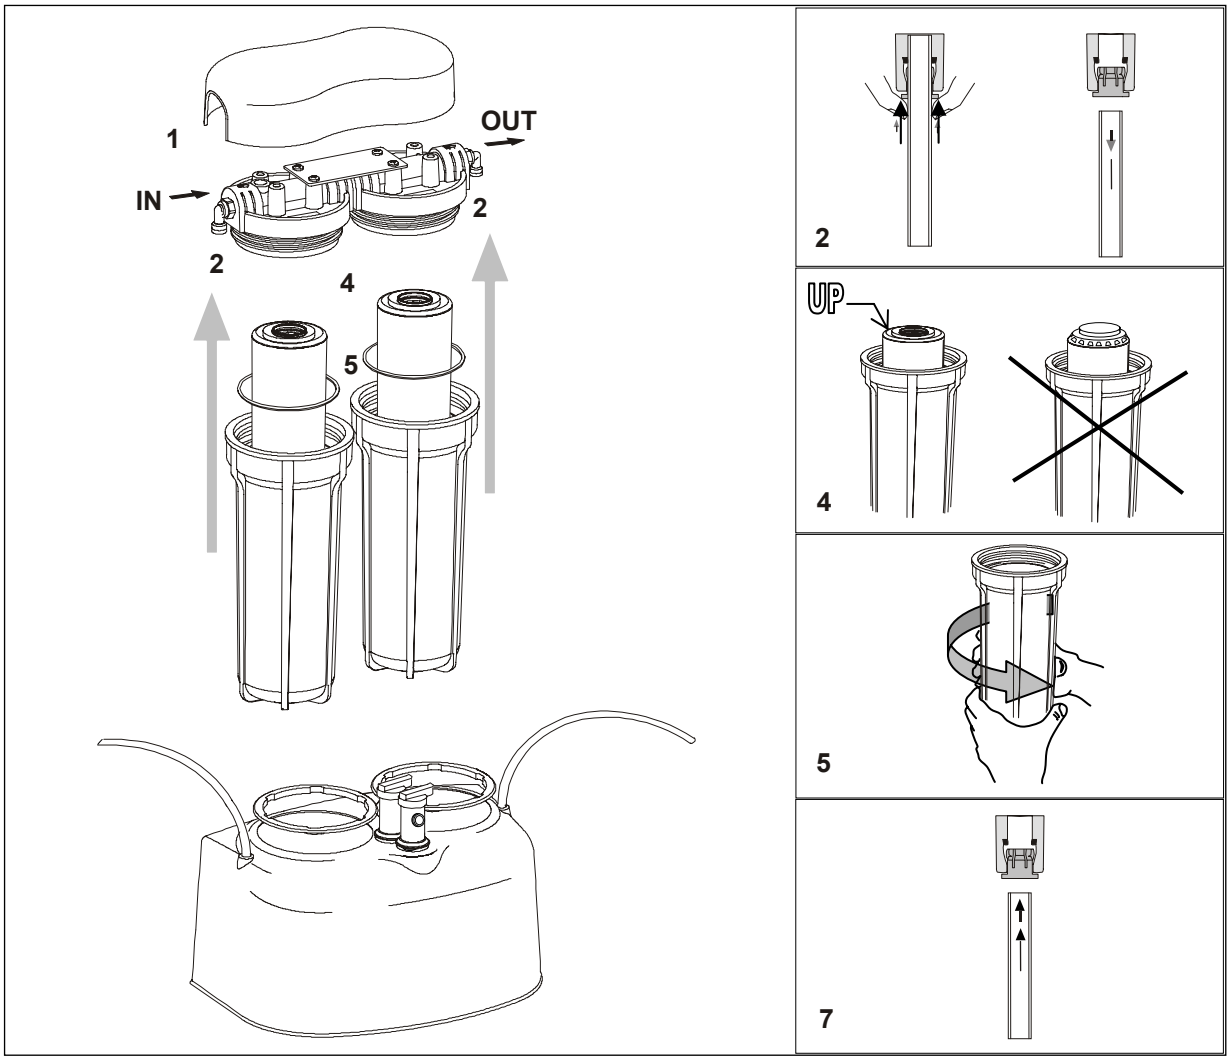

Figura 2

1. Rimuovere il coperchio delle testate.
2. Rimuovere i tubi dai collegamenti ad innesto rapido ed estrarre la coppia di porta cartucce.
3. Svitare i vasi porta cartucce (se necessario usare l'apposita chiave).
4. Rimuovere il sacchetto protettivo delle cartucce e inserirle nei vasi (parte conica verso il basso e scritta "UP" in alto).
5. Posizionare gli O-Ring sull'imbocco dei vasi porta cartucce e avvitare i vasi (in caso di utilizzo della chiave usare forza moderata).
6. Inserire i vasi nel basamento e centrare correttamente con gli anelli di fissaggio.
7. Ripristinare i tubi sui raccordi IN e OUT della testa (verificare che il raccordo IN sia posizionato a sinistra).
8. Posizionare il coperchio delle testate.

INSTALLAZIONE

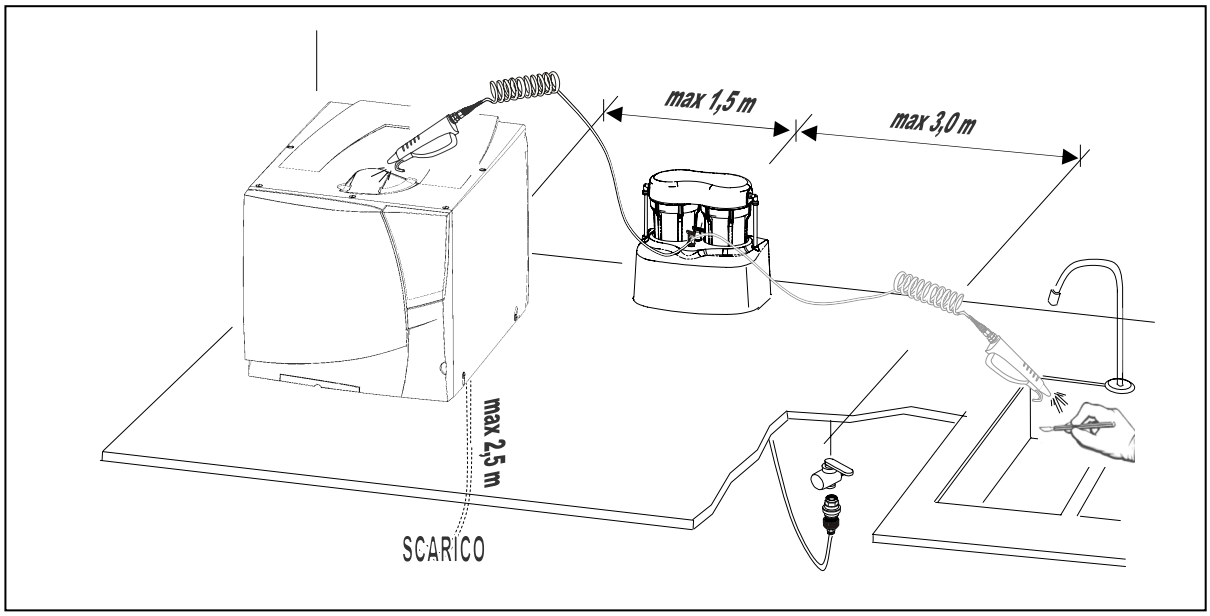

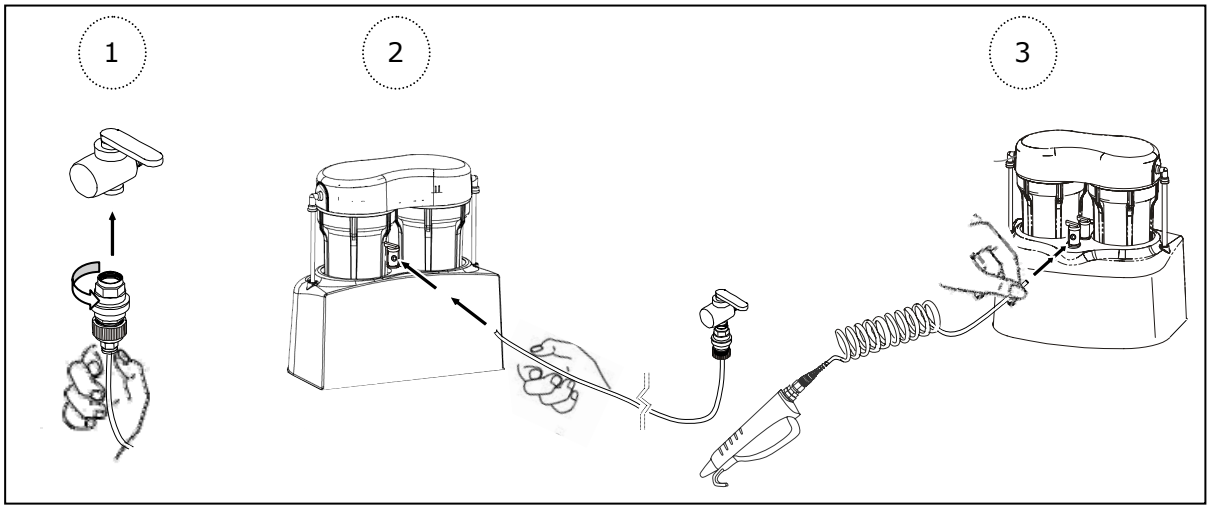

1. Montare la valvola di sicurezza (Water Block®) sul raccordo di uscita dell'acqua.
2. Collegare il tubo di rete idrica in dotazione (voce 4) tra il raccordo di entrata dell'acqua e il rubinetto del Dem 10.
3. Collegare il tubo spiralato al raccordo anteriore del Dem10.

ATTENZIONE
Utilizzare solo ricambi originali.
La valvola di sicurezza (Water Block®) è dotata di una speciale valvola unidirezionale che impedisce il ritorno di liquidi nella rete idrica ed un possibile conseguente suo inquinamento.
A questo scopo la valvola WB deve essere montata in posizione verticale.

ATTENZIONE
Verificare che tutti i tubi siano collegati correttamente.
Prima di collegare i tubi verificare che siano tagliati correttamente: taglio a 90° e senza sbavature.

SOSTITUZIONE CARTUCCIA RESINE

Quando utilizzato per una/due sterilizzatrici, sostituire le cartucce al raggiungimento di un valore di conducibilità dell'acqua di 15-20 µS.

1. Chiudere il rubinetto di ingresso acqua.
2. Scaricare la pressione del prodotto utilizzando la pistola in dotazione (controllare che durante questa operazione il rubinetto di collegamento del tubo spiralato sia aperto).
3. Seguire quanto descritto nel precedente paragrafo: *Montaggio delle cartucce resine*
4. Riaprire il rubinetto di ingresso acqua.

PRECAUZIONI PER EVITARE IL RISTAGNO DELL'ACQUA

ATTENZIONE
In conformità alla norma EN 1717, per evitare il degrado della qualità dell'acqua e la crescita di batteri dovuti al ristagno di acqua nelle tubazioni, nel demineralizzatore stesso e nei serbatoi della sterilizzatrice, è necessario svuotare l'intero sistema prima di lasciarlo inutilizzato per lungo tempo.

FUNZIONAMENTO DEL DEMINERALIZZATORE

Una volta installato ed allacciato correttamente, il demineralizzatore è in grado di fornire immediatamente l'acqua demineralizzata. Questa acqua è pronta per essere utilizzata o caricata in modo manuale nel serbatoio dello sterilizzatore (vedi manuale d'uso sterilizzatore).

ATTENZIONE
Azionando la leva di comando della pistola. senza alcun rilascio, l'apparecchio fornisce circa 5 litri di acqua demineralizzata, in un tempo variabile in funzione della pressione della rete idrica a cui lo stesso è connesso.
Oltre questo tempo si può verificare l'intervento del dispositivo antiallagamento denominato Water Block.
Per evitare questo azionamento si consiglia di non mantenere sempre completamente azionata la leva della pistola ma di rilasciarla leggermente almeno ogni 30 secondi.
In caso di intervento del dispositivo antiallagamento, per il ripristino dell'apparecchio vedere la sezione vedere sezione "Istruzioni di manutenzione valvola di sicurezza".

ATTENZIONE
Il blocco della portata avviene solo in condizioni di elevata perdita di acqua (taglio netto del tubo di collegamento tra Water Block e demineralizzatore). Per questo motivo l'intervento del dispositivo non avviene se nel circuito idraulico del prodotto è presente una leggera perdita.

ATTENZIONE
Se la pistola non è utilizzata si consiglia di chiudere il rubinetto di collegamento tra il tubo spiralato della pistola e il Dem 10.

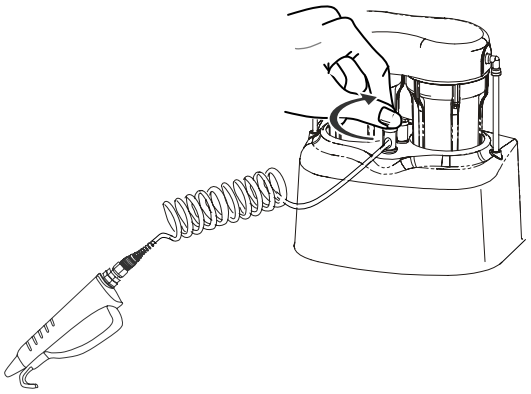

La quantità di acqua utile prodotta dalle cartucce resine dipende dalla qualità e dalla durezza dell'acqua della rete idrica. Fare riferimento al seguente diagramma:

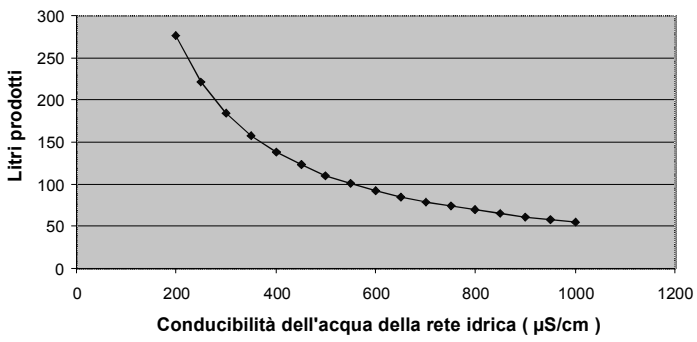

MANUTENZIONE

PULIZIA ESTERNA

Pulire la testa con panno inumidito con detergente non abrasivo e non corrosivo (pH neutro).

MANUTENZIONE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA (WATER BLOCK®)

In funzione della qualità dell'acqua e della frequenza di utilizzo dell'apparato demineralizzatore, si raccomanda di pulire periodicamente il filtro di entrata della valvola secondo quanto definito nel foglio di istruzioni allegato a questo manuale.

CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTIRIFLUSSO

ATTENZIONE
In conformità a quanto richiesto dalla norma EN 1717, far controllare questi dispositivi (Waterblock e valvola di non ritorno) almeno ogni anno eventualmente in concomitanza degli interventi di manutenzione da parte del servizio assistenza della sterilizzatrice.

PARTI DI RICAMBIO

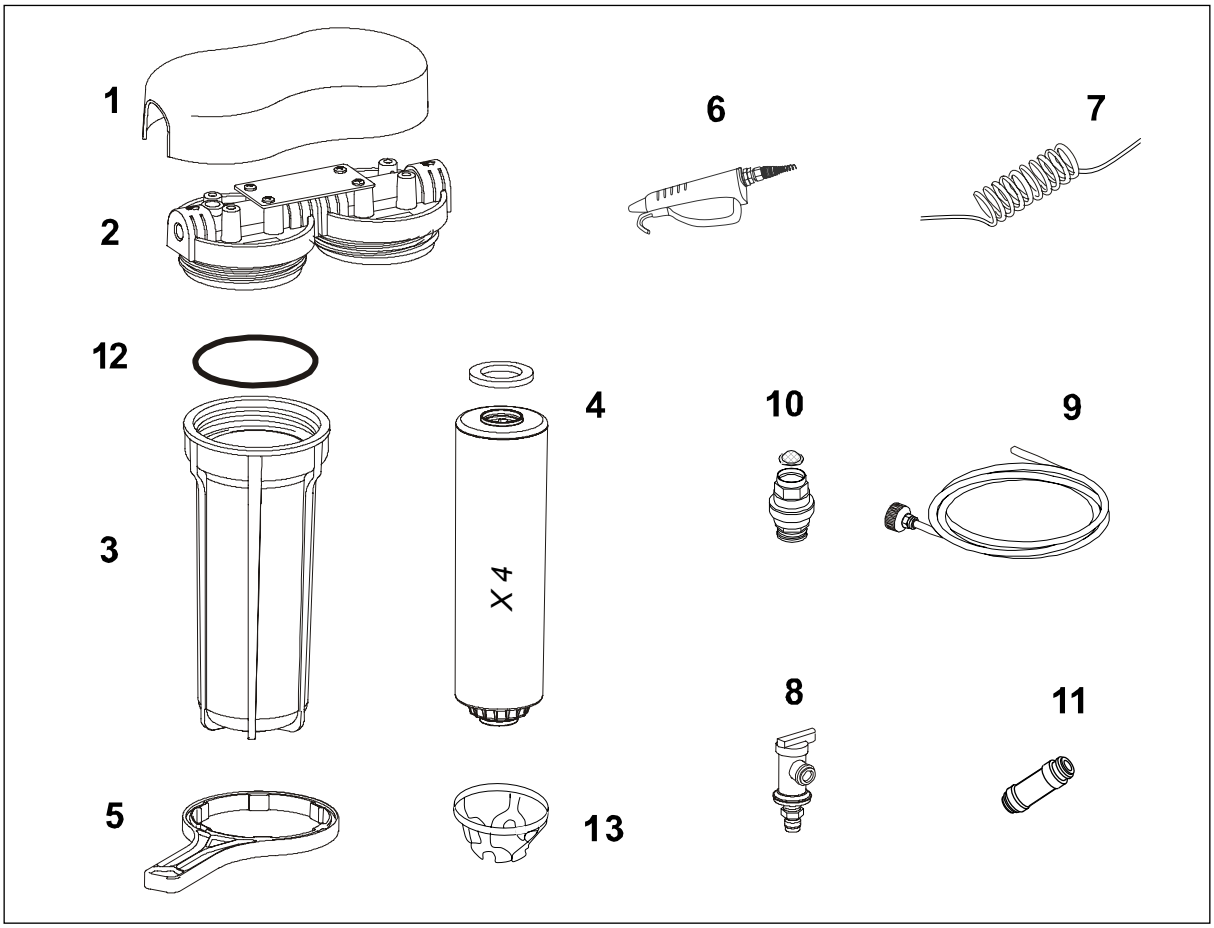

Nr.	Descrizione	Codice
1	COPERTURA TESTATE	A812109X
2	COPPIA TESTATA FILTRI	A812104X
3	VASO PORTA CARTUCCIA	A812103X
4	N. 2 RICAMBI CARTUCCE *(N.4 CARTUCCE + ANELLI DI TENUTA + OR)*	A812100X
5	CHIAVE PER SOSTITUZIONE CARTUCCIA RESINE	A812101X
6	PISTOLA	A812106X
7	TUBO SPIRALATO	A812105X
8	RUBINETTO	A812107X
9	TUBO RETE IDRICA CON ATTACCO PER RUBINETTO E RACCORDO (4 M, Ø 6X4MM)	A812102X
10	VALVOLA SICUREZZA (WATER BLOCK®) CON FILTRO E CHIAVE DI REGOLAZIONE	A812005X
11	VALVOLA DI NON RITORNO	A812108X
12	O-R	A813014X
13	ANELLO DI CENTRAGGIO	A813006X

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio	+5°C ÷ +30°C
Temperatura di immagazzinamento	+5°C ÷ +35°C tenere al riparo dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore
Dimensioni	305x190x320 mm (LxPxH)
Peso (senza cartuccia)	2,8 kg
Peso cartucce	1,5 Kg
Pressione minima e massima della rete idrica	1 - 5 bar
Pressione di scoppio	30 bar Max (435 Psi)
Quantità di acqua demineralizzata prodotta dalle cartucce con valore di conducibilità non superiore a 15÷20 µS [1]	110÷130 litri

[1] *Condizioni di test: T=25°C, Acqua potabile in entrata a 450 µS e pressione della rete di 3 bar*

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE VALVOLA DI SICUREZZA (WATER BLOCK®)

VALVOLA DI SICUREZZA WATER BLOCK (WB)
Accessorio indispensabile per lavatrici e lavastoviglie, demineralizzatori in quanto, nelle condizioni definite nelle caratteristiche tecniche di seguito descritte, impedisce il passaggio di quantità d'acqua superiori a quanto impostato sull'indicatore, evitando perdite continue. E' munito, inoltre, di speciale valvola anti ritorno (anti inquinamento). Per un perfetto funzionamento si consiglia il montaggio in posizione verticale, come indicato in fig. 2, seguendo scrupolosamente le successive indicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di scoppio: 500 N/cm²
- Pressione statica massima: 100 N/cm²
- Volume massimo controllabile: 50 l ca.
- Portata minima di funziona-mento: 2 l/min.
- Portata massima di funzionamento: 30 l/min
- Temperatura massima dell'acqua: 70° C

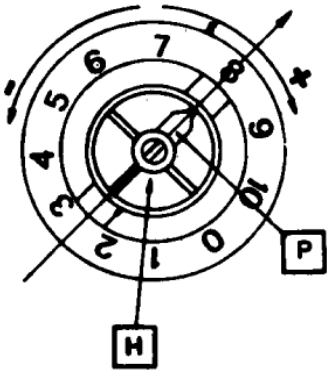

Fig. 1

ISTRUZIONI
WATER BLOCK va montato tra il rubinetto e il tubo di alimentazione del demineralizzatore (fig. 2). Servendosi della chiavetta fornita in dotazione, far ruotare in senso antiorario l'indicatore P sino a raggiungere la posizione 1,5. Se necessario, ruotare l'indicatore P fino a trovare la posizione più opportuna.

ATTENZIONE:
Per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri. In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulatesi durante l'immagazzinamento, far scorrere almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'allacciamento.

MONTAGGIO
1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provvisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede ottagonale A.
2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana F; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione. In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in seguito al passaggio di una quantità di liquido pari a quella precedentemente impostata sull'indicatore P. Per ripristinare il funzionamento del WB dopo l'azionamento del sistema di bloccaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua e provvedere all'eliminazione del guasto; svitare poi il tubo di carico acqua C dal WB e premere il pulsante H, che si trova in corrispondenza della parte inferiore dell'apparecchio (fig. 1). Se la pressione dell'acqua in ingresso è elevata, può accadere che tale manovra risulti difficoltosa. In tal caso svitare leggermente il WB dal rubinetto: il pulsante H potrà così essere premuto con estrema facilità. Ripetere quindi le operazioni indicate nella sezione montaggio.

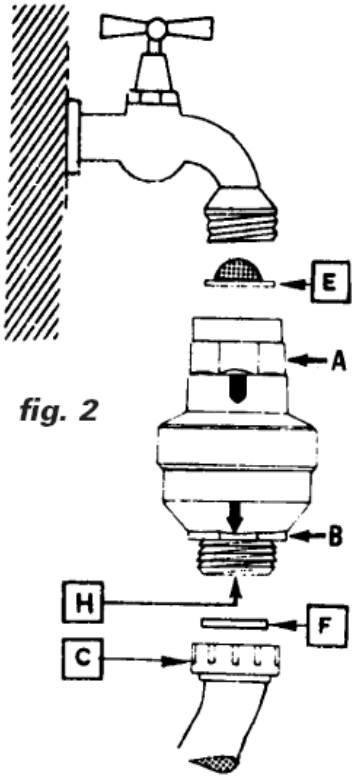

fig. 2

AVVERTENZE
Per prevenire possibili danneggiamenti causati dal congelamento dell'acqua contenuta nel WB dopo l'installazione, la temperatura dell'ambiente di utilizzo non deve mai scendere sotto i 2° C. Si declina comunque ogni responsabilità derivante dall'utilizzo scorretto del WB o dal suo uso per applicazioni e/o soluzioni non espressamente previste dalle presenti istruzioni.

MANUTENZIONE
In base alle condizioni ed alla frequenza di utilizzo si raccomanda di pulire periodicamente il filtro e di entrata e di provvedere *alla sostituzione della guarnizione F.*
Ci riserviamo di modificare le caratteristiche senza preavviso

Dem 10

DESMINERALIZADOR

MANUAL DEL USUARIO

Estimado Doctor,

Tenemos como intención, antes de nada, agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros adquiriendo nuestro aparato ***Dem 10****.*

Le informamos que el productor permanece a su completa disposición para suministrarle cualquier tipo de información y aclaraciones en lo que respecta a todo lo concerniente a este aparato.

Le recordamos además que, para un uso correcto de ***Dem 10****, es absolutamente necesario que este manual sea leído atentamente antes de utilizar el aparato. De hecho, nuestros productos cumplen estrictamente las normas generales vigentes relativas a la seguridad y no presentan peligro alguno para el operador siempre que sean utilizadas según las instrucciones prescritas.*

Deseándole un trabajo provechoso, le recordamos que está prohibida la reproducción de este manual y que, debido al continuo estudio y desarrollo tecnológico, las características técnicas del aparato podrían ser modificadas sin previo aviso.

W&H STERILIZATION S.r.l.

INDICE

INTRODUCCIÓN 3

RECOMENDACIONES GENERALES 3
RESINAS – PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD 4
INDICACIONES SOBRE LA GARANTÍA 5

COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 6

NOTAS GENERALES A LA ENTREGA 6
DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE 6
CONTENIDO DEL EMBALAJE 7

INSTALACIÓN Y USO DEL APARATO 8

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y DE LOS DATOS INDICADOS EN LA ETIQUETA 8
MONTAJE CARTUCHOS DE RESINAS 9
INSTALACIÓN 10
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE RESINA 11
PRECAUCIONES PARA EVITAR EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA 11
FUNCIONAMIENTO 12

MANTENIMIENTO 13

LIMPIEZA EXTERNA 13
MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD (WATER BLOCK®) 13
CONTROL PERIÓDICO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ANTI-REFLUJO 13
PIEZAS DE RECAMBIO 14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 15

INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO VÁLVULA DE SEGURIDAD(WATER BLOCK®)16

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente manual es suministrar instrucciones para:
- la correcta instalación,
- la utilización segura y eficiente del aparato y
- el mantenimiento continuo y periódico.

※ Las dimensiones indicadas en el manual no son vinculantes.

※ Las ilustraciones y cualquier otro documento contenidos en este manual son propiedad de productor, que tiene reservados todos los derechos y por lo tanto no pueden ponerse a disposición de terceros.

※ Está prohibida la reproducción total o parcial del texto y de las ilustraciones.

RECOMENDACIONES GENERALES

- El aparato debe ser usado siguiendo los procedimientos contenidos en el manual y nunca para finalidades diversas de las previstas en el mismo.
- El usuario es responsable en lo respectivo a la instalación el buen uso y mantemiento regular del aparato según las instrucciones indicadas en este manual.
- Utilizar sólo cartuchos G.F. s.r.l. para este producto.
- **No beber** el agua producida por Dem 10.
- **No obturar o aplastar** los tubos del agua de entrada y salida del aparato y del esterilizador.
- El fabricante no se hará responsable de los fallos, daños o disfunciones del equipo que no se opere correctamente o no se mantenga de forma adecuada.
- Si, al utilizarlo con un esterilizador, los valores de la conductividad del agua exceden los 15-20 μS, sustituya inmediatamente los cartuchos de resina o el esterilizador podrá dañarse.

Uso apropiado del aparato: El presente manual forma parte integrante del producto y debe ser conservado junto al aparato para una consulta fácil y rápida. El aparato está destinado sólo al empleo para el cual ha sido concebido.

Dem 10: Equipo diseñado para la desmineralización del agua corriente y el llenado de agua manual de los esterilizadores de vapor.

RESINAS – PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD

Peligro por contacto	
Contacto con los ojos	Irritante para los ojos (R36).
Contacto con la piel	Ligeramente irritante para la piel.
Intervenciones de primeros auxilios	
Contacto con la piel	Quitarse las ropas contaminadas. Eliminar las partículas y lavar la zona afectada con agua.
Contacto con los ojos	Lavar inmediatamente y con abundante agua y eliminar todas las partículas.
Medidas en caso de dispersión accidental	
Precauciones para las personas	Mantener lejos las personas. Hace resbaladizo el suelo: prestar atención para evitar caídas.
Métodos de recolección	Recoger el producto y trasladarlo en embalajes adecuados de material plástico para su recuperación o eliminación, según se indica mas adelante.
Notas para la eliminación	
El producto usado es un desecho especial no peligroso. El producto debe ser eliminado respetando la normativa vigente, siendo la misma local, regional o nacional. El número CER para las resinas de intercambio iónico saturadas o exhaustas usadas para la preparación de agua potable o agua para uso industrial es: **19 09 05**.	

INDICACIONES SOBRE LA GARANTÍA

El productor garantiza la calidad de sus aparatos siempre que sean utilizados de acuerdo con las instrucciones suministradas en este manual, durante un periodo de **12 meses** tanto para las partes mecánicas como para las eléctricas.

La garantía comienza a partir de la entrega del aparato al cliente, comprobada por la restitución de la tarjeta de garantía debidamente rellena y firmada.

En caso de duda, se considerará válida la fecha indicada en el documento de transporte que indica el número de serie del aparato. La garantía no cubre defectos o daños que deriven de:

- Instalación inadecuada
- Mantenimiento inapropiado
- Mantenimiento y modificaciones no autorizadas
- Uso incorrecto del aparato
- El no respetar las indicaciones suministradas en este manual

Se excluye la sustitución del aparato y la prolongación de la garantía por causa de averías reparadas por servicios técnicos no autorizados.

La reparación en garantía es efectuada a juicio incuestionable de productor y no comprende los gastos de embalaje y transporte.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**
FR	**1 An de Garantie**
DE	**1 Jahr Garantie**
IT	**1 Anno di Garanzia**

GB	Purchase date:	FR	Date de vente:
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:

GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:

GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:

Español

COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO

NOTAS GENERALES A LA ENTREGA

Controle al recibir el producto que el embalaje esté íntegro (conservarlo para eventuales envíos).

Abrir el embalaje y controlar que:
- el suministro corresponde al documento de presentación, y
- que no haya daños evidentes.

En caso de daños o partes no recibidas, informar inmediatamente y de manera detallada al consignatario, al depósito dental.

DIMENSIONES Y PESO DEL EMBALAJE

Dimensiones en mm
Peso bruto: 6.5 Kg

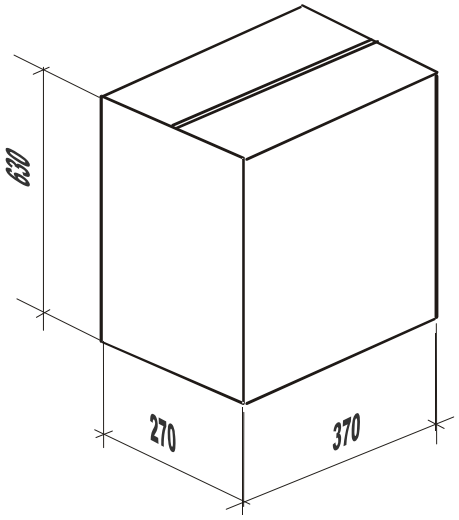

CONTENIDO DEL EMBALAJE

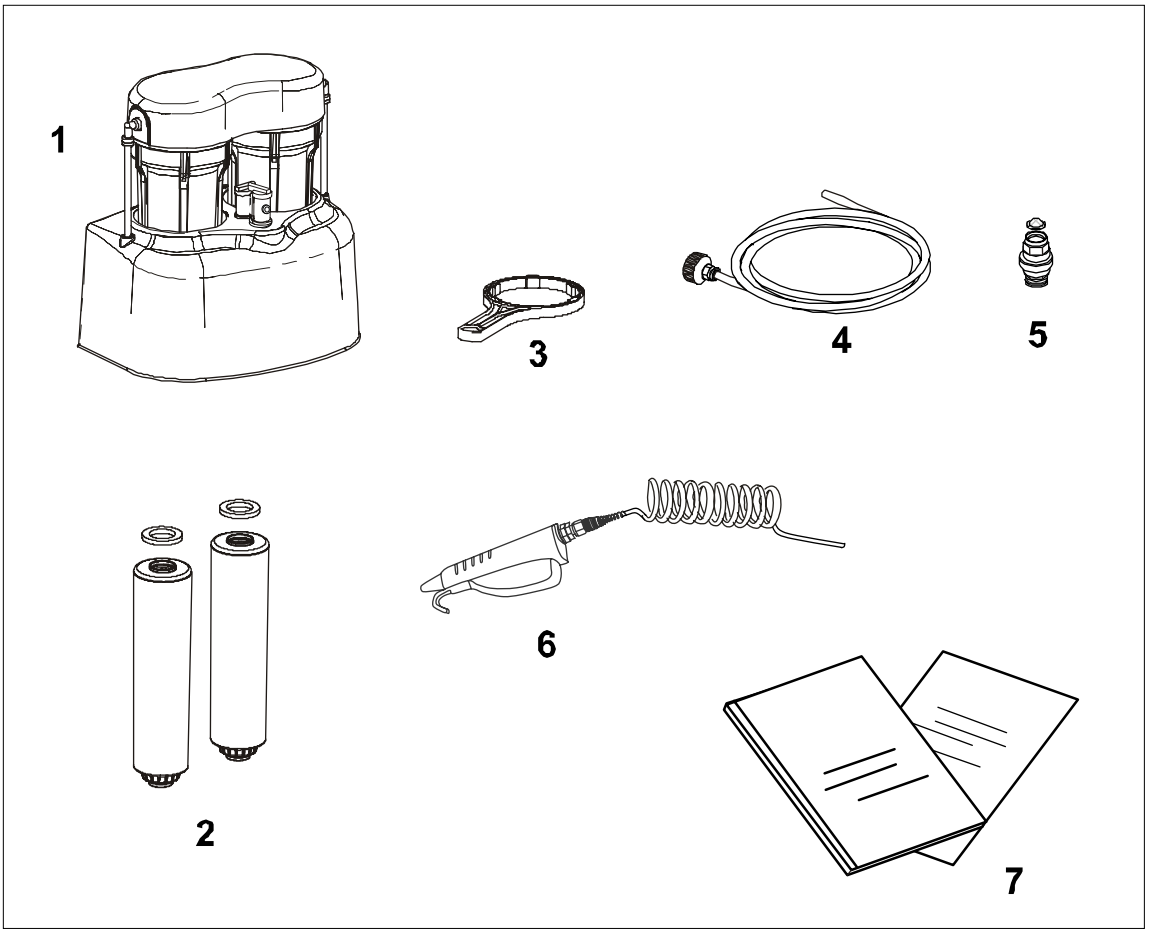

Figura 1

Elemento	Descripción
1.	Unidad desmineralizadora (cubierta + portacartuchos + junta tórica + anillo de centrado)
2.	2 cartuchos de resina + anillo de sellado
3.	Llave para sustituir los cartuchos
4.	Tubo de alimentación de agua con conexión de agua corriente (4m, Ø 6x4 mm)
5.	Válvula de bloqueo de agua (incluye filtro y llave reguladora)
6.	Pistola de agua y tubo espiral
7.	Certificado de garantía y manual del usuario

INSTALACIÓN Y USO DEL APARATO

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y DE LOS DATOS INDICADOS EN LA ETIQUETA

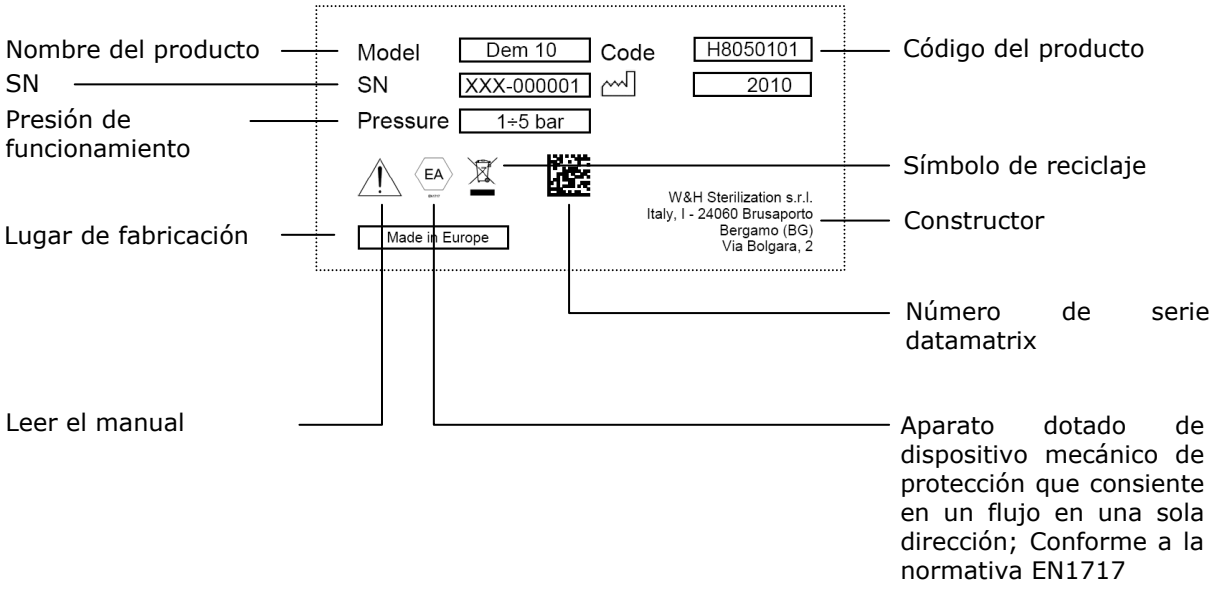

MONTAJE CARTUCHOS DE RESINAS

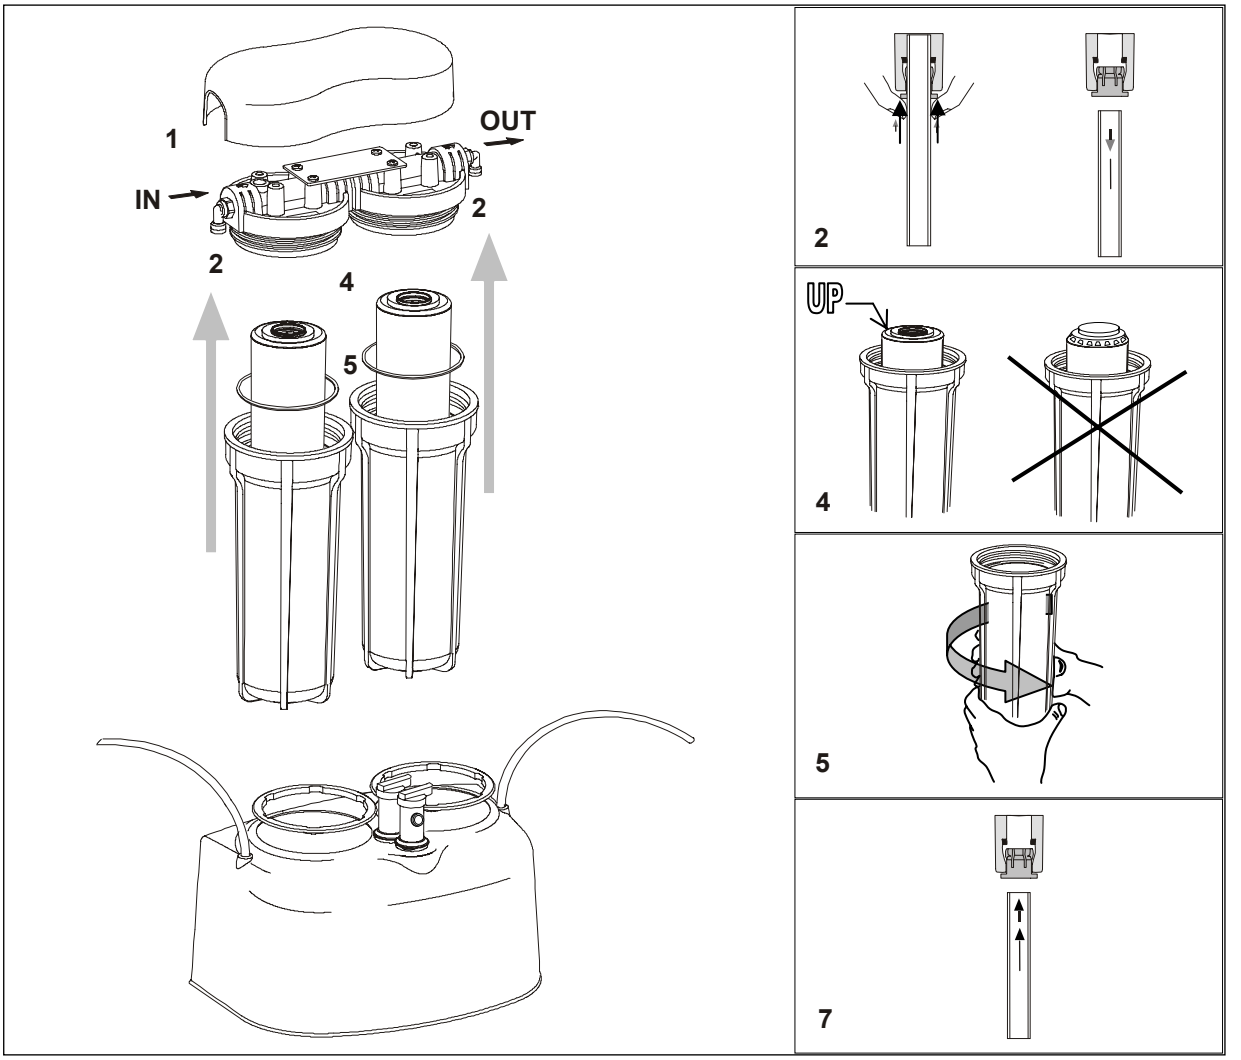

Figura 2

1. Quite la tapa de la cubierta.
2. Quite los tubos de la unión rápida (IN/OUT) situados en el cabezal de la unidad y levantar los porta cartuchos encajados en la base del desmineralizador.
3. Desatornille el recipiente del cartucho e inserte el nuevo cartucho de resina (a mano o usando una llave especial).
4. Extraiga de la bolsa los cartuchos y colóquelos en su porta cartuchos (con la parte cónica hacia abajo y la palabra "UP" hacia arriba).
5. Coloque las juntas tóricas en su alojamiento en el porta cartuchos y enrosque éstos a mano (si utiliza la llave especial apriete con moderada fuerza).
6. Vuelva a colocar todo el conjunto en la base del desmineralizador y fíjela en su lugar mediante el uso de los anillos de posicionamiento.
7. Vuelva a conectar los tubos en los conectores de entrada IN y salida OUT (asegúrese que el conector de entrada IN esta colocado en la parte izquierda).
8. Coloque la tapa de la cubierta.

INSTALACIÓN

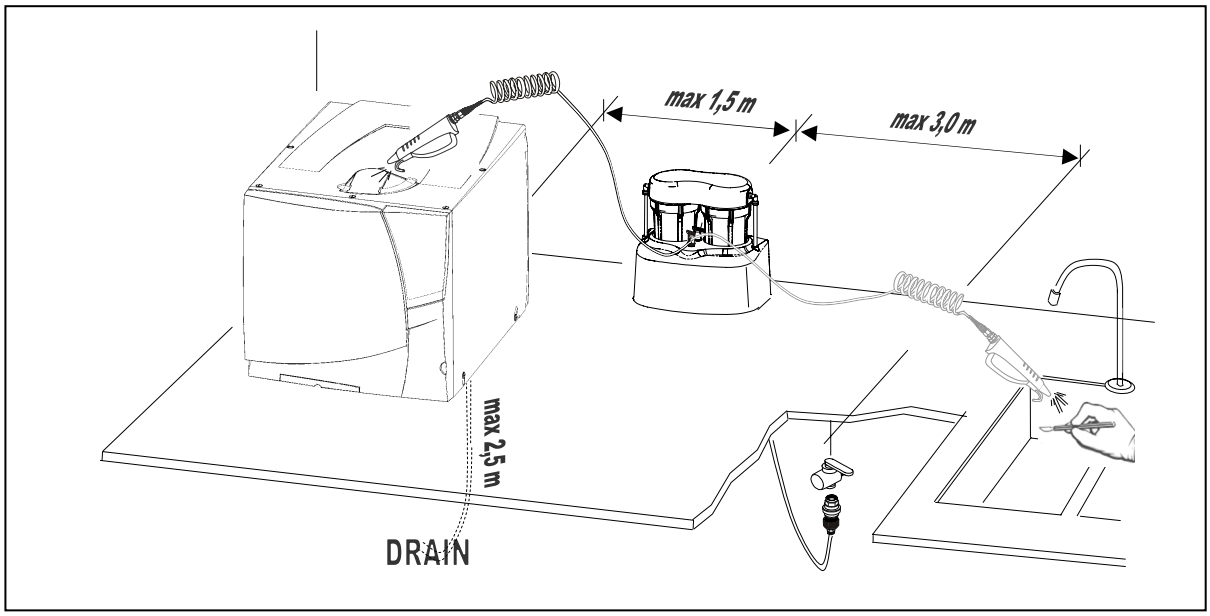

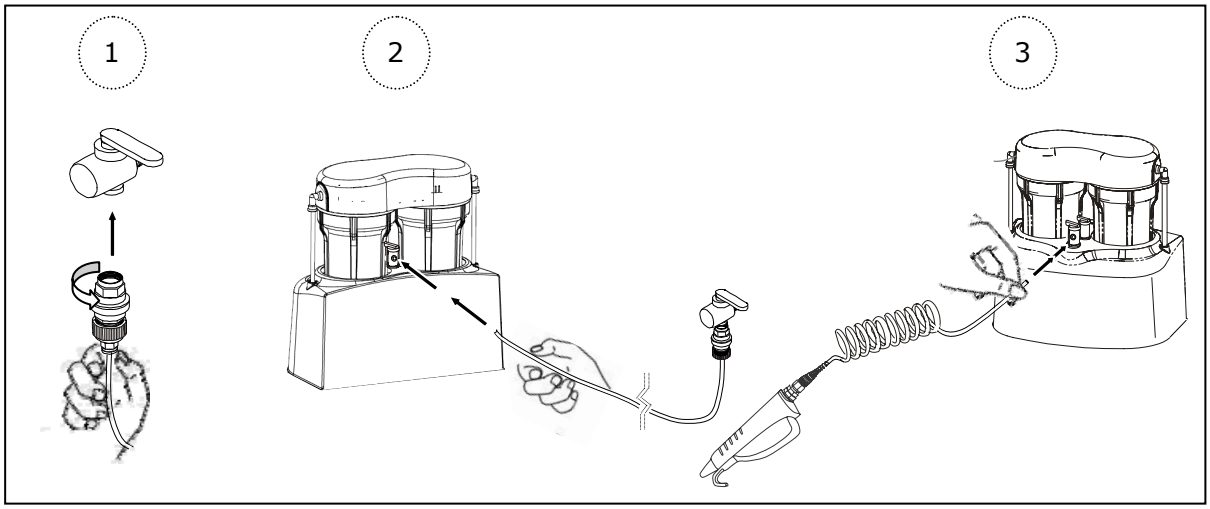

1. Monte la válvula de seguridad (Water Block®) en el punto de salida del agua.
2. Conecte el tubo de alimentación de agua entre el punto de salida del agua y el conector de entrada del Dem 10.
3. Conecte el tubo espiral por delante de la conexión de toma del Dem 10.

ATENCIÓN
Utilizar sólo recambios originales.
La válvula de seguridad (Water Block®) está dotada de una válvula especial unidireccional que impide el retorno de líquidos en la red hídrica y una posible contaminación subsecuente. **Con esta finalidad la válvula WB debe ser montada en posición vertical.**

ATENCIÓN
Compruebe que todos los tubos están conectados correctamente.
Antes de conectar los tubos, compruebe que están cortados correctamente a 90° y sin rebabas.

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE RESINA

Si se utiliza con un esterilizador, sustituya el cartucho de resina cuando la conductividad alcance el valor de 15-20 µS para rellenar el agua del esterilizador.

1. Cierre la toma del suministro de agua.
2. Libere la presión interna utilizando la pistola de agua suministrada (asegúrese que el grifo que conecta el tubo espiral está abierto durante esta operación).
3. Siga las instrucciones descritas en el capítulo anterior *Montaje del cartucho de resina*.
4. Abra la toma del Dem 10.

PRECAUCIONES PARA EVITAR EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA

ATENCIÓN
En conformidad con la norma EN1717, para evitar el deterioro de la calidad del agua y el aumento de bacterias debidas al estancamiento del agua en las tuberías, en el aparato mismo y en los depósitos del esterilizador, es necesario vaciar el sistema entero antes de dejarlo inutilizado por un largo período de tiempo (más de 10 días).

FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado y conectado correctamente, el aparato es capaz de suministrar inmediatamente el agua desmineralizada.

Este agua está lista para cargarse manualmente en el tanque de agua del esterilizador (ver el manual del usuario del esterilizador).

ATENCIÓN

El dispositivo garantiza unos 5 litros de agua desmineralizada al mantener presionada la palanca de la pistola de agua. La duración puede variar dependiendo de la presión hidráulica.

Al llegar a los cinco litros, se produce un bloqueo de agua y se cierra el suministro de agua.

Para evitar este tipo de acciones, se recomienda dejar de presionar la palanca de la pistola de agua cada 30 segundos.

En el caso de que se accione el bloqueo de agua, consulte la sección "Mantenimiento de la válvula de seguridad".

ATENCIÓN

El Water Block sirve como dipositivo anti-inundación. El sistema de bloqueo solo funciona si hay una fuga considerable (como una rotura en el tobo entre el Water Block y el desmineralizador). El sistema de bloqueo no funziona si hay una pequeña pérdida en el circuito hidráulico.

ATENCIÓN

Se recomienda que el tubo de conexión, entre el tubo espiral de la pistola y DEM10, permanezca cerrado sino se está usando.

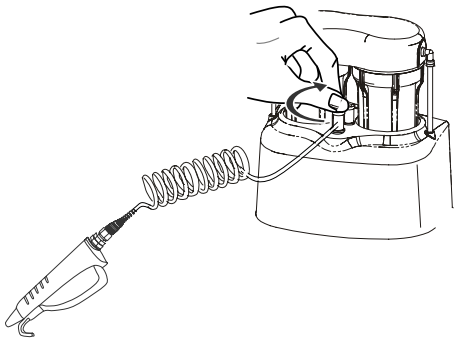

La cantidad de agua útil producida por un cartucho resinas depende de la calidad y de la dureza del agua de la red hídrica, según la gráfica siguiente:

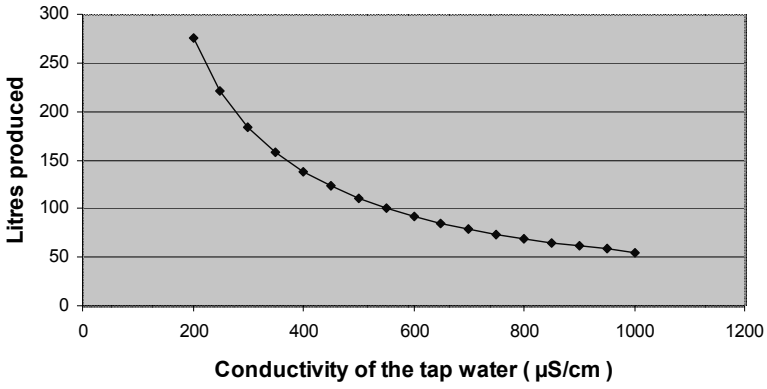

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA EXTERNA

Limpiar la cabeza con un trapo humedecido con un detergente no abrasivo y no corrosivo (pH neutro).

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD (WATER BLOCK®)

En función de la calidad del agua y de la frecuencia de uso del aparato, se recomienda limpiar periódicamente el filtro de entrada de la válvula según el procedimiento indicado en el manual.

CONTROL PERIÓDICO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ANTI-REFLUJO

ATENCIÓN
Para mantener la conformidad con la norma EN1717, controlar los dispositivos anti-reflujo (Waterblock y válvula de no retorno) al menos todos los años y/o coincidiendo con las intervenciones de mantenimiento por parte del servicio de asistencia

PIEZAS DE RECAMBIO

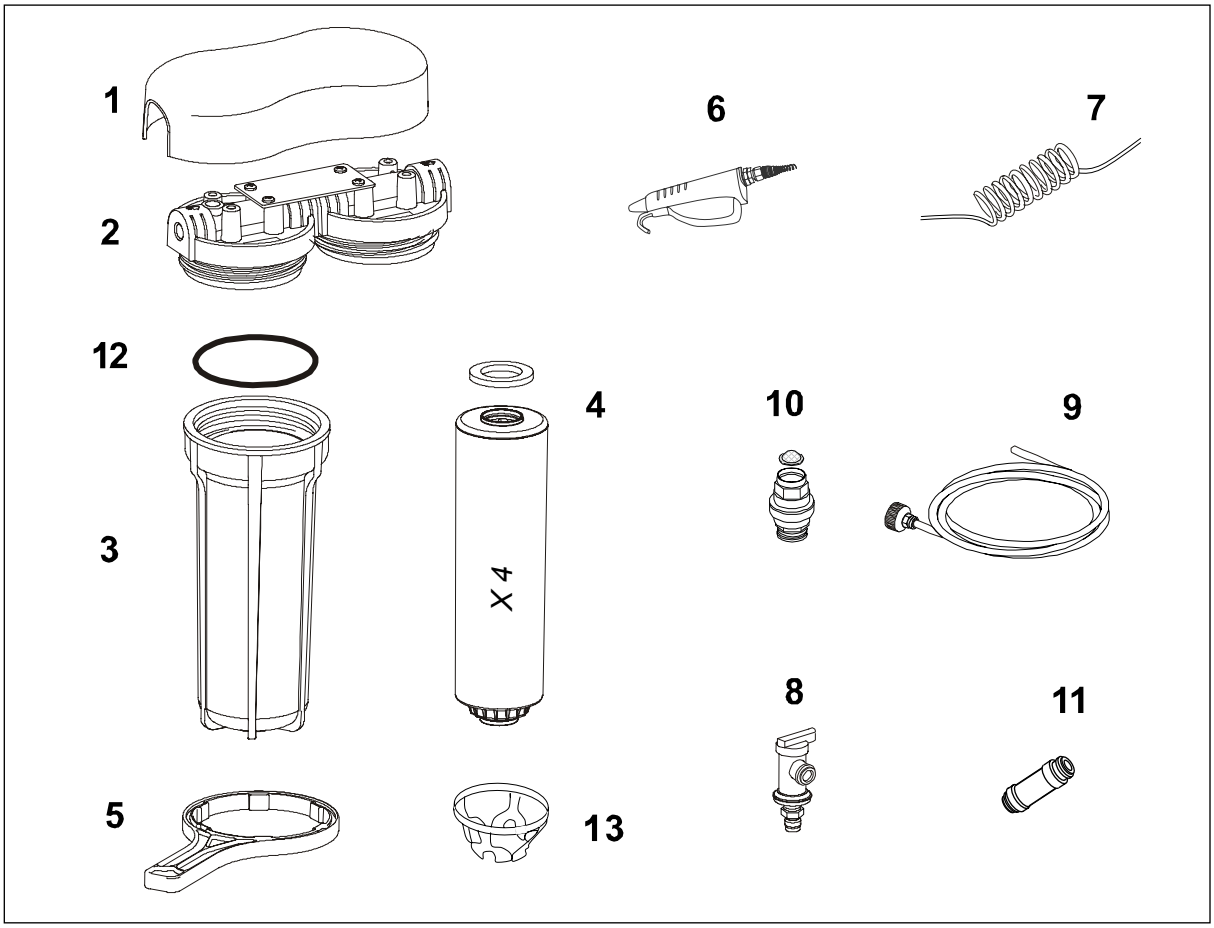

Nº	Descripción	NP
1	CUBIERTA DEL FILTRO	A812109X
2	CABEZAL DEL FILTRO	A812104X
3	RECIPIENTE PORTACARTUCHOS	A812103X
4	KIT CARTUCHOS DE RESINA 4 CARTUCHOS DE RESINA + JUNTA TÓRICA + O-R	A812100X
5	LLAVE PARA LA SUSTITUCIÓN DE CARTUCHOS DE RESINA	A812101X
6	PISTOLA DE AGUA	A812106X
7	TUBO ESPIRAL	A812105X
8	TOMA	A812107X
9	TUBO DE AGUA CON CONEXIÓN DE TOMA (4 M, Ø 6X4MM)	A812102X
10	VÁLVULA DE SEGURIDAD (WATER BLOCK®) CON FILTRO Y LLAVE REGULADORA	A812005X
11	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL + CONEXIÓN DE TOMA	A812108X
12	O-RING	A813014X
13	ANILLO DE POSICIONAMIENTO	A813006X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de uso	+5°C ÷ +30°C
Temperatura de almacenamiento	+5°C ÷ +35°C (*no exponer a la humedad o fuentes de calor)*
Dimensiones (LxPxH)	305x190x320 mm (LxPxH)
Peso (sin cartuchos)	2,8 kg
Peso cartucho	1,5 Kg
Presión mínima y máxima de la red hídrica	1 - 5 bar
Presión de rotura	Máx. 30 bar (435 psi)
Agua desmineralizada producida por los cartuchos con un valor de conductividad no superior a los 15÷20 µS [1]	110÷130 litros

[1] *probada a: T=25 °C, agua corriente de entrada a 450 µS y presión hidráulica a 3 bar*

MAINTENANCE ISTRUCTIONS FOR THE SAFETY VALVE (WATER BLOCK®)

WATER BLOCK (WB) SAFETY VALVE
Indispensable device for washing machines, dishwashers and demineralizers as, under the conditions defined in the technical features herewith described, it prevents a flow of water greater than the one for which it has been set by the adjustment pointer. This avoids continuous leaking. The Water Block also has a particular non-return valve (antipollution). The device should be installed vertically *(see fig. 2)* and following the instructions carefully.

TECHNICAL FEATURES

- Burst pressure: 500 N/cm²
- Max. static pressure: 100 N/cm²
- Max. controllable volume: about 50 lt.
- Min. operating capacity: 2 lt/min.
- Max. operating capacity: 30 lt/min
- Max. water temperature: 70° C

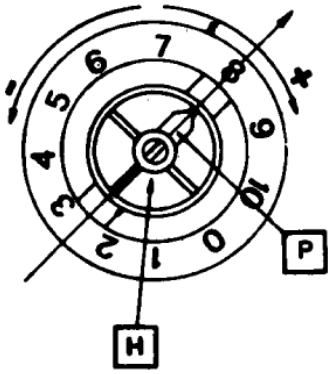

Fig. 1

USER INSTRUCTIONS
WATER BLOCK should be installed between the tap and the supply hose of the demineralizer *(fig. 2)*. Using the enclosed plastic key, turn pointer 'P' *(fig. 1)* anticlockwise to the required setting (example, position 1,5).

CAUTION:
For use on other fixtures, set the pointer to a position suitable for that particular application, considering that each number on the scale corresponds to a controlled volume of approx. 4-6 litres.
In case of installation on fixtures which foresee dispensing of drinking water for alimentary use it is advisable to let flow at least 10 litres of water inside the device before the connection, so as remove eventual impurities banked during the storage.

INSTALLATION
1. Manually screw the WB to the tap having suitable thread (3/4" gas), inserting the filter 'E' with its convex side facing upwards *(fig. 2)*. The WB will not operate properly if the filter is not installed correctly. If the WB is tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the housing 'A'.
2. Screw the supply hose 'C' to the lower end of the WB. If the supply hose is equipped with a filter, the latter must be substituted by a flat rubber washer 'F'. If the said hose has to be tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the WB housing 'B' so as to hold it firmly while performing this operation.
   If a failure occurs causing a continuous water leak, the WB will shut off when the volume of water flowing through equals the amount to which it was previously set with the pointer 'P'.
   To reset the Water Block again after it has shut off, turn the tap off and carry out the necessary repair work. Remove the supply hose 'C' from the Water Block and press the coloured plunger 'H' which is located inside the lower housing of the device itself *(fig. 1)*. It may be difficult to press this plunger if there is high pressure at the inlet side of the WB. In this case, slacken the device from the tap: the plunger 'H' can then be pressed with ease. Repeat the operation as described in the section headed 'Installation'.

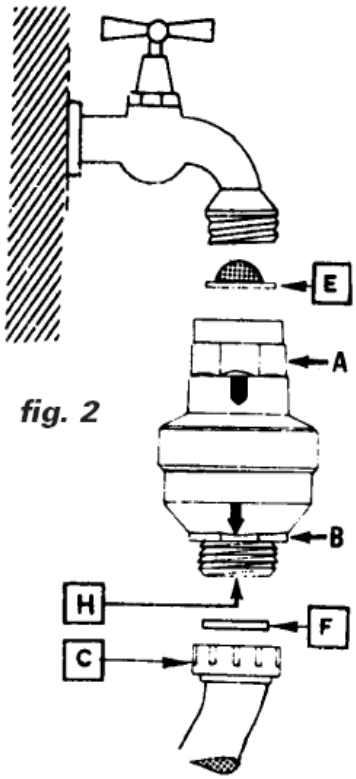

fig. 2

CAUTION:
To avoid any possible damage that may be caused by water freezing inside the WB after its installation, the ambient temperature should never be below 2° C. We decline all responsibility deriving from the incorrect use of the WB or from its use for applications and/or solutions not expressly foreseen by the above instructions.

MAINTENANCE:
Depending on the conditions and frequency of usage of the water block, it is recommended to clean out the inlet filter 'E' periodically and to replace the seal 'F'.We reserve the right to modify any features without prior notice.

Dem 10

För fast vattenanslutning

BRUKSANVISNING

Bästa kund,

*Tack för Ert förtroende genom införskaffandet av **Dem 10**.*

Vi ber Er att noggrant läsa igenom denna manual för att försäkra Er om att utrustningen fungerar optimalt. Samtliga våra produkter överensstämmer med gällande säkerhetsnormer och medför inga risker för användaren om de används i enlighet med medskickade instruktioner.

W&H STERILIZATION S.r.l.

Svenska

INDEX

INTRODUKTION 3

GENERELLA VARNINGAR 3
RESIN – SÄKERHETSÅTGÄRDER 4
INFORMATION OM GARANTI 5

INNEHÅLL 6

GENERELLT OM LEVERANSEN 6
PAKETETS MÅTT OCH VIKT 6
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 8

SYMBOL-, OCH DATAFÖRKLARING 8
MONTERING AV FILTRET 9
INSTALLATION 9
BYTE AV FILTER 11
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA STILLASTÅENDE VATTEN 11
ANVÄNDNING 12

UNDERHÅLL 13

EXTERN RENGÖRING 13
UNDERHÅLL AV SÄKERHETSVENTILEN WATER BLOCK® 13
ÅRLIG KONTROLL AV WATER BLOCK® OCH BACKVENTILER 13
RESERVDELAR 14

TEKNISK INFORMATION 15

MAINTENANCE ISTRUCTIONS FOR THE SAFETY VALVE (WATER BLOCK®) 16

INTRODUKTION

Denna manual ger instruktioner om:

- säker och effektiv drift av utrustningen;
- löpande och schemalagt underhåll.

※ Angivna mått i denna manual är ej bindande

※ Ritningar och andra dokument levererade med utrustningen tillhör den tillverkare som reserverar samtliga rättigheter.

※ Reproduktion, även i delar, av text och illustrationer är förbjuden.

GENERELLA VARNINGAR

- Utrustningen skall användas för de ändamål som beskrivs i denna manual och aldrig för andra ändamål.
- Användaren är ansvarig för att installation, användandet samt underhåll utförs i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Använd endast originalfilter till denna produkt.
- **Drick inte** vattnet som produceras av Dem 10.
- **Blockera eller kläm inte** slangarna till och från autoklaven och Dem 10.
- Om utrustningen inte används korrekt eller underhålls lämpligt, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för eventuella fel, skador eller bristande funktionsförmåga hos utrustningen.
- När den används med en steriliseringsapparat, och vattenledningsförmågan överskrider 15-20 μS måste hartspatronerna bytas ut omedelbart, annars kan steriliseringsapparaten skadas.

Användningsområde: Denna manual är en del av utrustningen och skall finnas lätt tillgänglig. Utrustningen skall endast användas för det ändamål den är utvecklad för:

Dem 10: Utrustning som är designad för avsaltning av kranvatten och manuell vattenpåfyllning av ångsteriliserare.

RESIN – SÄKERHETSÅTGÄRDER ENDAST

Kontakt	
Ögonkontakt	Irriterande (R36).
Hudkontakt	Kan irritera.
Första Hjälpen	
Ögonkontakt	Skölj genast med stora mängder vatten så att resin-resterna sköljs bort.
Hudkontakt	Byt ev. kontaminerade kläder. Ta bort resin-resterna och rengör området med vatten.
Åtgärder vid läckage	
Allmänna åtgärder	Resin på golvet kan orsaka halt underlag. Varning för halkrisk.
Rengöring	Sopa upp resinet. Kastas på samma sätt som tomma filterpatroner.
Avfall	
Produkten är inte klassad som farligt avfall. Ev. lokala eller regionala avfallsbestämmelser skall dock följas. CER nummret för resinet som används för att producera vattnet är: **19 09 05**.	

INFORMATION OM GARANTI

Tillverkaren ger an garanti på produkten, förutsatt att de underhålls och används i enlighet med manualen, i 12 månader.

Garantin gäller från leveransdatumet vilket måste kunna styrkas med inköpsfakturan.

Garantin täcker inte defekter eller skada genom:

- Felaktig installation
- Otillräckligt underhåll
- Otillåtna ingrepp i utrustningen
- Felaktigt användande
- Instruktionerna i denna manual inte följs

Ev. utbyte av utrustningen förlänger inte den ursprungliga garantin.

Garantinreparationer avgörs och ersätts av tillverkaren och täcker inte kostnader för emballage eller transporter.

MODEL CODE SN	GB	WARRANTY	FR	BON DE GARANTIE	W&H
	DE	GARANTIE	IT	GARANZIA	

GB	This W&H STERILIZATION product has been manufactured with extreme care by highly qualified specialists. A wide variety of test and inspections guarantees fault-free operation. Please pay particular attention to the enclosed User Manual! If deficiencies or damage occur during the warranty period which are caused by the material, these will be remedied free of charge. The defective unit must be returned with this warranty certificate. Please request special transport packaging if the original packaging is not available! Services under warranty are provided directly by W&H STERILIZATION or indirectly by its contractual partners. We accept no responsibility for damage caused by improper handling or inadequate packaging during return of goods! Claims under warranty are submitted by the supply depot of the user to the manufacturer along with all necessary documents
FR	Ce produit W&H STERILIZATION a été fabriqué avec le plus grand soin par des spécialistes hautement qualifiés. Divers contrôles et vérifications garantissent un parfait fonctionnement. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation ci-jointe ! Si des défauts ou détériorations liés au matériel apparaissent durant la période de garantie, ils seront entièrement pris en charge. L'appareil défectueux sera à nous retourner accompagné de ce bon de garantie. Utilisez impérativement un emballage spécial pour le transport si le carton d'origine n'est plus en votre possession ! Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur. Les détériorations consécutives à une mauvaise manipulation ou à un défaut d'emballage lors du retour ne seront pas prises en charge ! Les demandes de prise en charge de garantie n'interviennent pas directement entre l'utilisateur (ou l'organisme utilisateur) et le fabricant. Celles-ci sont transmises à W&H STERILIZATION ou au fournisseur du matériel avec les justificatifs nécessaires.
DE	Dieses W&H STERILIZATION Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt gefertigt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte genau die beiliegende Gebrauchsanweisung! Sollten innerhalb der Garantiefrist Mängel und Schäden auftreten, die auf das Material zurückzuführen sind, werden diese kostenlos behoben. Das defekte Gerät muß mit diesem Garantieschein eingesandt werden. Bitte Spezial-Transportverpackung anfordern, falls Original-verpackung nicht mehr verfügbar! Die Garantieleistung erfolgt mittelbar durch W&H STERILIZATION oder unmittelbar durch deren Vertragspartner. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder unzu-reichende Verpackung bei der Einsendung haften wir nicht! Garantieansprüche werden durch das Lieferdepot des Anwenders an den Fabrikanten gestellt, unter Beifügung aller dafür nötigen Unterlagen.
IT	Questo apparecchio è stato realizzato da W&H STERILIZATION con la massima cura da tecnici altamente specializzati. Molteplici prove e controlli assicurano un funzionamento corretto. Attenersi esattamente alle istruzioni di impiego. Guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di garanzia verranno riparati gratuitamente. L'apparecchio va inviato insieme alla cartolina di garanzia al centro di Assistenza Tecnica Autorizzata W&H STERILIZATION. Utilizzare l'imballo originale o comunque un imballo idoneo. W&H STERILIZATION non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme alle istruzioni o di rispedizione in imballo non adeguato. Gli interventi in garanzia vanno richiesti dal deposito dentale fornitore, fornendo la necessaria documentazione.

GB	**1 Year Warranty**
FR	**1 An de Garantie**
DE	**1 Jahr Garantie**
IT	**1 Anno di Garanzia**

GB	Purchase date:	FR	Date de vente:
DE	Date de vente:	IT	Data di vendita:

GB	Supply depot:	FR	Cachet du dépôt:
DE	Lieferdepot:	IT	Deposito dentale:

GB	Practice/Clinic/Laboratory address:	FR	Nom et adresse du client:
DE	Praxis-/Klinik-/Labor-Adresse:	IT	Studio odontoiatrico:

INNEHÅLL

GENERELLT OM LEVERANSEN

Kontrollera att emballaget inte är skadat vid leveransen. Spara gärna kartongen för eventuell återtransport.

Öppna kartongen och kontrollera att:

- allt är levererat enligt packlistan
- det inte finns uppenbara skador.

Om något är skadat eller saknas, informera omedelbart detta till transportören samt den leverantör du beställt av.

PAKETETS MÅTT OCH VIKT

Bruttovikt : 6.5 Kg
Dimensioner i mm

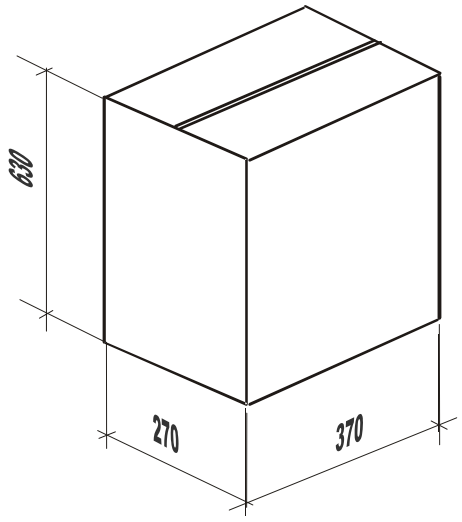

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

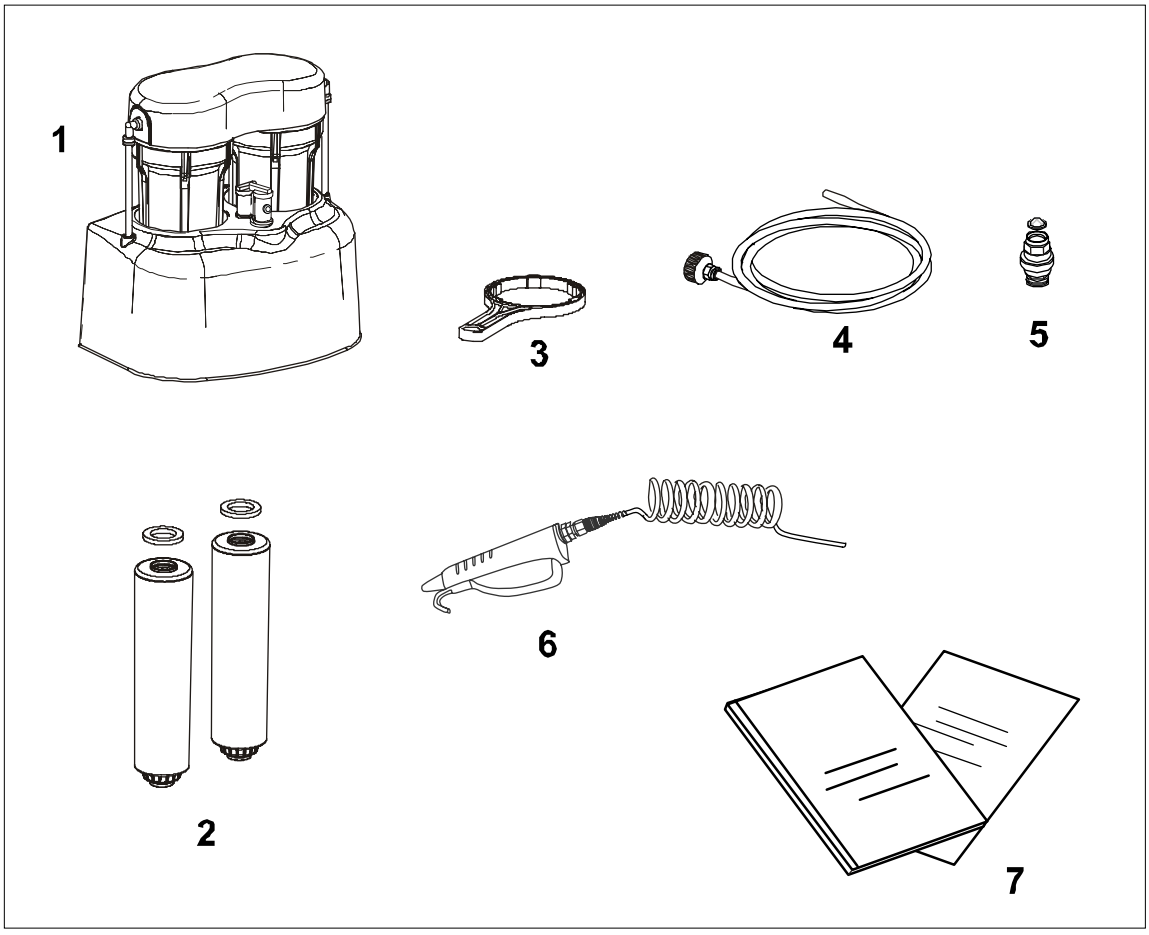

Figure 1

Föremål	Beskrivning
1.	LisaDem10 (huvud + patronhållare + O-ring + centreringsring)
2.	Filterpatroner samt packningar
3.	Nyckel för att byta ut patron
4.	Slang för montage mellan vattenblocksventil och Dem10 (4m, Ø 6x4 mm)
5.	Vattenblockventil (inkluderar filter och inställningsnyckel)
6.	Vattenpistol och slang
7.	Garantikort och bruksanvisning

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

SYMBOL-, OCH DATAFÖRKLARING

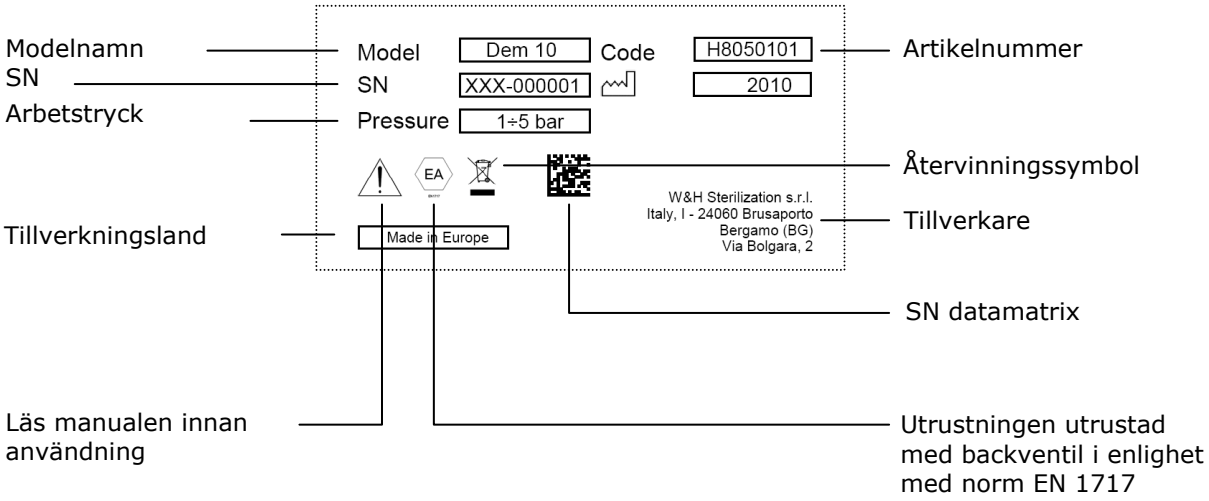

MONTERING AV FILTRET

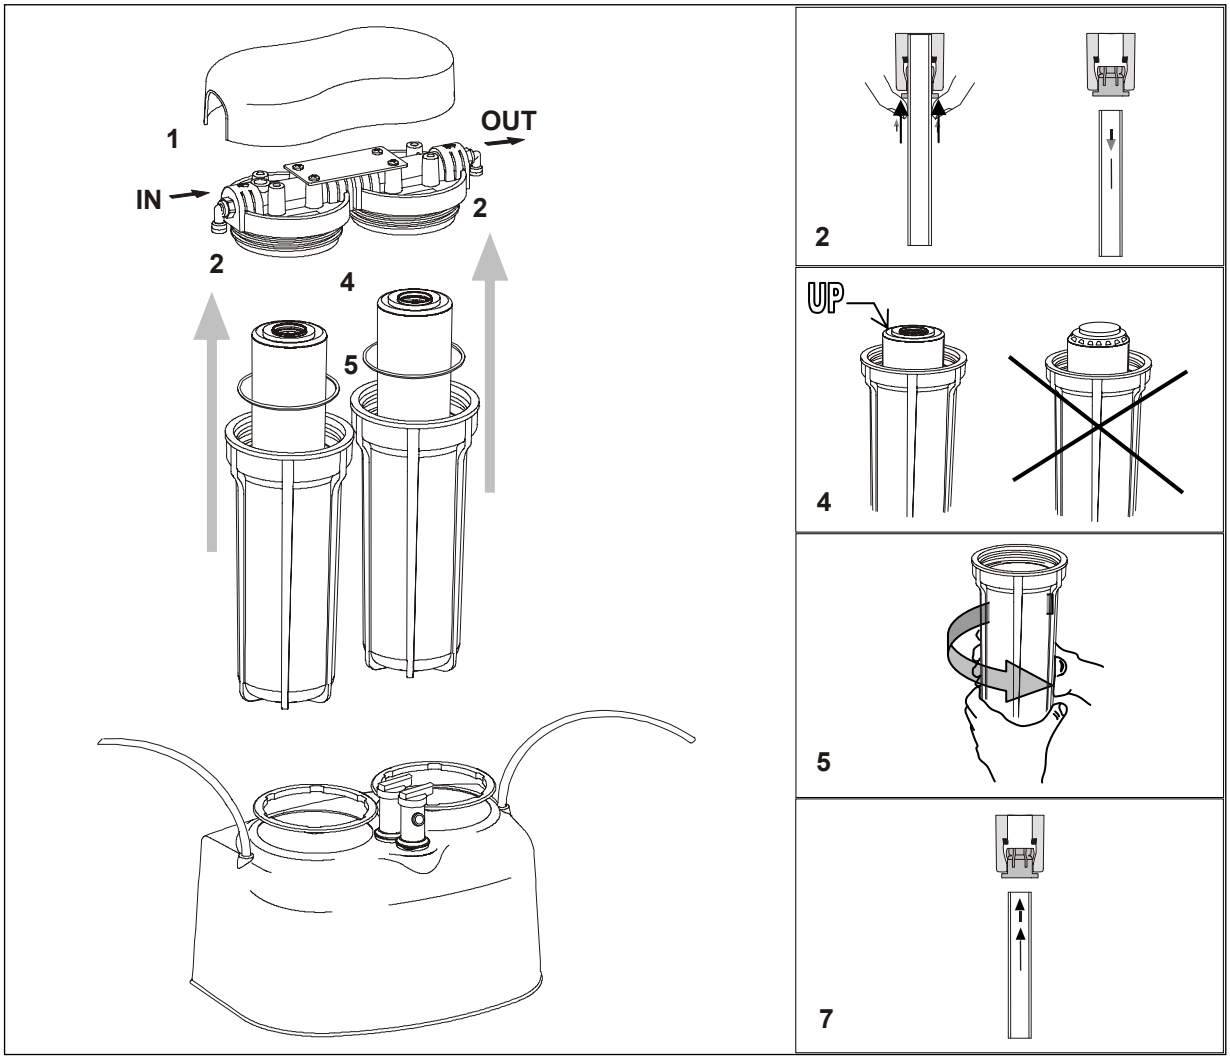

Figure 2

1. Ta bort skyddslocket
2. Tag loss de 2 slangarna från snabbkopplingarna (IN/OUT) på enhetens huvud och lyft sedan hela filterenheten ur underdelen.
3. Skruva ur de 2 filterbehållarna antingen för hand eller med den medföljande specialnyckeln.
4. Ta ur filtren ur påsarna och ställ ned dem i behållarna (med den koniska sidan nedåt och texten "UP" uppåt).
5. Placera O-ringarna i spåren på filterbehållarna och skruva ihop dem för hand (använd inte allt för mycket kraft om du använder specialnyckeln).
6. För ned filterenheten på plats igen i underdelen, använd positionsringarna som stagar upp filterenheten.
7. Anslut slangarna på IN och OUT snabbkopplingarna (anslutningen "IN" skall vara på den vänstra sidan).
8. Lägg på skyddslocket.

INSTALLATION

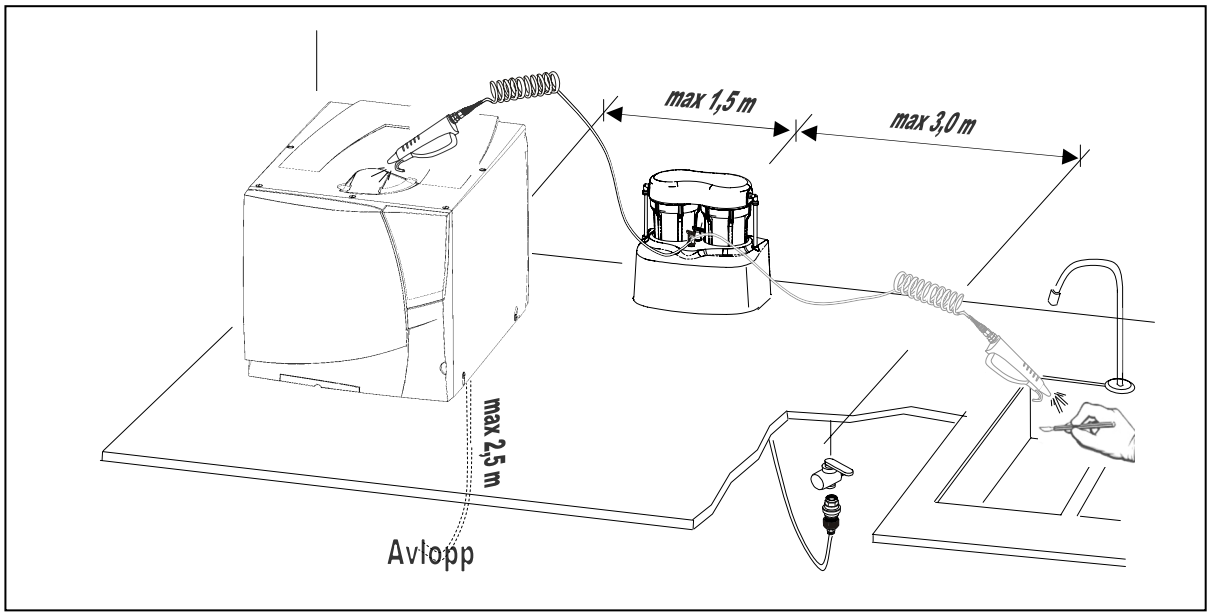

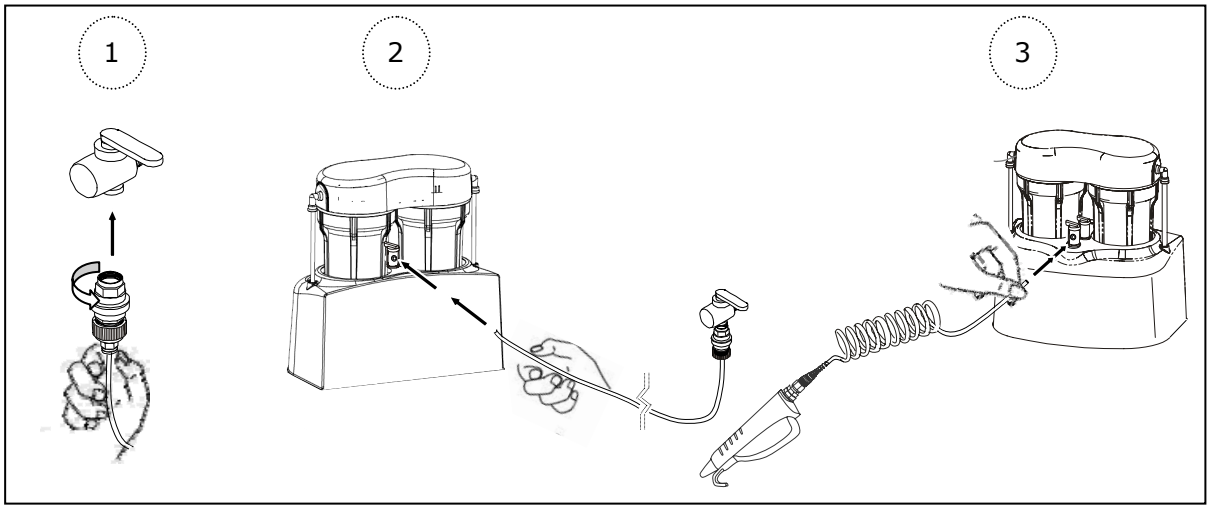

1. Montera säkerhetsventilen (Water Block®) på vattenanslutningen

2. Anslut slangen mellan Dem 10:ans inkommande anslutning och säkerhetsventilen.

3. Anslut vattenpistolens slangända på Dem10:ans krananslutning.

VARNING
Använd endast original reservdelar
Water Block® ventilen har en speciell backventil som förhindrar att vattnet kan rinna åt fel håll. **På grund av denna MÅSTE ventilen monteras vertikalt**.

WARNING
Kontrollera att slangarna är korrekt anslutna och att slangarna är avklippta 90° utan skärmärken, hack eller andra skador.

BYTE AV FILTER

Om den används tillsammans med en steriliseringsapparat skall hartsbehållaren bytas ut när ledningsförmågan når ett värde på 15-20µS, om och när produkten används för att fylla vatten i steriliseringsapparaten.

1. Stäng av vattnet med kranen på Dem10
2. Släpp ut trycket med hjälp av vattenpistolen.
3. Följ stegen i ansnittet "*Montering av filtret".*
4. Sätt på vattnet med kranen igen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA STILLASTÅENDE VATTEN

OBS!
I enlighet med kraven i EN1717 och för att undvika nedsättning av vattenkvaliteten i samband med stillastående vatten, är det nödvändigt att tömma hela systemet innan man låter det stå oanvänt under en längre period.

ANVÄNDNING

När den väl är installerad och passar korrekt är avsaltaren klar för att förse vatten till steriliseringsapparaten.
Det här vattnet är klart för att pumpas in manuellt i vattentanken i steriliseringsapparaten (se bruksanvisning för steriliseringsapparat).

UPPMÄRKSAMHET
Apparaten garanterar cirka 5 liter avsaltat vatten genom att man håller vattenmunstycket intryckt. Tiden kan variera beroende på vattentrycket.
Efter fem liter träder vattenspärren ikraft och stänger av vattentillförseln.
För att undvika dessa åtgärder är det alltid rekommenderat att släppa knappen på vattenmunstycket var 30:e sekund.
Om vattenspärren skulle träda i kraft, se avsnittet "Underhåll av säkerhetsventilen".

VARNING
WaterBlock-ventilen fungerar som ett översvämmningsskydd. Ventilen löser ut efter genomflödet av det antal liter vatten som ventilen är inställd för - om trycket är normalt. Ventilen löser inte ut om det är ett mycket litet läckage – Stäng därför alltid av vattnet till systemet när ni går för dagen.

VARNING
Låt vattenpistolens vattenkran vara avstängd när inte vattenpistolen används.

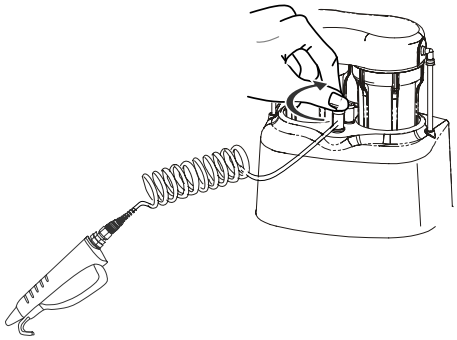

Mängden rent vatten producerat per filterpatron är direkt beroende på det inkommande vattnets kvalitet. Nedanstående finns en skala på hur mycket vatten som kan renas:

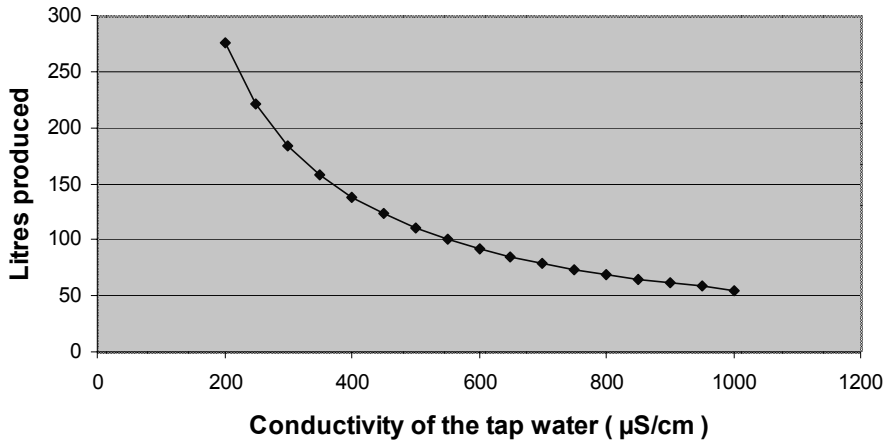

UNDERHÅLL

EXTERN RENGÖRING

Rengör enheten med en fuktad trasa som inte innehåller starka medel (pH neutralt).

UNDERHÅLL AV SÄKERHETSVENTILEN WATER BLOCK®

Rengör ventilens vattenfilter med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vattnets och vattenledningarnas kvalitet. Börja med en gång i månaden – om det inte finns något smuts i filtret kan perioden mellan kontrollerna förlängas.

KONTROLL AV BACKVENTILER

OBS
För att överensstämma med kraven i EN1717 (§ 4.6) skall backventilerna (inkl. WaterBlock) kontrolleras en gång per år. Detta görs i samband med den årliga servicen av kvalificerad personal i enlighet med servicemanualen.

RESERVDELAR

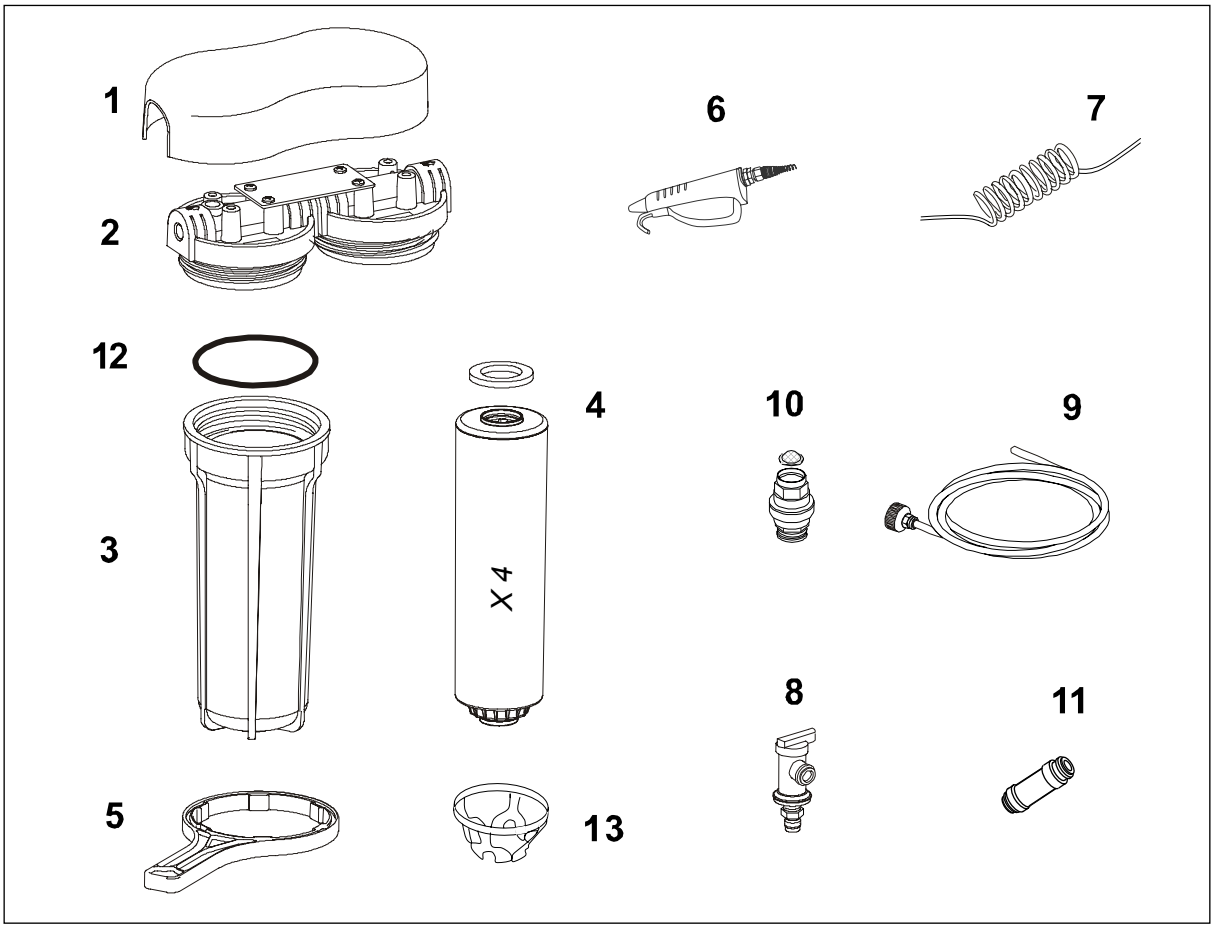

Nr.	Beskrivning	A.NR.
1	FILTERLOCKSSKYDD	A812109X
2	FILTERHUVUD	A812104X
3	FILTERPATRONSBEHÅLLARE	A812103X
4	FILTERPATRONS KIT (4 PATRONER + 4 PACKINGBAR + 4 O-RINGAR)	A812100X
5	NYCKEL FÖR BYTE AV FILTERPATRON	A812101X
6	VATTENPISTOL	A812106X
7	SPIRALSLANG	A812105X
8	KRAN	A812107X
9	VATTENSLANG MED KRANANSLUTNING (4 M, Ø 6X4MM)	A812102X
10	SÄKERHETSVENTIL (WATER BLOCK®) MED FILTER OCH NYCKEL	A812005X
11	ENVÄGSVENTIL	A812108X
12	O-RING	A813014X
13	CENTRERINGSRING	A813006X

TEKNISK INFORMATION

Temperaturområde Drift	+5°C ÷ +30°C
Temperaturområde Lagring	+5°C ÷ +35°C undvik direkt solljus samt andra värmekällor
Storlek (LxDxH)	305x190x320 mm (LxPxH)
Vikt (utan filterpatroner)	2,8 kg
Filterpatronens vikt x 2	1,5 Kg
Min - max vattentryck	1 - 5 bar
Bristningstryck	30 bar Max (435 Psi)
Mängden (ca) renat vatten mellan 15-20 uS	110÷130 liter

MAINTENANCE ISTRUCTIONS FOR THE SAFETY VALVE (WATER BLOCK®)

WATER BLOCK (WB) SAFETY VALVE
Indispensable device for washing machines, dishwashers and demineralizers as, under the conditions defined in the technical features herewith described, it prevents a flow of water greater than the one for which it has been set by the adjustment pointer. This avoids continuous leaking. The Water Block also has a particular non-return valve (antipollution). The device should be installed vertically *(see fig. 2)* and following the instructions carefully.

TECHNICAL FEATURES

- Burst pressure: 500 N/cm²
- Max. static pressure: 100 N/cm²
- Max. controllable volume: about 50 lt.
- Min. operating capacity: 2 lt/min.
- Max. operating capacity: 30 lt/min
- Max. water temperature: 70° C

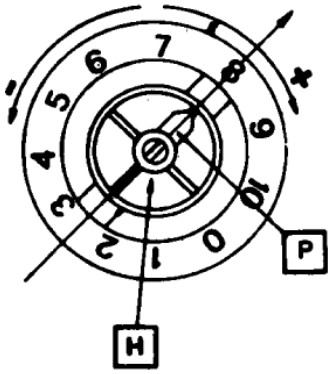

Fig. 1

USER INSTRUCTIONS
WATER BLOCK should be installed between the tap and the supply hose of the demineralizer *(fig. 2)*. Using the enclosed plastic key, turn pointer 'P' *(fig. 1)* anticlockwise to the required setting (example, position 1,5).

CAUTION:
For use on other fixtures, set the pointer to a position suitable for that particular application, considering that each number on the scale corresponds to a controlled volume of approx. 4-6 litres.
In case of installation on fixtures which foresee dispensing of drinking water for alimentary use it is advisable to let flow at least 10 litres of water inside the device before the connection, so as remove eventual impurities banked during the storage.

INSTALLATION
1. Manually screw the WB to the tap having suitable thread (3/4" gas), inserting the filter 'E' with its convex side facing upwards *(fig. 2)*. The WB will not operate properly if the filter is not installed correctly. If the WB is tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the housing 'A'.
2. Screw the supply hose 'C' to the lower end of the WB. If the supply hose is equipped with a filter, the latter must be substituted by a flat rubber washer 'F'. If the said hose has to be tightened or loosened with the aid of a wrench, the same must be applied to the appropriately octagonally shaped part of the WB housing 'B' so as to hold it firmly while performing this operation.
   If a failure occurs causing a continuous water leak, the WB will shut off when the volume of water flowing through equals the amount to which it was previously set with the pointer 'P'.
   To reset the Water Block again after it has shut off, turn the tap off and carry out the necessary repair work. Remove the supply hose 'C' from the Water Block and press the coloured plunger 'H' which is located inside the lower housing of the device itself *(fig. 1)*. It may be difficult to press this plunger if there is high pressure at the inlet side of the WB. In this case, slacken the device from the tap: the plunger 'H' can then be pressed with ease. Repeat the operation as described in the section headed 'Installation'.

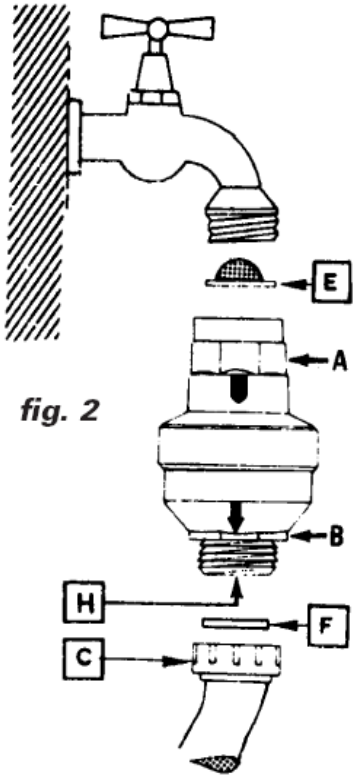

fig. 2

CAUTION:
To avoid any possible damage that may be caused by water freezing inside the WB after its installation, the ambient temperature should never be below 2° C. We decline all responsibility deriving from the incorrect use of the WB or from its use for applications and/or solutions not expressly foreseen by the above instructions.

MAINTENANCE:
Depending on the conditions and frequency of usage of the water block, it is recommended to clean out the inlet filter 'E' periodically and to replace the seal 'F'.We reserve the right to modify any features without prior notice.

Manufacturer:

W&H Sterilization S.r.l
Italy, I-24060 Brusaporto (BG)
Via Bolgara, 2
t +39/035/66 63 000
f +39/035/50 96 988
e office@wnhster.it
wh.com

Importer: